



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203208028 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 25

(21) 申请号 201320273663. 1

(22) 申请日 2013. 05. 08

(73) 专利权人 翟宁

地址 272029 山东省济宁市市中区古槐路
79 号济宁医学院附属医院磁共振室

(72) 发明人 翟宁

(51) Int. Cl.

A61B 5/055 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

磁共振检查床

(57) 摘要

磁共振检查床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板上段设有滑槽,滑槽上设有滑行头托,滑行头托一侧设有固定螺母,滑行头托上端设有弹力带。本实用新型结构简单,医务人员在给病人进行磁共振检查时操作简便、省时省力,且病人舒适,减轻了医务人员的工作难度。

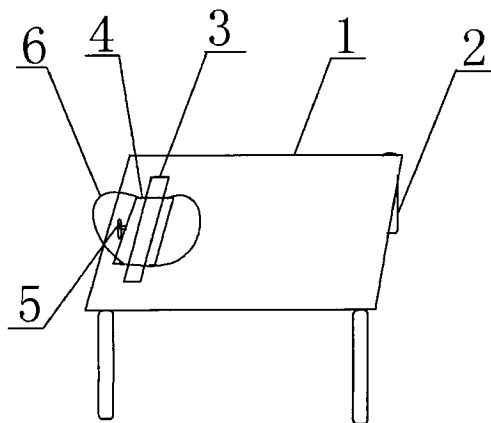

1. 磁共振检查床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)上段设有滑槽(3),滑槽(3)上设有滑行头托(4),滑行头托(4)一侧设有固定螺母(5),滑行头托(4)上端设有弹力带(6)。

磁共振检查床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种磁共振检查床。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的磁共振检查床主要由床板和床腿构成，在给病人进行磁共振检查时，需要将病人头下安放普通头枕，头枕的两侧设有约束带固定病人头部，这样病人十分不舒服，且操作麻烦、费时费力，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种结构简单，医务人员在给病人进行磁共振检查时操作简便、省时省力，且病人舒适的磁共振检查床。


[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板上段设有滑槽，滑槽上设有滑行头托，滑行头托一侧设有固定螺母，滑行头托上端设有弹力带。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，医务人员在给病人进行磁共振检查时操作简便、省时省力，且病人舒适，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、滑槽，4、滑行头托，5、固定螺母，6、弹力带。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 上段设有滑槽 3，滑槽 3 上设有滑行头托 4，滑行头托 4 一侧设有固定螺母 5，滑行头托 4 上端设有弹力带 6。医务人员在给病人进行磁共振检查时，调节滑行头托 4，将头部放置在滑行头托 4 上，再旋紧定位螺母 5 即可。

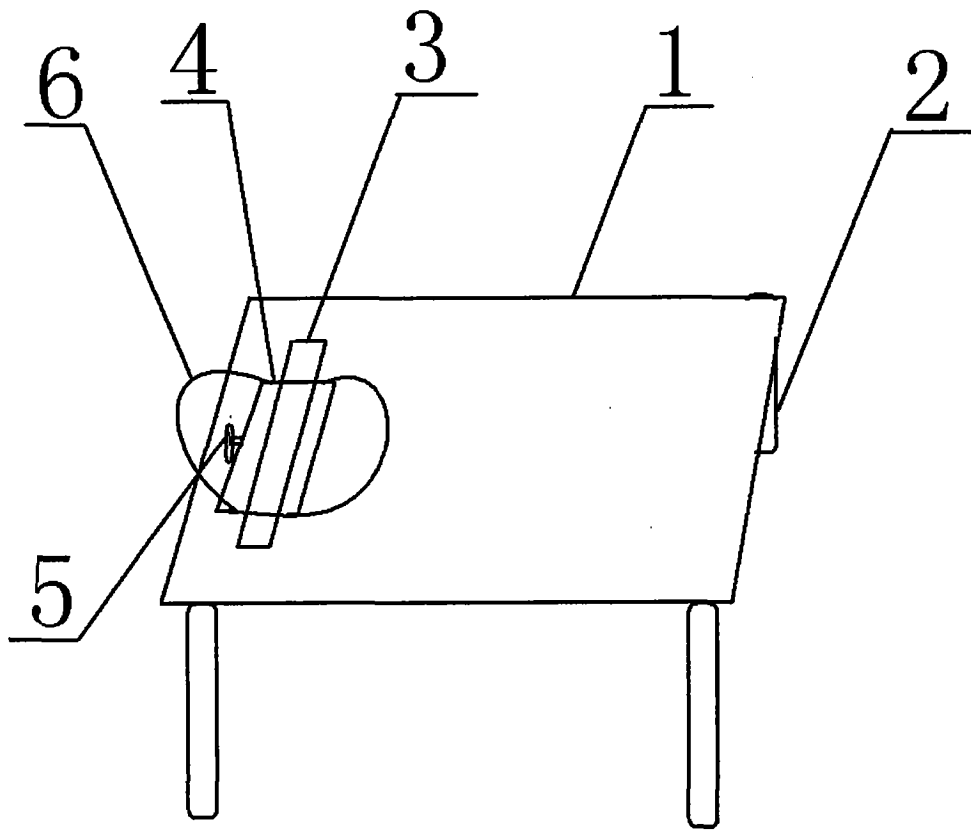

图一