

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2019 年 5 月 16 日 (16.05.2019)



(10) 国际公布号
WO 2019/090574 A1

(51) 国际专利分类号:
A61B 8/12 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2017/110141

(22) 国际申请日: 2017 年 11 月 9 日 (09.11.2017)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(71) 申请人: 深圳先进研究院 (SHENZHEN INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY) [CN/CN]; 中国广东省深圳市南山区西丽大学城学苑大道1068号, Guangdong 518055 (CN)。

(72) 发明人: 邱维宝 (QIU, Weibao); 中国广东省深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号, Guangdong 518055 (CN)。 苏敏 (SU, Min); 中国广东省深圳南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号, Guangdong 518055 (CN)。 张利宁 (ZHANG, Lining); 中国广东省深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号, Guangdong

518055 (CN)。 郑海荣 (ZHENG, Hairong); 中国广东省深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号, Guangdong 518055 (CN)。

(74) 代理人: 上海胜康律师事务所 (SYNCLAW ATTORNEYS); 中国上海市杨浦区翔殷路128号1号楼D座314室, Shanghai 200433 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,

(54) Title: DUAL-TRANSDUCER INTRAVASCULAR ULTRASONIC IMAGING DEVICE

(54) 发明名称: 一种双换能器血管内超声成像装置

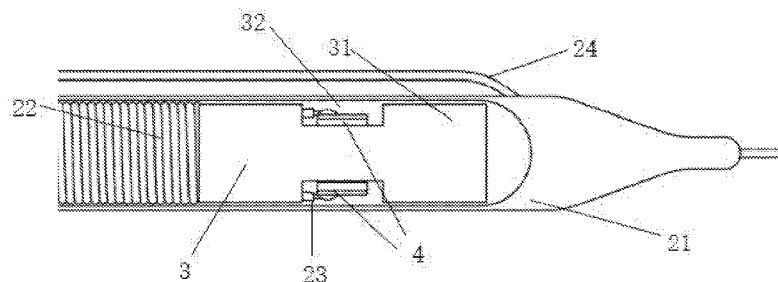


图 2

(57) Abstract: Disclosed is a dual-transducer intravascular ultrasonic imaging device, comprising a catheter (2) and an ultrasonic probe (3) located at a front end of the catheter (2), wherein the catheter (2) comprises a protective tube (21), a flexible metal pipe (22) and a coaxial cable (23); and the ultrasonic probe (3) is located in the protective tube (21), the ultrasonic probe (3) comprises two ultrasonic transducers (4), the two ultrasonic transducers (4) are arranged back to back and send, simultaneously or at different times, ultrasonic beams for imaging, and the two ultrasonic transducers (4) have a common backing layer (43). The device of the present invention comprises the two high-frequency single-array-element transducers, and during operation, the two transducers can simultaneously transmit and receive an ultrasonic wave so as to obtain more intravascular tissue information. In addition, the two ultrasonic transducers (4) of the present invention share the backing layer (43), such that the thickness of each transducer of a multi-layer structure can be greatly decreased, thereby greatly improving the practicability of the device.



NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布：

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(57) 摘要：一种双换能器血管内超声成像装置，包括导管(2)以及位于导管(2)前端的超声探头(3)，导管(2)包括护管(21)、金属软管(22)和同轴电缆(23)，超声探头(3)位于护管(21)内，超声探头(3)包括两个超声换能器(4)，两个超声换能器(4)背对背设置，同时或分时发送超声声束进行成像，两个超声换能器(4)具有共同的背衬层(43)。本发明的装置，包括两个高频单阵元换能器，工作时两个换能器可以同时进行超声波发射和接收，可以获得更多血管内组织信息。同时，本发明的两个超声换能器(4)共用背衬层(43)，可以大大减小多层结构的换能器的厚度，将大大提高装置的实用性。

一种双换能器血管内超声成像装置

技术领域

[1] 本发明总体上涉及医学超声成像领域，尤其涉及一种双换能器血管内超声成像装置。

背景技术

[2] 动脉粥样硬化是一种致死率较高的心血管疾病，并且有一个很显著的特点是在发病前不易被诊断发现。75%以上的急性冠状动脉综合症其潜在的病理机制被论证为动脉粥样硬化斑块断裂，因此，检测和表征易断裂的斑块是心脏病学和生物医学成像研究中最活跃的领域之一。

[3] 目前已有多种医学成像技术可以用来诊断血管动脉粥样硬化的病变情况。血管造影技术是现今检测血管动脉粥样硬化斑块的主要手段，用来确定动脉粥样硬化血管狭窄的位置和程度。它将造影剂在X光照射下快速注入血管当中，因为造影剂吸收X光进而可以实现显影。从显影的结果可以看到含有造影剂的血液流动，从而了解血管的生理和解剖的变化。血管造影术是一种很有价值的诊断血管相关疾病的方法，但是它仅能提供被造影剂充填的管腔轮廓，而不能显示管壁的病变性质和程度，血管中大部分的易损斑块用血管造影技术检测不出来。

[4] 医学超声成像技术以其无创、无辐射、实时性好、对软组织鉴别力较高、仪器使用方便、价格低廉等特点，成为现代医学成像中不可替代的诊断技术，目前已成为临床多种疾病诊断的首选方法。

[5] 血管内超声(Intravascular ultrasound, IVUS)成像技术为医学超声成像中专门应用于心血管疾病检测的一种特殊成像技术。该技术利用安装在导管顶端的微型超声探头（或探针）插入到人体血管内疑似病变的位置进行二维组织成像。它不仅可以实时显示血管内壁的形态，而且还可以通过组织平面分析和三维重建对病变大小进行测量，为深入了解血管病变的形态和功能提供了新的视野，同时也为临床诊断和治疗提供更加准确可靠的信息。血管

内超声成像技术除了可显示管腔形态和血管壁信息之外，还可以初步确定粥样硬化斑块的组织形态学特征；同时，通过准确的定量分析，测量血管直径、横截面积和狭窄程度，可识别血管造影不能发现的早期动脉粥样硬化病变，尤其对血管造影显示的临界病变，血管内超声成像技术可对其进行精确的定量分析，确定其狭窄程度及病变类型，以协助临床治疗方案的选择。血管内超声成像技术在指导冠状动脉介入式治疗方面也具有非常重要的应用价值。因为该技术可以准确的反应血管内部形貌、病变的性质以及严重程度等情况，从而为选择正确的治疗策略提供依据，例如选择尺寸合适的支架等。同时血管内超声成像技术可用于术后支架治疗效果的评价，例如支架扩张是否充分、是否完全贴壁、是否均匀的展开并完全覆盖病变等，有利于及时发现和纠正支架植入后存在的某些问题，以达到最佳的介入治疗效果。

[6] 血管内超声成像技术是一种无创性的超声技术和有创性的导管技术相结合的使用末端连接有超声探针的特殊导管进行的医学成像技术，能够显示病变所在的管壁和粥样斑块，提高诊断的准确性。现今使用的血管内超声换能器，主要是高频平面单阵元血管内超声换能器和高频环形阵列血管内超声换能器。

[7] 目前，传统血管内超声导管一般为单阵元换能器的机械导管和线阵换能器的电子相控阵导管。

[8] 机械导管由导管尾端连接滑环驱动，而换能器在导管前端，导管长度一般在 1.5m 左右，血管弯曲容易在导管和护管之间产生比较大的摩擦力，造成导管前端的换能器不均匀旋转，获得的超声图像容易失真，造成成像的清晰度和精准度变差。

[9] 电子相控阵导管制作难度大，成像系统复杂，相对来说频率比较低，成像分辨率不高。

[10] 有鉴于此，需要一种新的血管内超声成像装置。

发明内容

[11] 针对上述现有技术的不足，本发明提供了一种双换能器血管内超声成像装置，相对于普通机械导管，能够进行角度补偿，成像更稳定，有助

于医生进行更精确的诊断；并且，两个换能器可以同时工作，因此在同一次转动可以成像两幅图，因此可以大幅度提高超声成像的帧频。

本发明提供了一种双换能器血管内超声成像装置，包括导管以及位于导管前端的超声探头，所述超声探头位于所述导管内，所述超声探头包括两个超声换能器，所述两个超声换能器背对背设置，同时或分时发送超声声束进行成像，其中所述两个超声换能器具有共同的背衬层。

[12] 优选地，所述两个超声换能器为分层结构，包括第一匹配层、第一压电层、背衬层、第二压电层和第二匹配层。

[13] 优选地，每个所述超声换能器的匹配层为一层匹配层或多层匹配层。

[14] 优选地，所述超声换能器是单阵元平面换能器，单阵元聚焦换能器，多阵元平面换能器或多阵元聚焦换能器。

[15] 优选地，所述超声换能器的中心频率范围为 15MHz~120MHz。

[16] 优选地，所述两个超声换能器的中心频率相同或不同。

[17] 优选地，所述超声探头具有外壳，所述两个超声换能器设置在所述外壳内，所述外壳为中空圆柱形结构，直径范围为 0.4 毫米-3 毫米。

[18] 优选地，所述超声探头的外壳的侧壁上具有两个相对设置的开口，所述两个超声换能器分别通过所述两个开口进行超声波发射和接收。

[19] 优选地，所述导管包括护管、金属软管和同轴电缆，所述超声换能器的所述背衬层具有凹槽，所述同轴电缆的负极线在所述凹槽与所述背衬层连接。

[20] 优选地，所述压电层的材料为压电陶瓷、压电单晶材料、压电复合材料、PVDF 材料或其他压电材料。

[21] 优选地，所述成像装置还包括连接器，所述连接器的一端与所述导管连接，另一端连接成像系统和旋转回撤装置，用于信号传输和超声探头旋转回撤。

[22] 本发明的有益效果：

[23] 本发明的双换能器血管内超声成像装置，包括两个高频单阵元换能器，工作时两个换能器可以同时进行超声波发射和接收，可以获得更多血

管内组织信息。另外，本发明的两个超声换能器共用背衬层，可以大大减小多层结构的换能器的厚度。换能器晶片的厚度直接影响血管内超声导管的尺寸，晶片越薄，导管直径越小，超声成像装置能够在更细小的血管中进行检测，提高了本装置的实用性。

附图说明

[24] 图 1 是本发明的双换能器血管内超声成像装置的结构示意图。

[25] 图 2 是本发明的双换能器血管内超声成像装置中的导管前端（超声成像探头）结构示意图。

[26] 图 3 是本发明的双换能器血管内超声成像装置中的超声换能器的结构示意图，其中（a）为换能器（侧面）与同轴电缆的连接示意图，（b）为换能器的正面示意图。

[27] 图 4 是本发明的双换能器血管内超声成像装置中的双换能器工作示意图。

具体实施方式

[28] 下面结合附图对本发明的具体实施例进行说明。在下文所描述的本发明的具体实施例中，为了能更好地理解本发明而描述了一些很具体的技术特征，但显而易见的是，对于本领域的技术人员来说，并不是所有的这些技术特征都是实现本发明的必要技术特征。下文所描述的本发明的一些具体实施例只是本发明的一些示例性的具体实施例，其不应被视为对本发明的限制。另外，为了避免使本发明变得难以理解，对于一些公知的技术没有进行描述。

[29] 图 1 是本发明的双换能器血管内超声成像装置结构示意图。如图 1 所示，本发明的血管内超声成像装置包括连接器 1，导管 2 和超声探头 3。连接器 1 的一端与导管 2 连接，另一端连接成像系统和旋转回撤装置（未图示），用于信号传输和超声探头旋转回撤。连接器 1 上具有阀门 11，阀门 11 用于给超声导管里注入生理盐水，挤出导管内的空气，并作为超声耦合剂使用。导管 2 从外到内依次具有护管 21、金属软管 22 和换能器线缆（同轴电

缆) 23, 也具有传输信号和探头回撤的功能, 并且导管 2 还具有导丝 24 (见图 2) 和定位环等装置 (未图示), 能够定位换能器所处的位置, 以及引导换能器在血管内移动。超声探头 3 位于导管 2 的前端 (即远离连接器 1 的一端), 用于进行超声成像。

[30] 如图 2 是本发明的双换能器血管内超声成像装置中的导管前端结构示意图即超声成像探头的结构示意图。如图 2 所示, 超声探头 3 具有外壳 31, 以及固定在外壳 31 内的两个换能器 4。两个超声换能器 4 背对背设置, 同时或分时发送超声声束进行成像。外壳 31 为铜或其他金属材料的外壳。换能器 4 (换能器晶片) 使用生物兼容胶水固定在外壳 31 内。具体地, 整个超声探头 3 位于护管 21 内, 金属软管 22 固定在所述外壳 31 的一端侧。工作时, 超声探头 3 旋转, 护管 21 和导丝 24 保持不动。

[31] 本发明中, 超声探头 3 的外壳 31 为中空圆柱形结构, 直径为 0.4 毫米-3 毫米。超声探头 3 的外壳 31 的侧壁上具有两个相对设置的开口 32, 两个超声换能器 4 分别通过两个开口 32 进行超声波发射和接收。在另外的实施中, 探头外壳 31 也可以为其他形状的结构。

[32] 下面结合图 3 详细说明两个超声换能器的结构。本发明中, 换能器 4 可以是单阵元平面换能器, 单阵元聚焦换能器, 多阵元平面换能器或多阵元聚焦换能器。如图 3 (b) 所示, 两个超声换能器 4 为分层结构, 包括第一匹配层 41、第一压电层 42、共用背衬层 43、第二压电层 44 和第二匹配层 45。匹配层 41、45 和背衬层 43 为导电材料。压电层的材料为压电陶瓷、压电单晶材料、压电复合材料、PVDF 材料或其他压电材料。本发明中, 两个超声换能器 4 的第一匹配层和第二匹配层的数量可以分别为一层或多层。图 3 (b) 所示的结构为第一匹配层和第二匹配层分别为一层匹配层的情况。在匹配层分别为两层的实施例中, 两个超声换能器包括第一匹配层、第二匹配层, 第一压电层、背衬层、第二压电层、第三匹配层和第四匹配层。

[33] 如图 3 (a) 所示, 导管 2 的同轴电缆 23 的两根正极线 23a 通过导电粘接剂 46 分别粘接在第一匹配层 41、第二匹配层 45 上, 也可以通过焊接的方式与匹配层连接; 同轴电缆 23 的负极线 23b 通过导电粘接剂 46 粘接在背衬层 43 上, 也可以通过焊接的方式与共用背衬层 43 连接。本发明中,

两个超声换能器具有共同的背衬层 43。

[34] 本发明通过两个超声换能器共用背衬层，可以大大减小多层结构的换能器的厚度。因为血管内超声成像装置器件对厚度要求很高，减小换能器厚度将大大提高装置的实用性。本发明的两个换能器的共用背衬层的厚度仅约 300 微米，而在两个换能器分别具有自己的背衬层的情况下，其背衬层加起来约 600 微米。换能器晶片的厚度直接影响血管内超声导管的尺寸，晶片越薄，导管直径越小，超声成像装置能够在更细小的血管中进行检测，提高了本发明的超声成像装置的实用性。

[35] 在另外的优选实施例中，超声换能器的共用背衬层 43 还具有凹槽 43a，同轴电缆的负极线 23b 在该凹槽内通过粘接剂 46 与背衬层 43 连接。这种结构可以使得换能器的引线连接更可靠。

[36] 本发明中，两个超声换能器 4 的中心频率可以相同或不同，两个超声换能器的中心频率范围为 15MHz~120MHz。

[37] 图 4 是本发明的双换能器血管内超声成像装置中的双换能器工作示意图。如图所示，通过旋转超声探头，两个换能器 4 绕超声探头的外壳的中心轴转动，同时或分时发送超声声束进行双声束成像工作。通过本发明中的双换能器结构，两个换能器同时工作进行超声波发射和接收，可以获得更多血管内组织信息。

[38] 尽管已经根据优选的实施方案对本发明进行了说明，但是存在落入本发明范围之内的改动、置换以及各种替代等同方案。还应当注意的是，存在多种实现本发明的方法和系统的可选方式。因此，意在将随附的权利要求书解释为包含落在本发明的主旨和范围之内的所有这些改动、置换以及各种替代等同方案。

权 利 要 求 书

1. 一种双换能器血管内超声成像装置，包括导管以及位于导管前端的超声探头，所述超声探头位于所述导管内，其特征在于，

所述超声探头包括两个超声换能器，所述两个超声换能器背对背设置，同时或分时发送超声声束进行成像，

其中，所述两个超声换能器具有共同的背衬层。

2. 根据权利要求 1 所述的双换能器血管内超声成像装置，其特征在于，所述两个超声换能器为分层结构，包括第一匹配层、第一压电层、所述背衬层、第二压电层和第二匹配层。

3. 根据权利要求 2 所述的双换能器血管内超声成像装置，其特征在于，每个所述超声换能器的匹配层为一层匹配层或多层匹配层。

4. 根据权利要求 1 所述的双换能器血管内超声成像装置，其特征在于，所述超声换能器是单阵元平面换能器，单阵元聚焦换能器，多阵元平面换能器或多阵元聚焦换能器。

5. 根据权利要求 1 所述的双换能器血管内超声成像装置，其特征在于，所述超声换能器的中心频率范围为 15MHz~120MHz。

6. 根据权利要求 1 所述的双换能器血管内超声成像装置，其特征在于，所述两个超声换能器的中心频率相同或不同。

7. 根据权利要求 1 所述的双换能器血管内超声成像装置，其特征在于，所述超声探头具有外壳，所述两个超声换能器设置在所述外壳内，所述外壳为中空圆柱形结构，直径范围为 0.4 毫米-3 毫米。

8. 根据权利要求 1 所述的双换能器血管内超声成像装置，其特征在于，所述超声探头的外壳的侧壁上具有两个相对设置的开口，所述两个超声换能器分别通过所述两个开口进行超声波发射和接收。

9. 根据权利要求 1 所述的双换能器血管内超声成像装置，其特征在于，所述导管包括护管、金属软管和同轴电缆，所述超声换能器的所述背衬层具

有凹槽，所述同轴电缆的负极线在所述凹槽与所述背衬层连接。

10. 根据权利要求 2 所述的双换能器血管内超声成像装置，其特征在于，所述压电层的材料为压电陶瓷、压电单晶材料、压电复合材料、PVDF 材料或其他压电材料。

11. 根据权利要求 1 所述的双换能器血管内超声成像装置，其特征在于，还包括连接器，所述连接器的一端与所述导管连接，另一端连接成像系统和旋转回撤装置，用于信号传输和超声探头旋转回撤。

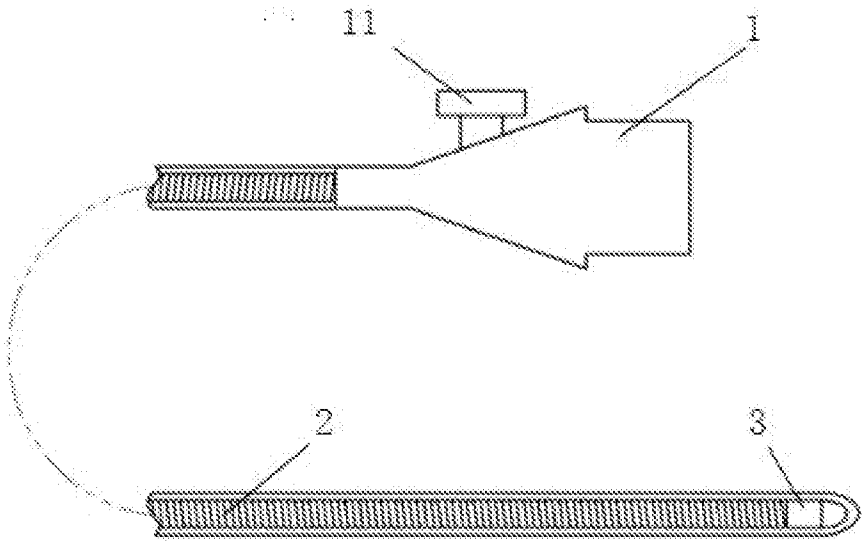


图 1

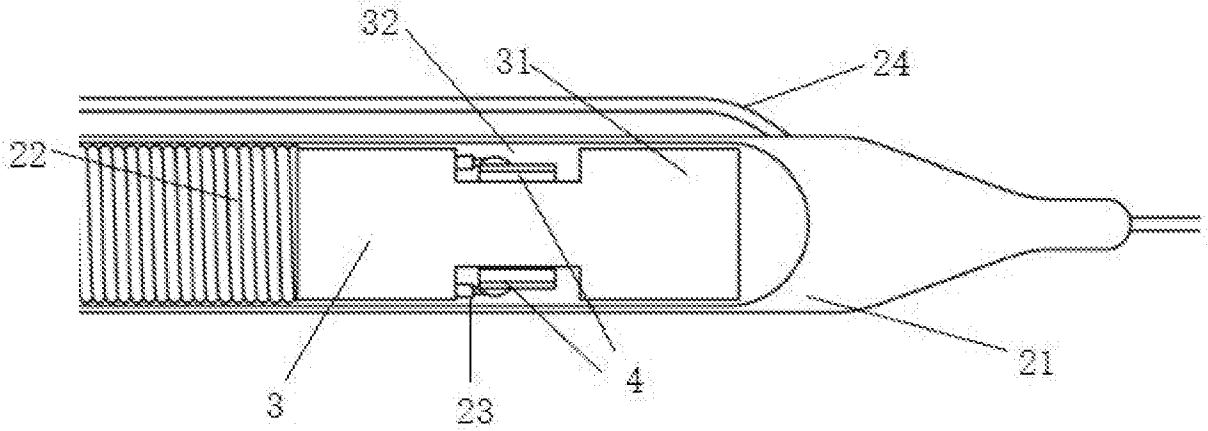


图 2

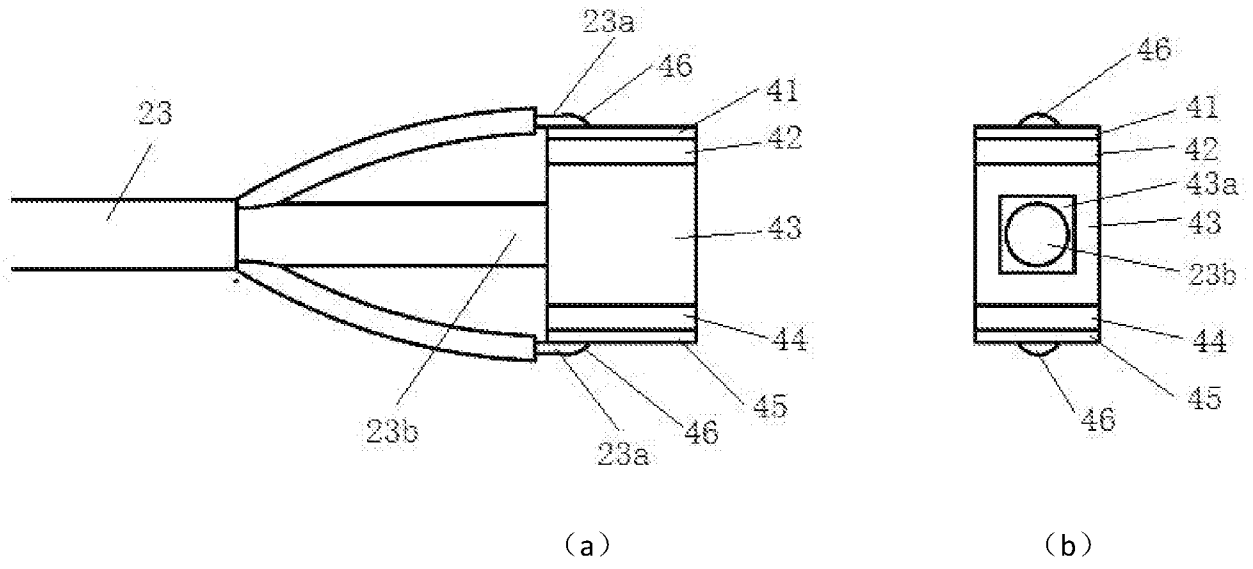


图 3

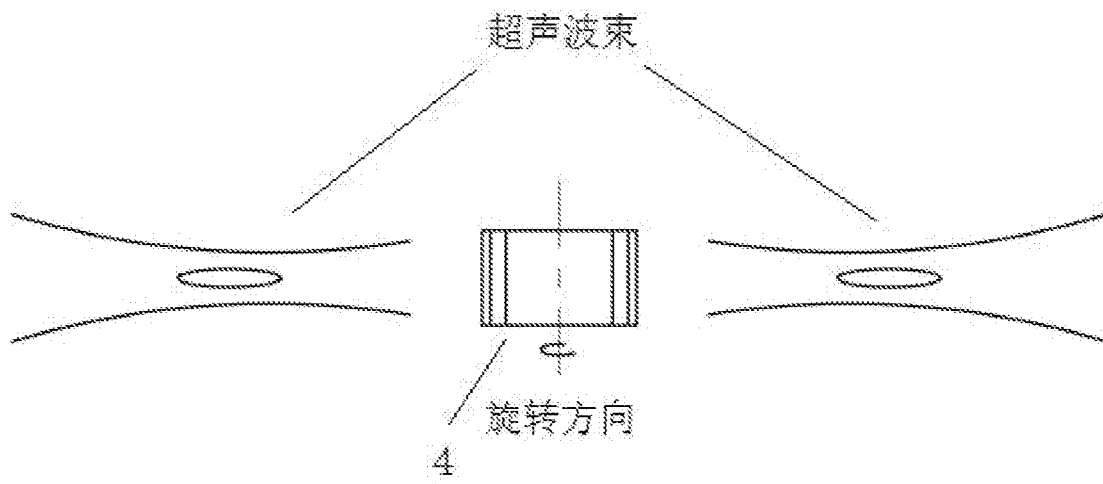


图 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2017/110141

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61B 8/12 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61B 8

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS; CNKI; CNTXT; VEN; USTXT; EPTXT: 深圳先进技术研究院, 郑海荣, 探头, 传感, 探针, 感测, 多, 两, 共同, 公共, 相同, 背衬, 衬底, back, match, multi +, sensor, two, common+, mutual +, same+, share+

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
E	CN 107550519 A (SHENZHEN INSTITUTES OF ADVANCED TECHNOLOGY) 09 January 2018 (09.01.2018), claims 1-12, and description, paragraphs [0032]-[0048]	1-11
Y	CN 107260213 A (SUZHOU INSTITUTE OF BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES) 20 October 2017 (20.10.2017), claims 1-14, and description, paragraphs [0027]-[0031] and [0050]-[0058], and figures 1 and 2	1-11
Y	CN 102481170 A (KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.) 30 May 2012 (30.05.2012), claims 1-8, and description, paragraphs [0027], [0057]-[0060] and [0064], and figures 3-6	1-11

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 June 2018

Date of mailing of the international search report

16 July 2018

Name and mailing address of the ISA
State Intellectual Property Office of the P. R. China
No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao
Haidian District, Beijing 100088, China
Facsimile No. (86-10) 62019451

Authorized officer

GUI, Yechen

Telephone No. (86-512) 88997277

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2017/110141

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 107550519 A	09 January 2018	None	
CN 107260213 A	20 October 2017	None	
CN 102481170 A	30 May 2012	CN 102481170 B	31 December 2014
		US 2012136351 A1	31 May 2012
		RU 2544468 C2	20 March 2015
		IN 201201529 P4	21 June 2013
		US 9788892 B2	17 October 2017
		JP 5676613 B2	25 February 2015
		EP 2470099 A1	04 July 2012
		RU 2012111803 A	10 October 2013
		WO 2011024133 A1	03 March 2011
		JP 2013502967 A	31 January 2013
		EP 2470099 B1	14 October 2015

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2017/110141

A. 主题的分类 A61B 8/12 (2006.01) i 按照国际专利分类 (IPC) 或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类														
B. 检索领域 检索的最低限度文献 (标明分类系统和分类号) A61B8 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 在国际检索时查阅的电子数据库 (数据库的名称, 和使用的检索词 (如使用)) CNABS; CNKI; CNTXT; VEN; USTXT; EPTXT; 深圳先进技术研究院, 郑海荣, 探头, 传感, 探针, 感测, 多, 两, 共同, 公共, 相同, 背衬, 衬底, back, match, multi+, sensor, two, common+, mutual+, same+, share+														
C. 相关文件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>类 型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>CN 107550519 A (深圳先进技术研究院) 2018年 1月 9日 (2018 - 01 - 09) 权利要求1-12, 说明书第[0032]-[0048]段</td> <td>1-11</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 107260213 A (中国科学院苏州生物医学工程技术研究所) 2017年 10月 20日 (2017 - 10 - 20) 权利要求1-14, 说明书第[0027]-[0031]、[0050]-[0058]段, 附图1、2</td> <td>1-11</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 102481170 A (皇家飞利浦电子股份有限公司) 2012年 5月 30日 (2012 - 05 - 30) 权利要求1-8, 说明书第[0027]、[0057]-[0060]、[0064]段, 附图3-6</td> <td>1-11</td> </tr> </tbody> </table>			类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	E	CN 107550519 A (深圳先进技术研究院) 2018年 1月 9日 (2018 - 01 - 09) 权利要求1-12, 说明书第[0032]-[0048]段	1-11	Y	CN 107260213 A (中国科学院苏州生物医学工程技术研究所) 2017年 10月 20日 (2017 - 10 - 20) 权利要求1-14, 说明书第[0027]-[0031]、[0050]-[0058]段, 附图1、2	1-11	Y	CN 102481170 A (皇家飞利浦电子股份有限公司) 2012年 5月 30日 (2012 - 05 - 30) 权利要求1-8, 说明书第[0027]、[0057]-[0060]、[0064]段, 附图3-6	1-11
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求												
E	CN 107550519 A (深圳先进技术研究院) 2018年 1月 9日 (2018 - 01 - 09) 权利要求1-12, 说明书第[0032]-[0048]段	1-11												
Y	CN 107260213 A (中国科学院苏州生物医学工程技术研究所) 2017年 10月 20日 (2017 - 10 - 20) 权利要求1-14, 说明书第[0027]-[0031]、[0050]-[0058]段, 附图1、2	1-11												
Y	CN 102481170 A (皇家飞利浦电子股份有限公司) 2012年 5月 30日 (2012 - 05 - 30) 权利要求1-8, 说明书第[0027]、[0057]-[0060]、[0064]段, 附图3-6	1-11												
☐ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。														
* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件 (如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件														
国际检索实际完成的日期 2018年 6月 22日		国际检索报告邮寄日期 2018年 7月 16日												
ISA/CN的名称和邮寄地址 中华人民共和国国家知识产权局 (ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10) 62019451		授权官员 桂叶晨 电话号码 86- (0512) -88997277												

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2017/110141

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
CN	107550519	A	2018年 1月 9日	无	
CN	107260213	A	2017年 10月 20日	无	
CN	102481170	A	2012年 5月 30日	CN	102481170 B 2014年 12月 31日
				US	2012136351 A1 2012年 5月 31日
				RU	2544468 C2 2015年 3月 20日
				IN	201201529 P4 2013年 6月 21日
				US	9788892 B2 2017年 10月 17日
				JP	5676613 B2 2015年 2月 25日
				EP	2470099 A1 2012年 7月 4日
				RU	2012111803 A 2013年 10月 10日
				WO	2011024133 A1 2011年 3月 3日
				JP	2013502967 A 2013年 1月 31日
				EP	2470099 B1 2015年 10月 14日