



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102920593 A

(43) 申请公布日 2013. 02. 13

(21) 申请号 201210496318. 4

(22) 申请日 2012. 11. 29

(71) 申请人 王时灿

地址 250002 山东省济南市玉函路 69 号

(72) 发明人 王时灿 王婧儒

(51) Int. Cl.

A61H 33/06 (2006. 01)

A61M 37/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54) 发明名称

一种阴部理疗椅

(57) 摘要

一种阴部理疗椅,包括椅架、控制面板、药桶组件、水箱温控探头、电热风机、水箱、喷头传动组合体、喷头、废液盘移动滑轨、废液盘传动系统。本理疗椅对阴部进行药物熏蒸、温水冲洗、热风烘干,能够促进肌体血液循环,加快新陈代谢,使阴部及腹部的病变得以吸收,对预防阴部感染及腹部炎症的发生也起到良好的保健作用。

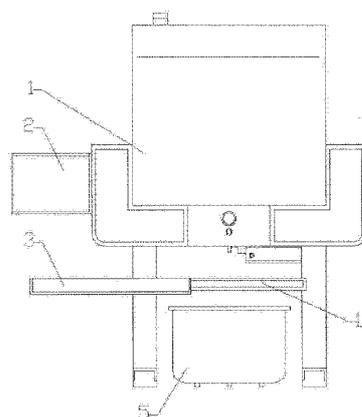

1. 一种阴部理疗椅,包括椅架、控制面板、带漏嘴废液盘、药桶组件、水箱温控探头、电热风机、水箱、喷头传动组合体、喷头、废液盘传动系统,其特征是,所述控制面板安装于理疗椅扶手处,所述水箱位于理疗椅靠背后侧,所述药桶组件位于椅面空洞正下方,所述带漏嘴废液盘位于药桶组件上方,所述电热风机安装于椅面空洞中央的后下方靠近椅背侧。

2. 根据权利要求1所述的一种阴部理疗椅,其特征是,所述的控制面板表面设置有水箱加热加压按钮、药桶加热保温按钮、暖风按钮、废液盘导轨左右移动按钮、喷头前后移动按钮、复位按钮。

3. 根据权利要求1所述的一种阴部理疗椅,其特征是,所述的水箱底部设置有加热盘,所述的水箱顶部安装有温控探头,水箱底部设有软橡胶管,软橡胶管与喷头相连,所述的喷头转动组合体与喷头通过齿轮咬合。

4. 根据权利要求1所述的一种阴部理疗椅,其特征是,所述的废液盘传动系统包括电机、废液盘移动滑轨并固定于椅腿部,所述带漏嘴废液固定于废液盘移动滑轨末段,所述的带漏嘴废液盘通过软管与废液桶相连,所述废液桶位设于椅面下方、药桶组件后方。

5. 根据权利要求1所述的一种阴部理疗椅,其特征是,所述的药桶组件包括药桶和设置在药桶底部的加热盘。

6. 根据权利要求1所述的一种阴部理疗椅,其特征是,所述的电热风机由控制面板操控。

一种阴部理疗椅

技术领域

[0001] 本发明涉及一种理疗装置,具体是一种阴部理疗椅。

背景技术

[0002] 目前,现有技术对妇科病、男科病、痔疮等疾患的治疗,大多采用药物、针灸、手术等治疗方法,也有采用专用医疗器械治疗的方法,如利用微波、短波,激光、磁疗等物理疗法,患者必须到专业医疗机构接受治疗,患者花费较高,而且挂号、听诊候诊均需要大量时间给患者带来诸多不便。

发明内容

[0003] 针对以上不足,本发明提供了一种阴部理疗椅。

[0004] 其技术方案是:一种阴部理疗椅,包括椅架、控制面板、药桶组件、带带漏嘴废液盘、水箱温控探头、电热风机、水箱、喷头传动组合体、喷头、废液盘传动系统,其特征是,上述的控制面板安装于理疗椅扶手处,上述的水箱位于理疗椅靠背后侧,上述的药桶组件位于椅面空洞正下方,上述的电热风机安装于椅面空洞中央的后下方靠近椅背侧。

[0005] 一种阴部理疗椅,其特征是,上述的控制面板表面设置有水箱加热加压按钮、药桶加热保温按钮、暖风按钮、废液盘导轨左右移动按钮、喷头前后移动按钮、复位按钮。

[0006] 一种阴部理疗椅,其特征是,上述的药桶组件包括药桶和设置在药桶底部的加热盘。

[0007] 一种阴部理疗椅,其特征是,上述的水箱底部设置有加热盘,上述的水箱顶部安装有温控探头,水箱底部设有软橡胶管,软橡胶管与喷头相连,上述的喷头转动组合体通过齿轮带动喷头前后移动。

[0008] 一种阴部理疗椅,其特征是,上述的废液盘传动系统包括电机、废液盘移动滑轨并固定于椅腿部,上述的带漏嘴废液固定于废液盘移动滑轨末段,上述的带漏嘴废液盘通过软管与废液桶相连,上述的废液桶设于椅面下方、药桶组件后方。

[0009] 一种阴部理疗椅,其特征是,上述的电热风机由控制面板操控。

[0010] 一种阴部理疗椅的有益效果:一是通过对药桶内的药液进行加温熬制后,在对阴部进行药物熏蒸,使患有妇科病、男科病、痔疮等疾病的使用者得到良好的治疗,熏蒸的时间、温度是按需可调的。二是本理疗椅的发明,对中老年及行动不便者的阴部卫生保健,提供了一种良好的保健器械。三是本理疗椅对阴部进行药物熏蒸、温水冲洗、热风烘干,能够促进肌体血液循环,加快新陈代谢,使阴部及腹部的病变得以吸收,对预防阴部感染及腹部炎症的发生也起到良好的保健作用。四是由于本发明采用先进的电子技术、合理的机械结构,使该椅具有功能齐全,结构简单、美观大方、一椅多用,使用者可在家自行操做,无危害及副作用。

附图说明:

[0011] 附图 1 是本发明的正视图

[0012] 附图 2 是本发明的侧视图

[0013] 附图 3 是本发明的俯视图

[0014] 附图 4 是本发明的电路示意图

[0015] 1 椅架、2 控制面板、3 带漏嘴废液盘、4 废液桶、5 药桶组件、6 温控探头、7 电热风机、8 水箱、9 软橡胶管、10 喷头传动组合体、11 废液盘移动滑轨、12 软橡胶管、13 废液盘传动系统、14 喷头。

具体实施方式

[0016] 如图 4 所示,一种阴部理疗椅,椅面中央的空洞呈椭圆形,是根据人体臀部形态而设计的,本理疗椅的目的是采取如下技术方案实现的,理疗椅包括椅架 1、控制面板 2、带漏嘴废液盘 3、废液桶 4、药桶组件 5、温控探头 6、电热风机 7、水箱 8、软橡胶管 9、喷头传动组合体 10、废液盘移动滑轨 11、软橡胶管 12、废液盘传动系统 13、喷头 14。

[0017] 将中药和水混合后的药液放入椅面空洞下面的药桶中,药桶对内部药液加热至沸腾后,再熬制 5-10 分钟,断电后使用者可坐在治疗椅上接受熏蒸治疗,若药液温度降低,可随时对药液加温以保持适宜的温度;熏蒸结束后,喷头传动组合体驱动喷头至椅面空洞正下方,同时废液盘移动滑轨驱动带漏嘴废液盘移至药桶上方,喷头喷水对阴部进行温水清洗,其水温在 38-45℃之间即可,废液流入废液盘,进而流入废液桶;清洗结束后,电热风机对阴部进行热风烘干。以上程序均可通过人力操控控制面板完成,方便卫生。

[0018] 实施例

[0019] 一种阴部理疗椅,包括椅架、控制面板、药桶组件、水箱温控探头、电热风机、水箱、喷头传动组合体、喷头、废液盘移动滑轨、废液盘传动系统,其特征是,上述的控制面板安装于理疗椅扶手处,上述的水箱位于理疗椅靠背后侧,上述的药桶组件位于椅面空洞正下方,上述的电热风机安装于椅面空洞中央的后下方靠近椅背侧。

[0020] 在使用阴部康复治疗椅时,首先要向药桶内加入 30-50g 的按临床医生配制的中药,再向药桶内加入 2/3 容积的水,对中药进行浸泡 3-5 分钟后,打开控制面板 (2) 上的电源开关,对水箱 (8) 及药桶内的药液加温,水箱的可调温度控制在 38-45℃之间,药桶内的药液沸腾后再熬 5-10 分钟方可使用,药桶的加热温度可控在 60-104℃之间;熏蒸结束后,喷头传动组合体 (10) 驱动喷头至椅面空洞正下方,同时废液盘移动滑轨 (11) 驱动带漏嘴废液盘 (3) 移至药桶上方,喷头 (14) 喷水对阴部进行温水清洗,其水温在 38-45℃之间,废液流入带漏嘴废液盘,进而通过软橡胶管 (12) 流入废液桶 (4);清洗结束后,电热风机 (7) 对阴部进行热风烘干,程序结束后按复位按钮,理疗椅恢复初始状态,以上程序均可通过人力操控控制面板 (2) 完成。

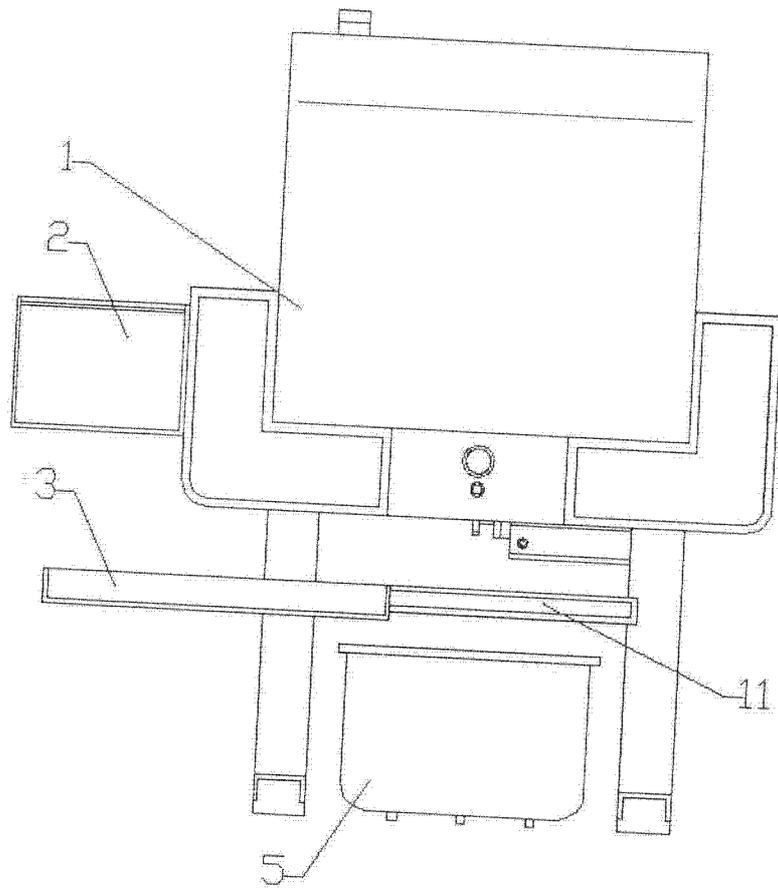


图 1

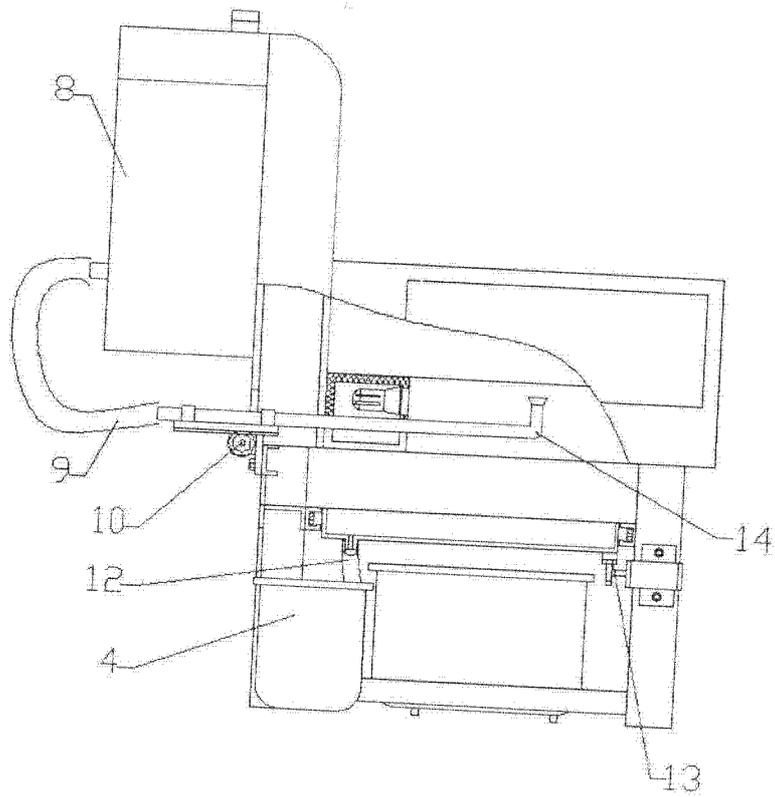


图 2

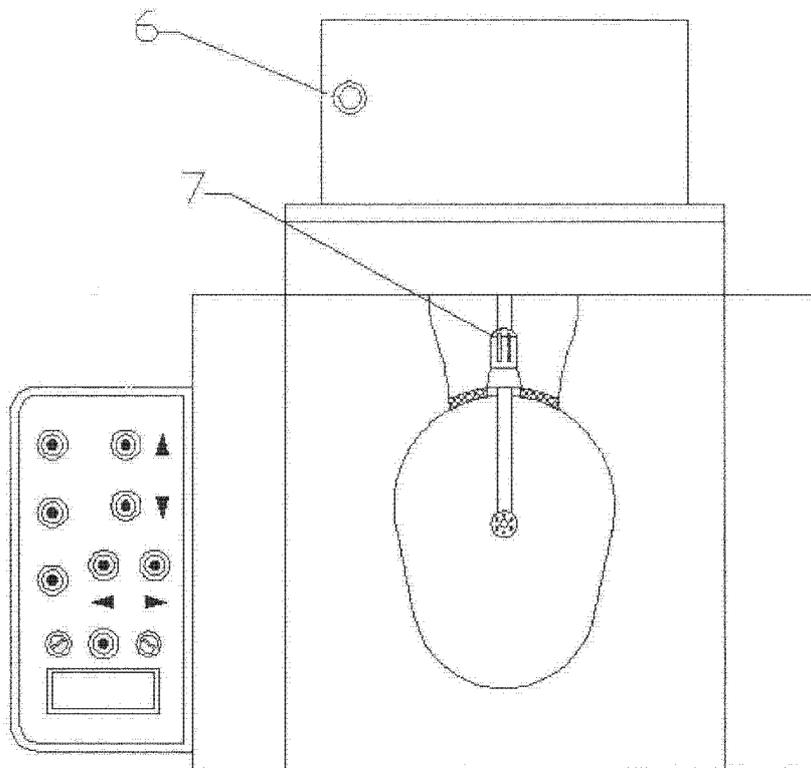


图 3

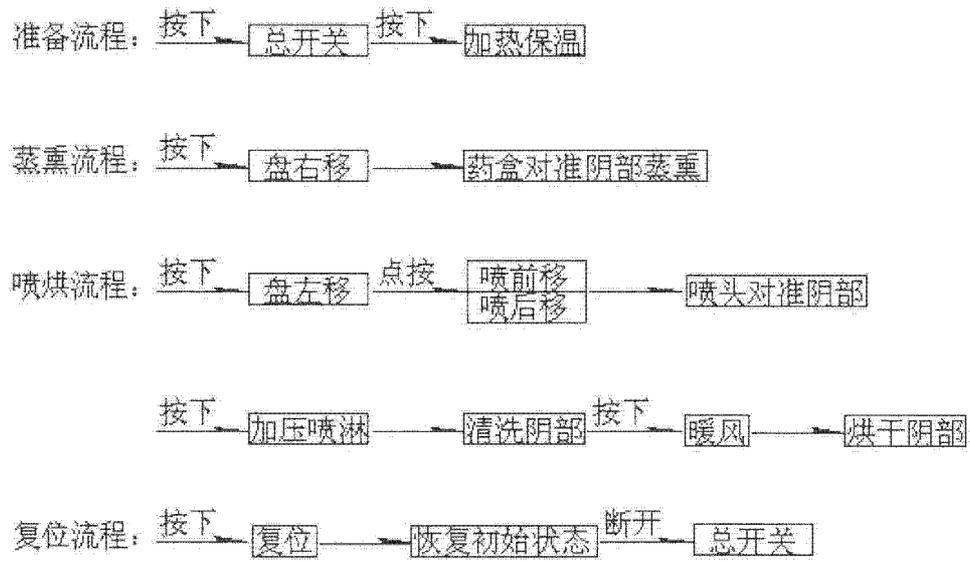


图 4