



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205411509 U

(45)授权公告日 2016.08.03

(21)申请号 201620004979.4

(22)申请日 2016.01.06

(73)专利权人 宿迁市中医院

地址 223800 江苏省宿迁市洪泽湖东路

(72)发明人 吴文静

(74)专利代理机构 宿迁市永泰睿博知识产权代
理事务所(普通合伙) 32264

代理人 陈臣

(51)Int.Cl.

A61G 7/07(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种胎膜早破臀部抬高垫

(57)摘要

本实用新型公开了一种胎膜早破臀部抬高垫,包括臀垫本体,臀垫本体的底面为水平面,臀垫本体的上表面依次包括腰垫、臀垫、腿垫,腿垫包括第一腿垫、第二腿垫,腰垫与水平面呈15~30°夹角,第一腿垫与水平面平行,第二腿垫与水平面30°夹角,臀垫形状为凹槽形,臀垫的最高点到臀垫本体的底面的距离为10cm,臀垫的最低点到臀垫本体的底面的距离为8cm,臀垫本体的底面长度为90cm,臀垫本体的外侧包覆有一层与臀垫本体外形相同的PU革,PU革的外侧包覆有一层棉布套。本实用新型结构简单、使用方便,根据人体脊柱生长特点,采用凹槽与斜坡设计,符合人体力学需求,促进孕妇舒适,有效减少羊水流出血量,避免脐带脱垂,预防护理并发症,具有很高的使用价值。

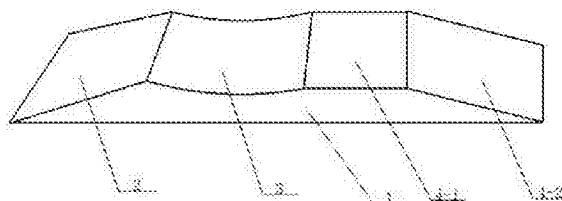

1. 一种胎膜早破臀部抬高垫, 包括臀垫本体, 其特征在于: 所述臀垫本体的底面为水平面, 臀垫本体的上表面依次包括腰垫、臀垫、腿垫, 所述腿垫包括第一腿垫、第二腿垫, 腰垫与水平面呈 $15\sim 30^{\circ}$ 夹角, 臀垫形状为凹槽形, 第一腿垫与水平面平行, 第二腿垫与水平面呈 30° 夹角。

2. 如权利要求1所述一种胎膜早破臀部抬高垫, 其特征在于: 所述臀垫的最高点到臀垫本体的底面的距离为10cm。

3. 如权利要求1所述一种胎膜早破臀部抬高垫, 其特征在于: 所述臀垫的最低点到臀垫本体的底面的距离为8cm。

4. 如权利要求1所述一种胎膜早破臀部抬高垫, 其特征在于: 所述臀垫本体的底面长度为90cm。

5. 如权利要求1所述一种胎膜早破臀部抬高垫, 其特征在于: 所述臀垫本体的材质为高级海绵。

6. 如权利要求1所述一种胎膜早破臀部抬高垫, 其特征在于: 所述臀垫本体的外侧包覆有一层与臀垫本体外形相同的PU革。

7. 如权利要求6所述一种胎膜早破臀部抬高垫, 其特征在于: 所述PU革的外侧包覆有一层棉布套。

一种胎膜早破臀部抬高垫

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗用品技术领域,具体涉及一种胎膜早破臀部抬高垫。

背景技术

[0002] 胎膜早破是指在临产前胎膜自然破裂。破膜后孕妇应卧床休息,抬高臀部,使头低臀高,以防止脐带脱垂,尤其是臀位和双胞胎产妇。目前,临床上大多采用直接在孕妇的臀下垫枕头的方法,此种方法存在如下不足:(1)流出的羊水易造成皮损,不容易计量;(2)单纯臀部抬高,不仅使得孕妇感觉不舒服、而且翻身不方便,安全性及稳定性较差,极易导致一些护理并发症的产生,因此,亟待开发一种能够使孕妇感到舒适、使用方便、减少羊水流出,预防脐带脱垂的助产卧具。

实用新型内容

[0003] 针对背景技术的不足,本实用新型根据人体脊柱生长特点,研究设计了一种胎膜早破臀部抬高垫,其目的在于:提供一种结构简单,便于更换、清洗,消毒,使用方便、减少羊水流出、预防脐带脱垂的胎膜早破臀部抬高垫。

[0004] 本实用新型的技术解决方案:

[0005] 一种胎膜早破臀部抬高垫,包括臀垫本体,其特征在于:所述臀垫本体的底面为水平面,臀垫本体的上表面依次包括腰垫、臀垫、腿垫,所述腿垫包括第一腿垫、第二腿垫。

[0006] 所述腰垫与水平面呈 $15^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 夹角。

[0007] 所述第一腿垫与水平面平行,第二腿垫与水平面 30° 夹角。

[0008] 所述臀垫形状为凹槽形。

[0009] 所述臀垫的最高点到臀垫本体的底面的距离为10cm。

[0010] 所述臀垫的最低点到臀垫本体的底面的距离为8cm。

[0011] 所述臀垫本体的底面长度为90cm。

[0012] 所述臀垫本体的材质为高级海绵。

[0013] 所述臀垫本体的外侧包覆有一层与臀垫本体外形相同的PU革。

[0014] 所述PU革的外侧包覆有一层棉布套。

[0015] 本实用新型的有益效果:本实用新型结构简单、使用方便,根据人体脊柱生长特点,采用凹槽与斜坡设计,符合人体力学需求,促进孕妇舒适,有效减少羊水流出量,避免脐带脱垂,预防护理并发症,具有很高的使用价值。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0017] 图2为本实用新型的主视结构示意图。

[0018] 其中:1、臀垫本体,2、腰垫,3、臀垫,4-1、第一腿垫,4-2、第二腿垫。

具体实施方式

[0019] 以下结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步说明。

[0020] 如图1、图2所示,一种胎膜早破臀部抬高垫,包括臀垫本体1,臀垫本体1的底面为水平面,臀垫本体1的上表面依次包括腰垫2、臀垫3、腿垫,腿垫包括第一腿垫4-1、第二腿垫4-2,腰垫2与水平面呈 $15^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 夹角,第一腿垫4-1与水平面平行,第二腿垫4-2与水平面 30° 夹角,臀垫3形状为凹槽形,臀垫3的最高点到臀垫本体1的底面的距离为10cm,臀垫3的最低点到臀垫本体1的底面的距离为8cm,臀垫本体1的底面长度为90cm,臀垫本体1的材质为高级海绵,臀垫本体1的外侧包覆有一层与臀垫本体1外形相同的PU革,PU革的外侧包覆有一层棉布套。

[0021] 具体使用过程:

[0022] 操作时,将本实用新型的胎膜早破臀部抬高垫放于床中间,胎膜早破孕妇穿出血计量垫,取平卧或侧卧位,头部置低枕,高度在 $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$ 之间,孕妇将腰置于腰垫上,臀部置于臀垫内,大腿放置在第一腿垫上,小腿放置在第二腿垫上,孕妇在使用时可以根据自身身高及自身舒适度选择合适的垫子,本实用新型的垫子根据人体脊柱生长特点,采用凹槽与斜坡设计,不同体重的压迫使海绵缓冲 $2\sim 3\text{cm}$,有效减少孕妇羊水流出量,避免脐带脱垂,较大的提高孕妇的舒适度。

[0023] 综上,本实用新型达到预期效果。

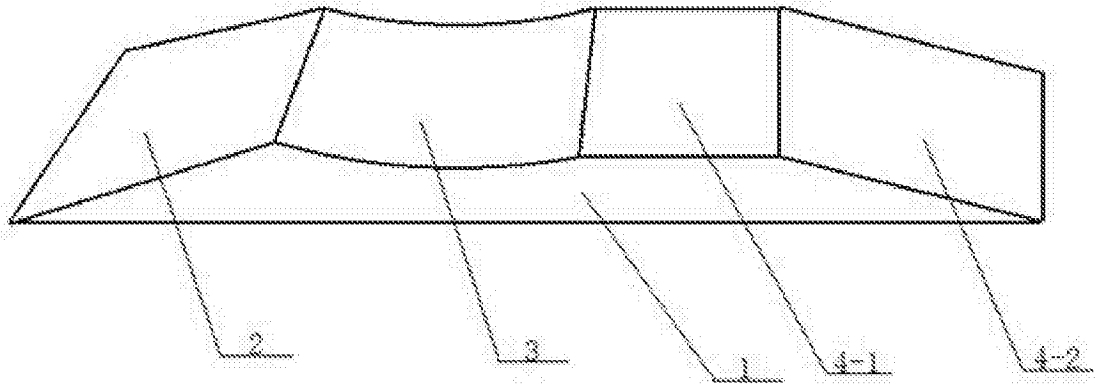


图1

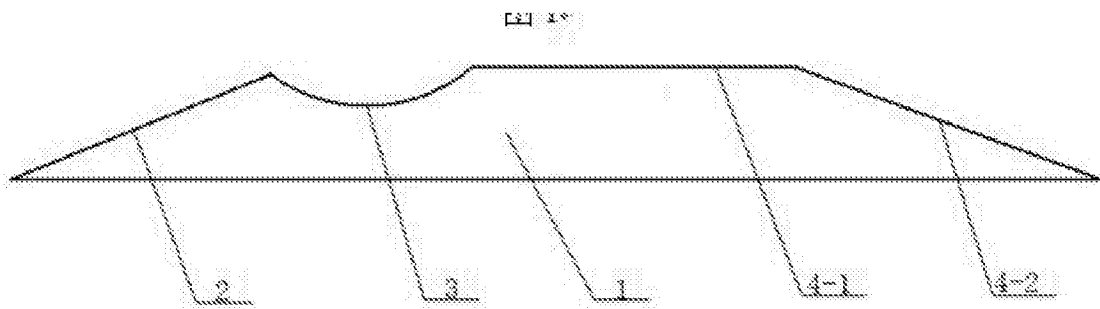


图2