



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D226594 S

(45)公告日：中華民國 112 (2023) 年 07 月 21 日

(21)申請案號：111304600

(22)申請日：中華民國 111 (2022) 年 09 月 15 日

(51)LOC.(13)Cl.：13-03

(30)優先權：2022/03/15 美國 29/830,795

(71)申請人：瑞士商諾萬可有限公司(瑞士) NOVOCURE GMBH (CH)
瑞士(72)設計人：雅可畢 艾利 YAACOBI, ELIE (IL)；哈拉維 諾雅 HALAVEE, NOA (IL)；葛路
什科 尤里 GLUSHKOV, YURI (IL)；勒維 亞倫 LEVY, AHARON (IL)；羅曾堡
奧默 ROZENBERG, OMER (IL)；克里尼茲奇 麥寇 KRINITSKY, MICHAEL
(IL)；戈隆 迪米崔 GOLOM, DMITRY (IL)；史密斯 皮特森 凱斯琳 SMITH-
PETERSON, KATHRYN (US)

(74)代理人：陳長文

(56)參考文獻：

TW	D211095	CN	306105399
JP	D1699246	US	D898202
US	D937420		


審查人員：謝孟峰

圖式數：14 共 11 頁

(54)名稱

醫療治療設備

代表圖：

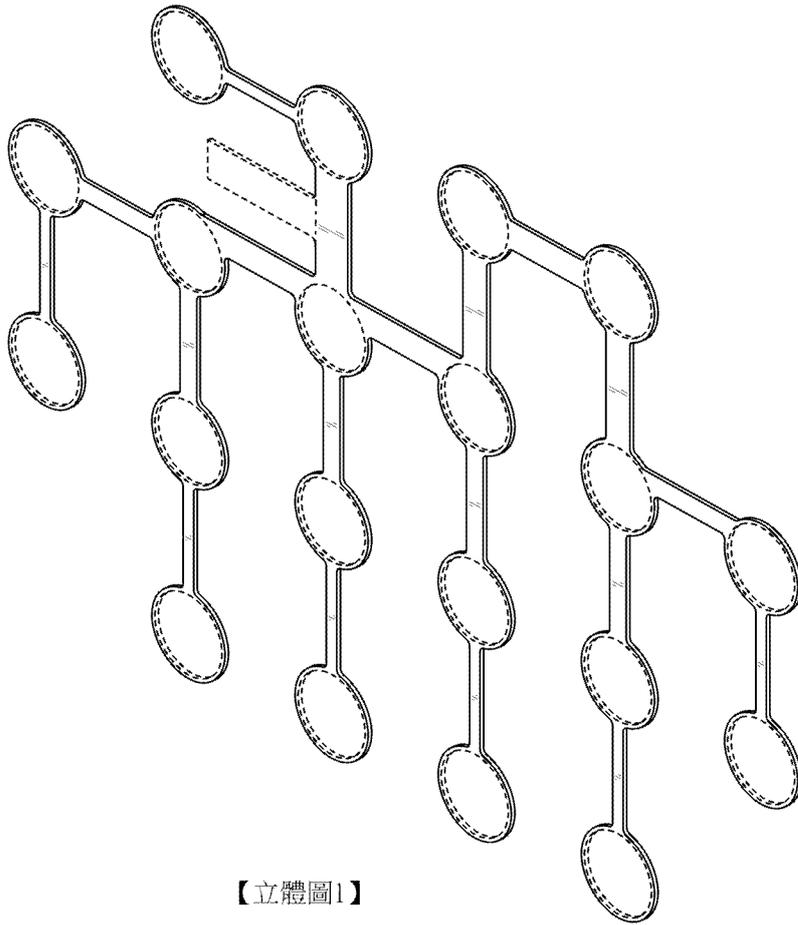

【立體圖1】



D226594

【設計說明書】

【中文設計名稱】

醫療治療設備

【英文設計名稱】

MEDICAL TREATMENT APPARATUS


【物品用途】

【0001】 本設計係關於一種醫療治療設備，其可用作(例如)用於提供腫瘤治療電場之醫療治療設備、用於哺乳動物之醫療治療設備、電極總成、用於哺乳動物之電極總成、用於提供腫瘤治療電場之電極總成、電極陣列、用於提供腫瘤治療電場之電極陣列、用於哺乳動物之電極陣列、用於電極陣列之電路板、用於電極陣列之電路、印刷電路板或用於電極總成之印刷電路板。


【設計說明】

【0002】 圖式中具有一致劃線長度(劃線-劃線-劃線)之虛線，為本案不主張設計之部分。

【0003】 圖式中具有不一致劃線長度(短劃線-中劃線-短劃線)之虛線表示本設計之邊界。

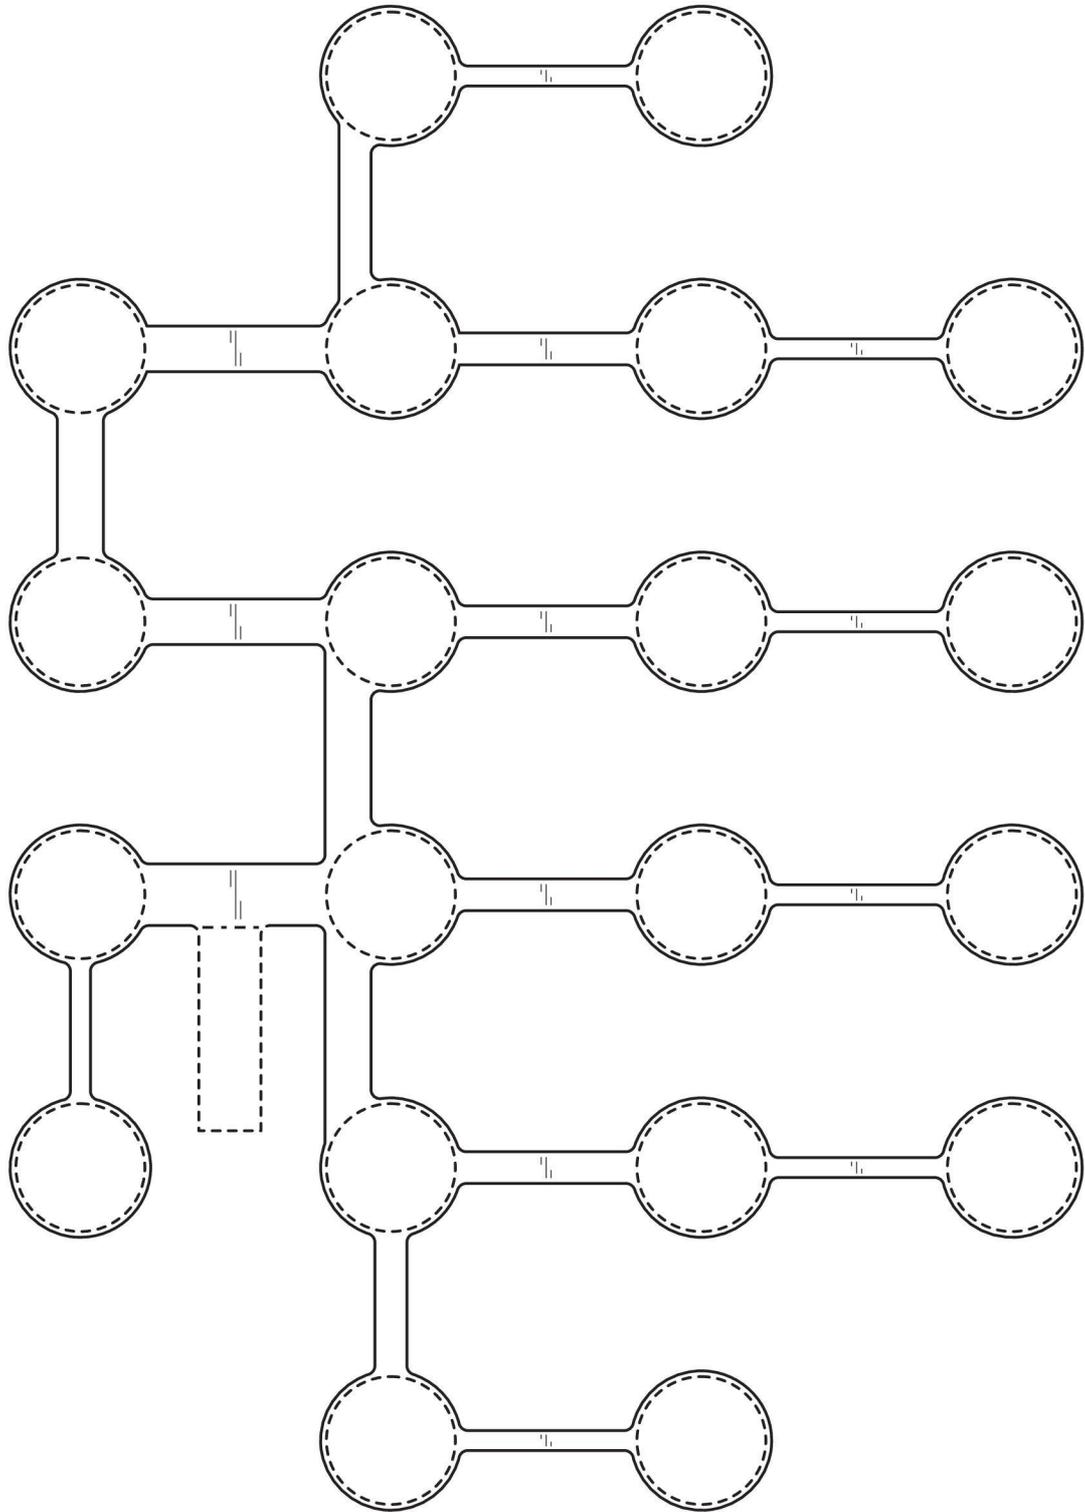

【前視圖】

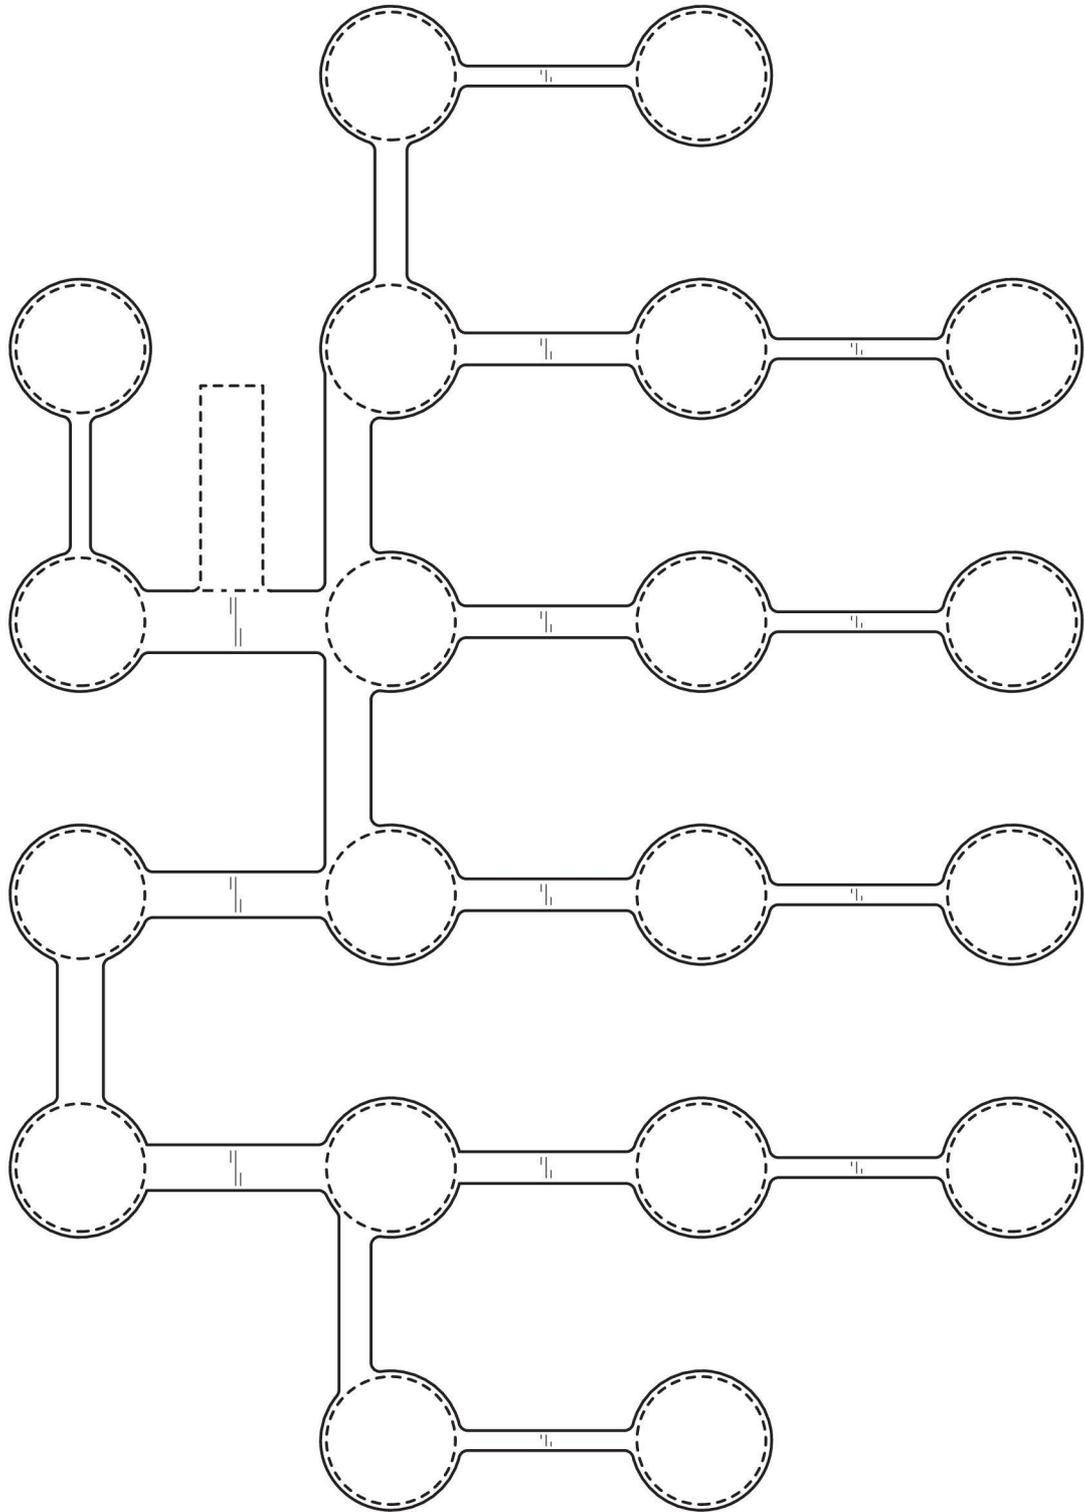

【後視圖】



【右側視圖】




【左側視圖】




【俯視圖】




【仰視圖】

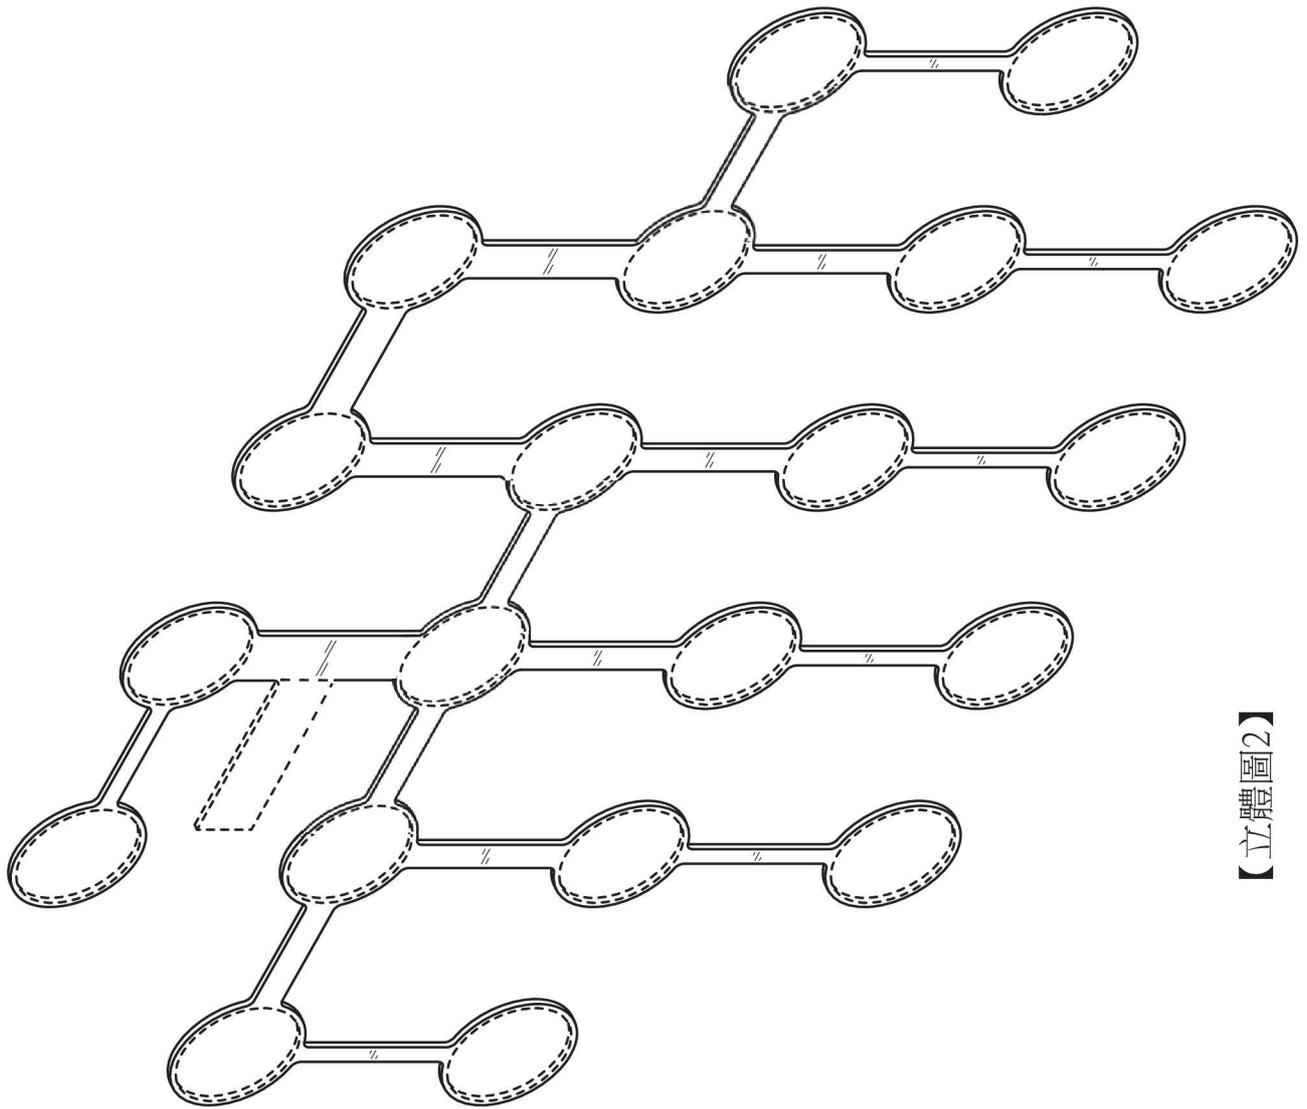

【立體圖2】

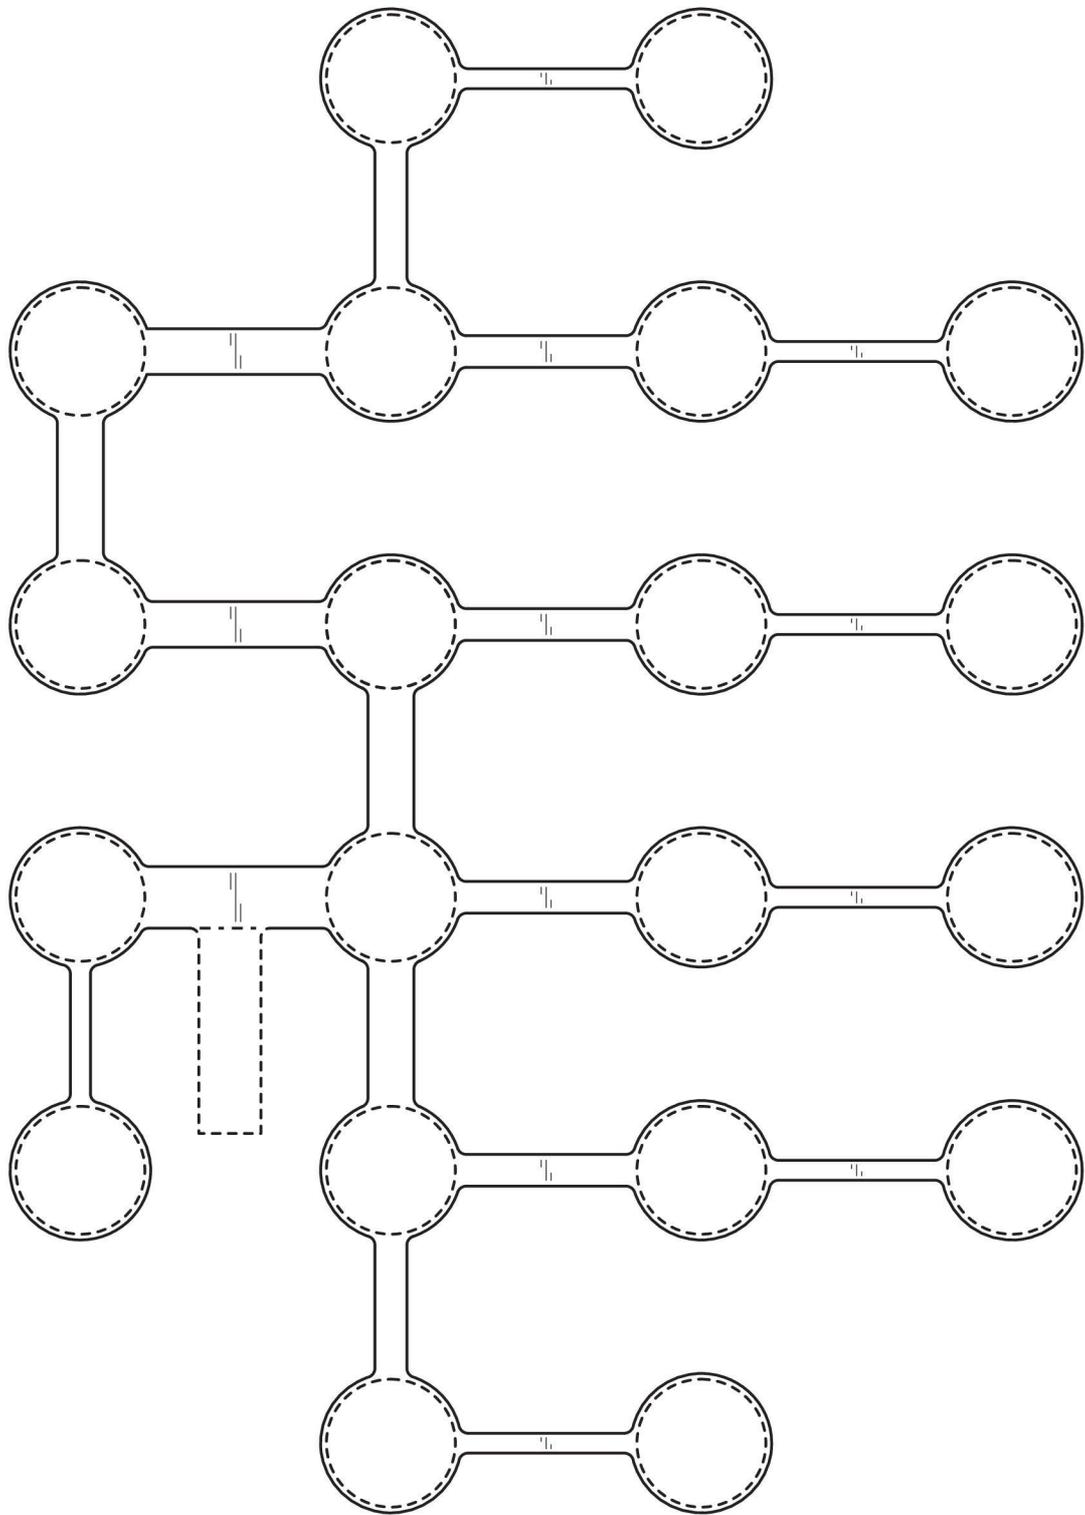

【前視圖】

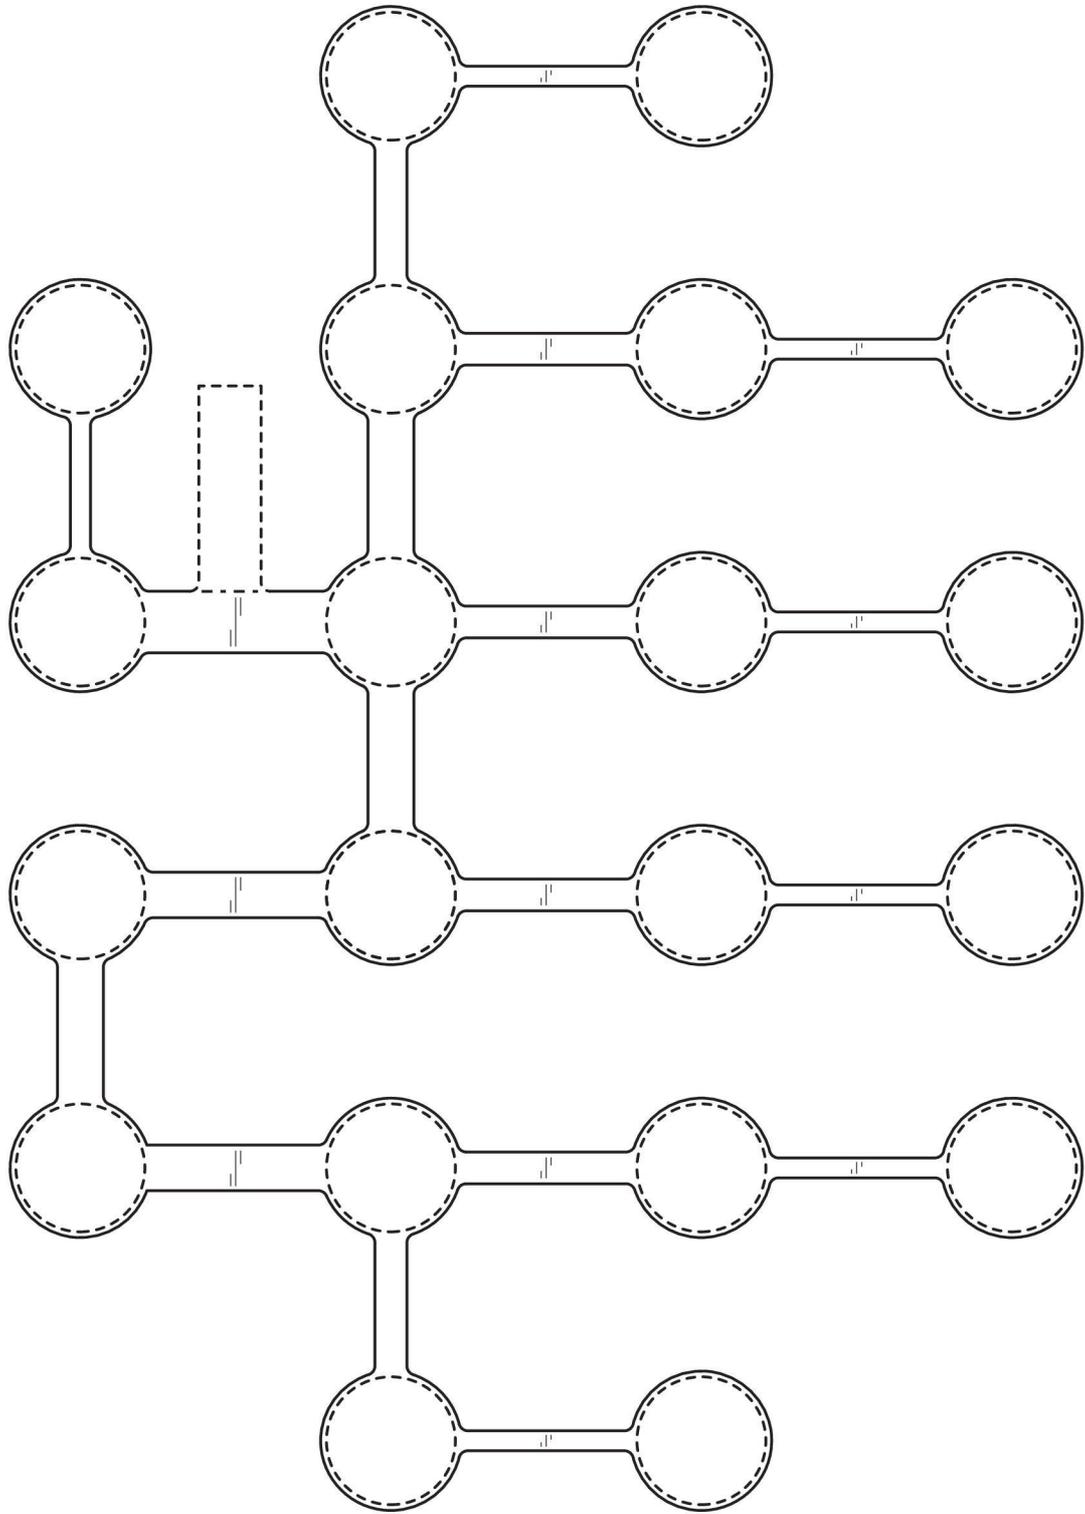

【後視圖】



【右側視圖】



【左側視圖】



【俯視圖】



【仰視圖】