

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 9 月 1 日(01.09.2016)



(10) 国際公開番号
WO 2016/136051 A1

- (51) 国際特許分類:
A61B 5/08 (2006.01) *A61B 7/04* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/082505
- (22) 国際出願日: 2015 年 11 月 19 日(19.11.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2015-039258 2015 年 2 月 27 日(27.02.2015) JP
- (71) 出願人: オムロンヘルスケア株式会社(OMRON HEALTHCARE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6170002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 5 3 番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: 朝井 慶(ASAI, Kei); 〒6170002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 5 3 番地 オムロンヘルスケア株式会社内 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 鮫島 睦, 外(SAMEJIMA, Mutsumi et al.); 〒5300017 大阪府大阪市北区角田町 8 番 1 号梅


田 阪 急 ビ ル オ フ ィ ス タ ワ ー 青 山 特 許 事 務 所
Osaka (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[続葉有]

(54) Title: WHEEZING-RELATED INFORMATION DISPLAY DEVICE

(54) 発明の名称: 喘鳴関連情報表示装置

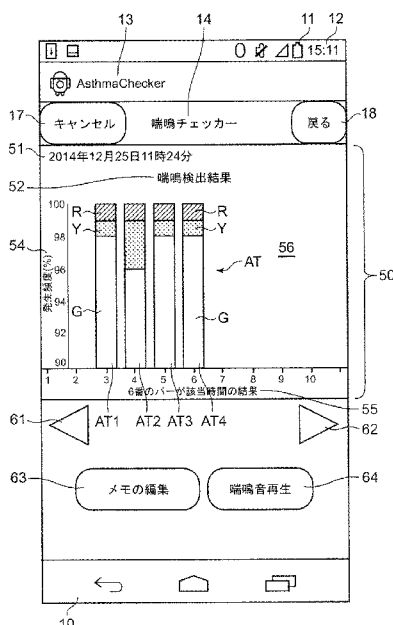

- 14 Wheeze checker
17 Cancel
18 Return
51 25 December 2014, 11:24
52 Wheezing detection result
54 Frequency of occurrence
55 Number six is the result for the time in question
63 Edit memo
64 Wheeze playback

(57) Abstract: This wheezing-related information display device is provided with: a breathing sound detection unit that detects the breathing sounds of a subject and acquires a chronological breathing sound signal representing the breathing sounds; a determination processing unit that determines whether wheezing is included in the breathing sounds for each of predetermined processing unit periods on the basis of the breathing sound signal; and a display processing unit that displays information (AT) representing changes in wheezing frequency over time on a display screen (10) on the basis of the determination result of the determination processing unit.

(57) 要約: 本発明の喘鳴関連情報表示装置は、被験者の呼吸音を検知して、その呼吸音を表す時系列の呼吸音信号を取得する呼吸音検知部を備える。呼吸音信号に基づいて、予め定められた処理単位期間毎に、呼吸音に喘鳴が含まれているか否かを判定する判定処理部を備える。判定処理部の判定結果に基づいて、喘鳴の頻度の時間推移を表す情報 (AT) を表示画面 (10) に表示する表示処理部を備える。

WO 2016/136051 A1



OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

明 細 書

発明の名称：喘鳴関連情報表示装置

技術分野

[0001] この発明は喘鳴関連情報表示装置に関し、より詳しくは、被験者の呼吸音に含まれた喘鳴に関する情報を表示する喘鳴関連情報表示装置に関する。

背景技術

[0002] 例えば特許文献1（US 2011/0125044 A1）には、喘息などの呼吸器疾患を監視するための自動化されたシステムが開示されている。このシステムは、マイクロフォンと加速度計からのデータに基づいて、症状の重症度が閾値に達したときに、データの要約と警報を提供する。特に、喘鳴については、約200～800Hzの範囲の周波数での周波数スペクトルのピークを測定し、その周波数スペクトルのピークとメモリに格納されている喘鳴に関連付けられた所定の値とを比較して、その比較結果を重症度判定のための要素としている。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：US 2011/0125044 A1

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] ところで、広く知られているように、患者が喘息であるか否かを医師が診断する場合、喘鳴の頻度の時間推移が、診断材料の一つとなっている。

[0005] しかしながら、特許文献1（US 2011/0125044 A1）では、喘鳴の頻度の時間推移を表示することについては、開示されていない。

[0006] そこで、この発明の課題は、被験者の呼吸音に含まれた喘鳴の頻度の時間推移を表示できる喘鳴関連情報表示装置を提供することにある。

課題を解決するための手段

[0007] 上記課題を解決するため、この発明の喘鳴関連情報表示装置は、

被験者の呼吸音を検知して、その呼吸音を表す時系列の呼吸音信号を取得する呼吸音検知部と、

上記呼吸音信号に基づいて、予め定められた処理単位期間毎に、上記呼吸音に喘鳴が含まれているか否かを判定する判定処理部と、

上記判定処理部の判定結果に基づいて、上記喘鳴の頻度の時間推移を表す情報を表示画面に表示する表示処理部とを備えたことを特徴とする。

[0008] ここで、「処理単位期間」は、典型的には、判定処理部が演算処理に要する時間の程度に設定される。例えば、判定処理部の演算能力に応じて、0.05秒間、または0.1秒間というように、様々に設定され得る。

[0009] この発明の喘鳴関連情報表示装置では、呼吸音検知部が、被験者の呼吸音を検知して、その呼吸音を表す時系列の呼吸音信号を取得する。判定処理部は、上記呼吸音信号に基づいて、予め定められた処理単位期間毎に、上記呼吸音に喘鳴が含まれているか否かを判定する。表示処理部は、上記判定処理部の判定結果に基づいて、上記喘鳴の頻度の時間推移を表す情報を表示画面に表示する。したがって、ユーザ（典型的には、上記被験者自身、上記被験者のケアを行う保護者・介護者、または、看護師などの医療従事者などを指す。）は、被験者の呼吸音に含まれた喘鳴の頻度の時間推移を知ることができる。喘鳴の頻度の時間推移がリアルタイムに分かれれば、喘息の病状が悪化傾向にあるのかが分かるため、投薬等の事前処置が可能となり、喘息の増悪予防にもつながる。また、上記喘鳴の頻度の時間推移を表す情報を記憶部（例えば、メモリなど）に記憶させておけば、ユーザは、上記被験者の次回の受診時にその情報を記憶部から読み出して表示画面に表示させることで、上記被験者の呼吸音に含まれた喘鳴の頻度の時間推移を医師に見せることができる。この結果、医師は、上記被験者が喘息であるか否かや喘息の重症度を診断し易くなり、治療方針を容易に立てることができる。

[0010] 一実施形態の喘鳴関連情報表示装置では、上記表示処理部は、上記喘鳴の頻度の時間推移を表す情報として、上記処理単位期間を複数含む集計単位期

間毎の、上記判定処理部によって喘鳴が含まれていると判定された処理単位期間の頻度を表示することを特徴とする。

[0011] ここで、「集計単位期間」は、例えば30秒間、1分間、2分間、5分間、10分間、30分間、1以上24未満の数の時間、1日間、1週間、または1ヶ月間というように、様々に設定され得る。

[0012] この一実施形態の喘鳴関連情報表示装置では、上記表示処理部は、上記喘鳴の頻度の時間推移を表す情報として、上記処理単位期間を複数含む集計単位期間毎の、上記判定処理部によって喘鳴が含まれていると判定された処理単位期間の頻度を表示する。したがって、ユーザは、上記喘鳴の頻度の上記集計単位期間毎の時間推移を知ることができる。

[0013] 一実施形態の喘鳴関連情報表示装置では、さらに、

上記集計単位期間内における上記喘鳴が含まれていると判定された処理単位期間の長さを集計して喘鳴期間として求める集計処理部を備え、

上記表示処理部は、上記喘鳴の頻度の時間推移を表す情報を、上記集計単位期間に対応する一定の長さの帯において上記喘鳴期間が占める割合を示す帯グラフとして表示することを特徴とする。

[0014] この一実施形態の喘鳴関連情報表示装置では、集計処理部が、上記集計単位期間内における上記喘鳴が含まれていると判定された処理単位期間の長さを集計して喘鳴期間として求める。上記表示処理部は、上記時間推移を表す情報を、上記集計単位期間に対応する一定の長さの帯において上記喘鳴期間が占める割合を示す帯グラフとして表示する。したがって、ユーザは、上記帯グラフを見ることによって、上記集計単位期間内における上記喘鳴の頻度を、視覚を通して直感的に知ることができる。

[0015] 一実施形態の喘鳴関連情報表示装置では、上記表示処理部は、上記表示画面に、それぞれ上記集計単位期間に対応する複数の帯を平行に並べて表示することを特徴とする。

[0016] この一実施形態の喘鳴関連情報表示装置では、上記表示処理部は、上記表示画面に、それぞれ上記集計単位期間に対応する複数の帯を平行に並べて表

示する。したがって、ユーザは、上記喘鳴の頻度の上記集計単位期間毎の時間推移を、視覚を通して直感的に知ることができる。

[0017] 一実施形態の喘鳴関連情報表示装置では、

上記集計処理部は、上記処理単位期間毎に、上記呼吸音信号を周波数空間へ変換して上記呼吸音の周波数スペクトルを取得し、上記周波数スペクトルにおける複数のピークのうち周波数対音圧グラフ上で最大の面積を与える支配的ピーク的面積に基づいて喘鳴音のパワーを複数の段階に分類するとともに、上記喘鳴が含まれていると判定された処理単位期間の長さを上記分類された段階毎に集計し、

上記表示処理部は、上記集計処理部による集計に基づいて、上記集計単位期間に対応する上記帯において上記喘鳴期間を上記各段階毎に区分して表示することを特徴とする喘鳴関連情報表示装置。

[0018] ここで、上記周波数スペクトルにおける「ピーク」とは、音の強度（音圧）のピークを指す。上記周波数スペクトルにおけるピークの「面積」は、周波数対音圧グラフ上でのピークの「面積」を指す。また、周波数対音圧グラフ上に背景ノイズが存在する場合には、背景ノイズが除去されたピークの実質的な「面積」を指す（後述のピークの「高さ」と「幅」についても同様である。）。

[0019] 上記周波数スペクトルにおけるピーク的面積は、そのピーク（周波数成分）のエネルギーに対応する。したがって、ピーク的面積、特に支配的ピーク的面積が喘鳴の重症度に対応すると言える。ここで、この一実施形態の喘鳴関連情報表示装置では、上記集計処理部は、上記処理単位期間毎に、上記呼吸音信号を周波数空間へ変換して上記呼吸音の周波数スペクトルを取得し、上記周波数スペクトルにおけるピーク的面積に基づいて喘鳴音のパワーを複数の段階に分類するとともに、上記喘鳴が含まれていると判定された処理単位期間の長さを上記分類された段階毎に集計する。上記表示処理部は、上記集計処理部による集計に基づいて、上記集計単位期間に対応する上記帯において上記喘鳴期間を上記各段階毎に区分して表示する。したがって、ユーザ

は、上記帯グラフを見ることによって、上記喘鳴の頻度の集計単位期間毎の時間推移とともに、上記喘鳴音のパワー、つまり喘鳴の重症度の上記集計単位期間毎の時間推移を、視覚を通して直感的に知ることができる。

[0020] 一実施形態の喘鳴関連情報表示装置では、さらに、
上記被験者に対する投薬に関する情報を入力する投薬情報入力部を備え、
上記表示処理部は、上記帯グラフに併せて、上記集計単位期間ごとの上記投薬に関する情報を上記表示画面に表示することを特徴とする。

[0021] ここで、「投薬に関する情報」としては、例えば、投薬された薬剤の種類や投薬時期を表す情報が含まれる。

[0022] この一実施形態の喘鳴関連情報表示装置では、ユーザは、投薬情報入力部によって、上記被験者に対する投薬に関する情報を入力する。上記表示処理部は、上記帯グラフに併せて、上記集計単位期間ごとの上記投薬に関する情報を上記表示画面に表示する。したがって、ユーザは、上記集計単位期間内における上記喘鳴の頻度とともに、上記投薬に関する情報を、視覚を通して直感的に知ることができる。これにより、ユーザや、上記表示画面を見せてもらった医師は、上記被験者に対する投薬による効果（喘鳴の頻度の減少）があったか否かを容易に判断することができる。

[0023] 一実施形態の喘鳴関連情報表示装置では、さらに、
上記呼吸音検知部が取得した上記呼吸音信号に基づいて、上記被験者の呼吸周期を呼気フェーズと吸気フェーズとに区分して識別するフェーズ識別部と、

上記呼吸音信号のうち上記呼気フェーズと上記吸気フェーズとのいずれか一方または両方のフェーズを選択する指示を入力するフェーズ指示入力部と、

上記呼吸音信号のうち上記フェーズ指示入力部によって指示されたフェーズを録音する録音部と
を備えたことを特徴とする。

[0024] この一実施形態の喘鳴関連情報表示装置では、フェーズ識別部が、上記呼

吸音検知部が取得した上記呼吸音信号に基づいて、上記被験者の呼吸周期を呼気フェーズと吸気フェーズとに区分して識別する。ユーザは、例えば医師の求めに応じて、フェーズ指示入力部によって、上記呼吸音信号のうち上記吸気フェーズと上記呼気フェーズとのいずれか一方または両方のフェーズを選択する指示を入力する。すると、録音部が、上記呼吸音信号のうち上記フェーズ指示入力部によって指示されたフェーズを録音する。したがって、ユーザは、喘鳴の録音内容を次の受診時に医師に聴いてもらうときに、上記呼吸周期のうち医師が求めたフェーズの録音内容を聴いてもらうことができる。

発明の効果

[0025] 以上より明らかなように、この発明の喘鳴関連情報表示装置によれば、被験者の呼吸音に含まれた喘鳴の頻度の時間推移を表示できる。

図面の簡単な説明

[0026] [図1]この発明の一実施形態の喘鳴検出システムの概略的なブロック構成を示す図である。

[図2]図2（A）は、上記喘鳴検出システムを構成する喘鳴検出器の外観を示す図である。図2（B）は上記喘鳴検出器の本体の外観を拡大して示す図である。

[図3]上記喘鳴検出器の本体のブロック構成を示す図である。

[図4]上記喘鳴検出システムを構成するスマートフォンのブロック構成を示す図である。

[図5]図5（A）は、上記喘鳴検出器が被験者としての幼児に装着される態様を示す図である。図5（B）は、上記喘鳴検出器が上記スマートフォンを介して操作される態様を示す図である。

[図6]上記喘鳴検出器のマイクロフォンによって検出された呼吸音信号と、呼吸流量センサによって出力された呼吸流量信号とを併せて示す図である。

[図7]上記呼吸音信号を周波数空間へ変換して得られた周波数スペクトルを例示する図である。

[図8]或る処理単位期間に取得された呼吸音の周波数スペクトルを例示する図である。

[図9]或る喘息患者について、呼吸音の周波数スペクトルに含まれた支配的ピークのL/D値の時間推移と、支配的ピークの面積の時間推移とを併せて示す図である。

[図10]実際に喘鳴無しと観察された正常呼吸音についてのL/D値のデータ度数と、実際に喘鳴有りと観察された呼吸音についてのL/D値のデータ度数とを示すヒストグラム図である。

[図11]喘鳴の頻度の時間推移を表す仕方を模式的に示す図である。

[図12]喘鳴の頻度の時間推移を表す帯グラフをスマートフォンの表示画面に表示した例を示す図である。

[図13]上記喘鳴検出器のマイクロフォンによって検出された呼吸音信号と、その呼吸音信号について算出された包絡線とを併せて示す図である。

[図14]図13中の包絡線と、図6中の呼吸流量信号とを併せて示す図である。

[図15]図15(A)は、上記スマートフォンにインストールされた「喘鳴チェッカー」プログラムの初期メニュー画面を示す図である。図15(B)は、図15(A)において「投薬時」スイッチが押されたときに表示される画面を示す図である。

[図16]図16(A)は、図15(B)において「投薬A」スイッチと「投薬B」スイッチが押されたときに表示される画面を示す図である。図16(B)は、喘鳴の頻度の時間推移を表す帯グラフと、投薬に関する情報とを併せて、スマートフォンの表示画面に表示した例を示す図である。

[図17]上記スマートフォンの表示画面に図12の表示例を表示させる場合の、ユーザの操作手順を示すフロー図である。

[図18]上記スマートフォンの表示画面に図16(B)の表示例を表示させる場合の、ユーザの操作手順を示すフロー図である。

[図19]上記スマートフォンによって呼吸音を録音し、再生する場合の、ユー

ザの操作手順を示すフロー図である。

発明を実施するための形態

[0027] 以下、この発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。

[0028] 図1は、この発明の喘鳴関連情報表示装置の一実施形態である喘鳴検出システム（全体を符号1で示す。）のブロック構成を示している。この喘鳴検出システム1は、喘鳴検出器100と、スマートフォン200とを含んでいる。喘鳴検出器100とスマートフォン200とは、無線通信によって互いに通信可能になっている。

[0029] 図2（A）に示すように、喘鳴検出器100は、本体100Mと、この本体100Mにマイクロフォンプラグ113を介して連結された第1のマイクロフォン111および第2のマイクロフォン112を含んでいる。この例では、第1のマイクロフォン111、第2のマイクロフォン112は、いずれも円形の皿（その凹面には粘着シート119が設けられている。）のような形状をもつ聴診器型に構成されている。第1のマイクロフォン111は被験者の胸の肌に貼り付けられ、また、第2のマイクロフォン112は被験者の衣服に貼り付けられることが予定されている。

[0030] 図2（B）に拡大して示すように、本体100Mには、クリップ100Cと、マイクロフォン端子114と、操作部130と、ヘッドフォン端子116と、電源スイッチ191と、充電端子192と、通信状態表示用LED（発光ダイオード）193とが設けられている。

[0031] クリップ100Cは、本体100Mを被験者の衣服に取り付けるために用いられる。

[0032] マイクロフォン端子114は、マイクロフォンプラグ113が挿入された状態で、第1のマイクロフォン111および第2のマイクロフォン112の出力を取り込むために用いられる。

[0033] 操作部130は、音量増加ボタンスイッチ131と、音量減少ボタンスイッチ132と、通信スイッチ133とを含んでいる。音量増加ボタンスイッチ131は、ヘッドフォン端子116を介して図示しないヘッドフォンへ出

力される音量を増加させるために用いられる。音量減少ボタンスイッチ１３２は、逆に、ヘッドフォンへ出力される音量を減少させるために用いられる。通信スイッチ１３３は、本体１００Ｍとスマートフォン２００との間の近距離無線通信の接続を確立するために用いられる。つまり、通信スイッチ１３３が押されると、公知のプロトコルによって喘鳴検出器１００とスマートフォン２００との間の通信接続が確立されて、近距離無線通信が可能な状態になる。

[0034] 電源スイッチ１９１は、喘鳴検出器１００の電源をオン／オフするために用いられる。

[0035] 充電端子１９２は、本体１００Ｍに内蔵された電池に充電を行うために用いられる。

[0036] 通信状態表示用ＬＥＤ１９３は、喘鳴検出器１００とスマートフォン２００との間の通信状態を表示する。具体的には、喘鳴検出器１００とスマートフォン２００との間の近距離無線通信が未接続であれば、ＬＥＤ１９３は赤色に点灯する。喘鳴検出器１００とスマートフォン２００との間の近距離無線通信の接続が確立途中であれば、ＬＥＤ１９３は緑色に点滅する。喘鳴検出器１００とスマートフォン２００との間の近距離無線通信の接続が確立していれば、ＬＥＤ１９３は緑色に点灯する。近距離無線通信の接続が確立すると、喘鳴検出器１００は、スマートフォン２００からの指示によって動作可能な状態（スタンバイ状態）になる。

[0037] 図３に示すように、喘鳴検出器１００の本体１００Ｍには、既述のヘッドフォン端子１１６、操作部１３０、電源スイッチ１９１および充電端子１９２に加えて、制御部１１０と、音信号処理回路１１５と、メモリ１２０と、近距離無線通信部１８０と、電源部１９０とが搭載されている。

[0038] 音信号処理回路１１５は、この例ではＣＯＤＥＣ－ＩＣ（コーデック集積回路）からなり、第１のマイクロフォン１１１の出力と第２のマイクロフォン１１２の出力とを受けて、第１のマイクロフォン１１１の出力から第２のマイクロフォン１１２の出力を差し引き、得られた差分を表す呼吸音信号を

、制御部１１０とヘッドフォン端子１１６へそれぞれ出力する。ユーザは、ヘッドフォン端子１１６に図示しないヘッドフォンを接続して聴くことによって、呼吸音信号が得られていることを確認できる。なお、第１のマイクロフォン１１１、第２のマイクロフォン１１２および音信号処理回路１１５は、呼吸音検知部を構成している。

[0039] メモリ１２０は、ＲＯＭ（Read Only Memory）とＲＡＭ（Random Access Memory）とを含む。ＲＯＭは、この喘鳴検出器１００を制御するためのプログラムのデータを記憶する。また、ＲＡＭは、この喘鳴検出器１００の各種機能を設定するための設定データ、演算結果のデータなどを記憶する。

[0040] 制御部１１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit；中央演算処理装置）を含み、メモリ１２０に記憶された喘鳴検出器１００を制御するためのプログラムに従って、この喘鳴検出器１００の各部（メモリ１２０および近距離無線通信部１８０を含む。）を制御する。特に、この制御部１１０は、被験者の呼吸音に喘鳴が含まれているか否かを判定し、喘鳴の頻度の時間推移を表す画像データを作成する（詳しくは、後述する。）。

[0041] 電源部１９０は、この例ではリチウムイオン電池（２次電池）を含み、電源スイッチ１９１のオン／オフによってこの喘鳴検出器１００の各部へ電力を供給しまたは供給停止する。このリチウムイオン電池は、充電端子１９２を介して充電可能になっている。

[0042] 近距離無線通信部１８０は、制御部１１０による制御に従って、スマートフォン２００との間で無線通信、この例では近距離無線通信（ＢＴ（Bluetooth（登録商標））通信およびＢＬＥ（Bluetooth low energy）通信）を行う。例えば、スマートフォン２００へ演算結果を表す情報などを送信する。また、スマートフォン２００から操作指示を受信する。

[0043] 図４に示すように、スマートフォン２００は、本体２００Ｍと、この本体２００Ｍに搭載された、制御部２１０と、メモリ２２０と、操作部２３０と、表示部２４０と、スピーカ２６０と、近距離無線通信部２８０と、ネットワーク通信部２９０とを含む。このスマートフォン２００は、市販のスマー

トフォンに、喘鳴に関する情報の処理を行わせるようにアプリケーションソフトウェア（これを「喘鳴チェッカー」プログラムと呼ぶ。）をインストールしたものである。

[0044] 制御部 210 は、CPU およびその補助回路を含み、スマートフォン 200 の各部を制御し、メモリ 220 に記憶されたプログラムおよびデータに従って処理を実行する。例えば、操作部 230 を介して入力された指示に基づいて、通信部 280、290 から入力されたデータを処理し、処理したデータを、メモリ 220 に記憶させたり、表示部 240 で表示させたり、通信部 280、290 を介して出力させたりする。

[0045] メモリ 220 は、制御部 210 でプログラムを実行するために必要な作業領域として用いられる RAM と、制御部 210 で実行するための基本的なプログラムを記憶するための ROM とを含む。また、メモリ 220 の記憶領域を補助するための補助記憶装置の記憶媒体として、半導体メモリ（メモリカード、SSD（Solid State Drive））などが用いられてもよい。

[0046] 操作部 230 は、この例では、表示部 240 上に設けられたタッチパネルからなっている。なお、キーボードその他のハードウェア操作デバイスを含んでいても良い。

[0047] 表示部 240 は、この例では LCD（液晶表示素子）または有機 EL（エレクトロルミネッセンス）ディスプレイからなる表示画面を含む。表示部 240 は、制御部 210 による制御に従って、様々な画像を表示画面に表示させる。

[0048] スピーカ 260 は、制御部 210 による制御に従って、様々な音、例えば、音声、警報としてのアラーム音などを発生させる。

[0049] 近距離無線通信部 280 は、制御部 210 による制御に従って、喘鳴検出器 100 との間で無線通信、この例では近距離無線通信（BT 通信および BLE 通信）を行う。例えば、喘鳴検出器 100 へ操作指示を送信する。また、喘鳴検出器 100 から演算結果を表す情報などを受信する。

[0050] ネットワーク通信部 290 は、制御部 210 からの情報をネットワーク 9

00を介して他の装置へ送信するとともに、他の装置からネットワーク900を介して送信されてきた情報を受信して制御部210に受け渡すことができる。

[0051] 図5(A)は、喘鳴検出器100が被験者としての幼児90に装着される態様を例示している。この例では、幼児90は子供部屋98で寝ており、喘鳴検出器100の本体100Mがクリップ100C(図2参照)を介して幼児90の衣服(この例では、パジャマ)の襟に取り付けられている。第1のマイクロフォン111は、円形の皿に設けられた粘着シート119によって、幼児90の胸の肌に貼り付けられている。また、第2のマイクロフォン112は、幼児90の衣服(この例ではパジャマ)に貼り付けられている。なお、第2のマイクロフォン112は、幼児90の、胸および呼吸器から離れた部位(呼吸音の影響が少ない、例えば肩)の肌に貼り付けられてもよい。

[0052] (第1の動作例)

図17は、ユーザ(この例では、幼児90の母親)91が、この喘鳴検出システム1によって、幼児90の喘鳴の頻度の時間推移(この例では、図12中に示す帯グラフAT)をスマートフォン200の表示画面に表示させるための操作手順を示している。

[0053] (1) ユーザ91は、図5(A)に示したように喘鳴検出器100を幼児90に装着した後(図17のステップS1)、喘鳴検出器100の電源スイッチ191および通信スイッチ133を押して、喘鳴検出器100をスタンバイ状態にする(図17のステップS2)。

[0054] (2) 次に図5(B)に示すように、ユーザ91は、例えば子供部屋98とは別の居間99で、スマートフォン200にインストールされている「喘鳴チェッカー」プログラムを起動する(図17のステップS3)。そして、スマートフォン200の表示画面に表示された「喘鳴検査開始」スイッチ(後述の図15(A)中に符号23で示す。)を押して、喘鳴検出器100へ測定開始を指示する(図17のステップS4)。

[0055] (3) すると、喘鳴検出器100が幼児90の呼吸音を検知して、呼吸

音信号を処理し、喘鳴の頻度の時間推移を表す画像データを作成する（図 17 のステップ S5）。

[0056] i) 具体的には、まず、第 1 のマイクロフォン 111 が主に幼児 90 の気管支を通る呼吸音を検知し、また、第 2 のマイクロフォン 112 が主に幼児 90 の周りの環境音を検知する。音信号処理回路 115 は、第 1 のマイクロフォン 111 の出力と第 2 のマイクロフォン 112 の出力とを受けて、第 1 のマイクロフォン 111 の出力から第 2 のマイクロフォン 112 の出力を差し引き、得られた差分を表す時系列の呼吸音信号（これを符号 BS で表す。）を、制御部 110 へ出力する。これにより、呼吸音信号 BS から、幼児 90 の周りのノイズ成分を除去する。

[0057] 図 6 は、喘鳴検出器 100 の音信号処理回路 115 によって得られた呼吸音信号 BS を例示している。なお、図 6 中には、参考のために、呼吸流量センサ（喘鳴検出システム 1 には含まれない。）によって出力された呼吸流量信号 BF を併せて示している。呼吸流量信号 BF は、プラス側が呼気の流量を表し、マイナス側が吸気の流量を表している。

[0058] ii) 次に、制御部 110 が判定処理部として働いて、呼吸音信号 BS に基づいて、予め定められた処理単位期間（これを符号 t_u で表す。この例では、 $t_u = 0.05$ 秒間とする。）毎に、呼吸音に喘鳴が含まれているか否かを判定する。

[0059] ここで、図 7 は、制御部 110 が呼吸音信号 BS を処理単位期間 t_u 毎に周波数空間へ変換して得られた周波数スペクトル PS を例示している。また、図 8 は、或る処理単位期間 t_u に取得された呼吸音の周波数スペクトル PS を例示している（この例では、図 7 における時間 0.05 秒の処理単位期間に相当する。）。本発明者の解析では、喘鳴の「ひゅうひゅう」という笛のような音 Pw（図 7 参照）は、図 8 中に示すように、周波数スペクトル PS のピークの幅 D が比較的狭い（単一音に近い）という特徴をもつ。また、「ぜいぜい」という音は、幅 D が比較的狭いピークを幾つか含むという特徴をもつ（例えば、US 2011/0125044 A1 の FIG. 6 参照。

）。したがって、喘鳴を精度良く検出するためには、周波数スペクトル PS のピークの幅 D を何らかの形で判定に取り込むべきである。そこで、この喘鳴検出器 100 では、制御部 110 が周波数スペクトル PS におけるピークの高さ L と幅 D とに基づいて、そのピークが喘鳴を示すか否かを判定する。より詳しくは、制御部 110 が、ピークの高さ L と幅 D との比 (L/D 。ピークの急峻度を表す。) を求め、この比 (L/D) が予め定められた第 1 の閾値 (これを符号 α で表す。この例では、 $\alpha = 0.35$ とする。) よりも大きいかなにかに基づいて、喘鳴を示すか否かの判定を行う。

[0060] なお、ピークの高さ L と幅 D は、周波数対音圧グラフ上に背景ノイズが存在する場合には、背景ノイズが除去されたピークの実質的な高さ L と幅 D を指す。例えば、図 8 の例では、周波数対音圧グラフにおいて極小点 $m_0, m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, \dots$ を求め、これらの極小点同士を結ぶ線分を超える部分をピーク $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, \dots$ の実質的な高さ L 、幅 D であると考ええる。また、後述のピークの面積についても、これらの極小点同士を結ぶ線分を超える部分の実質的な面積 $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, \dots$ を指す。

[0061] 本発明者の解析では、乳児喘息の場合にしばしば観察される喘鳴の「ひゅうひゅう」という笛のような音 P_w (図 7 参照) は、周波数が概ね $900\text{ Hz} \sim 1200\text{ Hz}$ の範囲内の、ピークの幅 D が比較的狭い (単一音に近い) 音である。そこで、この喘鳴検出器 100 では、制御部 110 が周波数スペクトル PS における周波数が 200 Hz から 1500 Hz までの範囲内のピークのみについて、喘鳴を示すか否かの判定を行う。したがって、「ぜいぜい」という喘鳴に加えて、乳児喘息の場合にしばしば観察される「ひゅうひゅう」という喘鳴も含めて、被験者の呼吸音に喘鳴が含まれているか否かを検出できる。一方、 200 Hz から 1500 Hz までの範囲外の音は、喘鳴であるとは考えられないため、判定の対象外とする。

[0062] さらに、周波数スペクトル PS における複数のピーク $P_1, P_2, P_3, \dots$ のうち周波数対音圧グラフ (図 8) 上で最大の面積を与える支配的ピーク

P_d （この例では、ピーク P_5 ）は、最大のエネルギーをもつピークに相当する。したがって、この支配的ピーク P_d が、処理単位期間 t_u において喘鳴が含まれているか否かを決定づける。そこで、この喘鳴検出器 100 では、制御部 110 が周波数スペクトル PS における複数のピーク $P_1, P_2, P_3, \dots$ のうち周波数対音圧グラフ（図 8）上で最大の面積を与える支配的ピーク P_d のみについて、喘鳴を示すか否かの判定を行う。

[0063] 例えば、図 9 は、或る喘息患者の呼吸音の周波数スペクトルに含まれた支配的ピーク P_d の L/D 値の時間推移 CP_d と、支配的ピーク P_d の面積の時間推移 Sp_d とを併せて示している。時間軸（横軸）に沿って、実際に観察された喘鳴無しの期間と、喘鳴有りの期間とが特定されている。この図 9 から分かるように、実際に観察された喘鳴無しの期間では、支配的ピーク P_d の L/D 値が閾値 α 以下であるのに対して、実際に観察された喘鳴有りの期間では、支配的ピーク P_d の L/D 値が概ね閾値 α を超えていることが分かる。また、それに伴って、喘鳴有りの期間では、支配的ピーク P_d の面積も増加している。

[0064] また、図 10 は、実際に喘鳴無しと観察された正常呼吸音についての L/D 値のデータ度数と、実際に喘鳴有りと観察された呼吸音についての L/D 値のデータ度数とを、ヒストグラムとして示している。この図 10 から分かるように、正常呼吸音についての L/D 値のデータ群 H_0 は閾値 α 以下であるのに対して、実際に喘鳴有りと観察された呼吸音についての L/D 値のデータ群 H_1 は閾値 α を超えていることが分かる。

[0065] これらの図 9、図 10 の結果によれば、この喘鳴検出器 100 では、被験者の呼吸音に喘鳴が含まれているか否かを精度良く判定できる、と言える。

[0066] 処理単位期間 t_u 毎の判定結果、すなわち、被験者の呼吸音に喘鳴が含まれているか否かの結果は、逐次、メモリ 120 に 2 値データとして記憶され、蓄積される。例えば、呼吸音に喘鳴が含まれている場合は 1 が記憶され、呼吸音に喘鳴が含まれていない場合は 0 が記憶される。

[0067] iii) 次に、上述の判定結果に基づいて、制御部 110 が集計処理部と

して働いて、処理単位期間 t_u を複数含む集計単位期間（例えば、30秒間とする。）を設定し、逐次、各集計単位期間内における喘鳴が含まれていると判定された処理単位期間 t_u の長さを集計する。

[0068] 具体的には、図11に模式的に示すように、集計単位期間 T_1 , T_2 , T_3 , T_4 , ...毎に、各集計単位期間内における喘鳴が含まれていると判定された処理単位期間 t_u の長さを集計して喘鳴期間 T_{w1} , T_{w2} , T_{w3} , T_{w4} , ...として求める。さらに、喘鳴の頻度の時間推移を表す情報を、集計単位期間に対応する一定の長さの帯 AT_1 , AT_2 , AT_3 , AT_4 ...において喘鳴期間 T_{w1} , T_{w2} , T_{w3} , T_{w4} , ...が占める割合を示す帯グラフとして作成する。なお、それぞれの集計単位期間内で喘鳴が無かった期間（正常呼吸期間）の割合は、 O_1 , O_2 , O_3 , O_4 , ...で表されている。

[0069] 特に、この例では、集計単位期間 T_1 , T_2 , T_3 , T_4 , ...毎に、呼吸音の周波数スペクトル PS における支配的ピーク P_d の面積（図8の例では S_5 ）に基づいて喘鳴音のパワーを5段階 A , B , C , D , E に分類するとともに、喘鳴が含まれていると判定された処理単位期間 t_u の長さを分類された段階 A , B , C , D , E 毎に集計している。段階 A は支配的ピーク P_d の面積が0以上250未満、段階 B は支配的ピーク P_d の面積が250以上500未満、段階 C は支配的ピーク P_d の面積が500以上750未満、段階 D は支配的ピーク P_d の面積が750以上1000未満、段階 E は支配的ピーク P_d の面積が1000以上1250未満に設定されている。なお、図11の例では、理解の容易のために、5段階 A , B , C , D , E の割合を順次右へずらして表しているが、ストレートに表してもよい。

[0070] 喘鳴音のパワー（つまり、喘鳴の重症度）を分類する段階は、5段階 A , B , C , D , E に限られるものではない。例えば、医療専門家ではない一般的なユーザには、喘鳴音のパワーを3段階に分類するのが直感的に理解しやすいかも知れない。

[0071] iv) そこで、実際にスマートフォン200へ送信すべき画像データを

作成する場合、制御部 110 が表示処理部として働いて、集計単位期間における、正常呼吸期間と支配的ピーク P d の面積が 0 以上 250 未満の範囲の期間とを併せた割合を、グリーン（緑色）G とする。支配的ピーク P d の面積が 250 以上 750 未満の範囲の期間の割合をイエロー（黄色）Y とする。また、支配的ピーク P d の面積が 750 以上の範囲の期間の割合をレッド（赤色）R とする。これに応じて、集計単位期間に対応する一定の長さの帯は、グリーン G、イエロー Y、レッド R の 3 色に区分して表示される。そして、制御部 110 は、それぞれ集計単位期間に対応する複数の帯 AT1, AT2, … を平行に並べて、喘鳴の頻度の時間推移を表す帯グラフ（この例では、図 12 中に示す帯グラフ AT）を表す画像データを作成する。

[0072] なお、図 11 の例では、集計単位期間は 30 秒間であるとしたが、これに限られるものではない。集計単位期間は、例えば 1 分間、2 分間、5 分間、10 分間、30 分間、1 以上 24 未満の数の時間、1 日間、1 週間、または 1 ヶ月間というように、様々に設定され得る。以下の例では、集計単位期間は 1 時間であるものとする。

[0073] また、集計単位期間内で喘鳴音のパワーがレッド R に達した時間割合が予め定められた第 2 の閾値（これを符号 β で表す。この例では、 $\beta = 5$ [%] とする。）を超えたとき、制御部 110 が警報発生部として働いて、近距離無線通信部 180 を介してスマートフォン 200 へ、警報としてアラーム信号を送信する。

[0074] （４） 次に、ユーザ 91 は、スマートフォン 200 の表示画面に表示された「測定結果の読み込み」スイッチ（後述の図 15（A）中に符号 28 で示す。）を押して、喘鳴検出器 100 から、近距離無線通信部 280（特に、BLE 通信）を介して画像データを受信する（図 17 のステップ S6）。受信したデータは、記憶部としてのメモリ 220 に自動的に記憶され、記録される。

[0075] すると、スマートフォン 200 の表示画面 10 に、図 12 に例示するような喘鳴の頻度の時間推移を表す帯グラフ AT が表示される。

[0076] ここで、表示画面 10 には、最上段に電池残量 11、現在時刻 12 が表示されている。また、その下に、アプリケーションソフトウェアの名称として「AsthmaChecker」表示 13 と「喘鳴チェッカー」表示 14 が設けられている。「喘鳴チェッカー」表示 14 の左右には、「喘鳴チェッカー」プログラムを終了する指示を入力するための「キャンセル」スイッチ 17 と、表示画面の内容を直前に表示された画面に戻す指示を入力するための「戻る」スイッチ 18 とが設けられている。さらにその下に、喘鳴検出器 100 から受信した画像データを表示するための喘鳴検出結果表示欄 50 が設けられている。

[0077] 喘鳴検出結果表示欄 50 には、最終の測定日時を表示する測定時刻表示（この例では「2014年12月25日11時24分」）51 と、「喘鳴検出結果」という欄名表示 52 と、画像データ表示領域 56 とが設けられている。画像データ表示領域 56 には、横軸として、集計単位期間の順番（この例では「1, 2, 3, …」）55 が表示されている。また、横軸の直下には、「6番が該当時間の結果」として、測定時刻表示 51 に表された測定日時のデータが6番のデータ（帯AT4）に含まれていることが示されている。さらに、画像データ表示領域 56 には、縦軸として、「発生頻度（%）」が90%, 92%, 94%, …, 100%というように2%刻みで表示されている。そして、画像データ表示領域 56 の内部に、上述の喘鳴の頻度の時間推移を表す帯グラフATが表示されている。

[0078] 帯グラフATは、それぞれ集計単位期間（この例では、1時間）に対応する一定の長さの複数の帯AT1, AT2, …を時間推移の順に含んでいる。各帯は、グリーンG、イエローY、レッドRの3色で表されている。既述のように、グリーンGは、その帯に対応する集計単位期間内で、正常呼吸期間と支配的ピークPdの面積が0以上250未満の範囲の期間とを併せた割合、つまり、喘鳴が無い又は略無かった時間割合を示す。イエローYは、支配的ピークPdの面積が250以上750未満であった時間割合、つまり、喘鳴が比較的小さかった時間割合を示す。レッドRは、支配的ピークPdの面積が750以上であった時間割合、つまり、喘鳴が比較的大きかった時間

割合を示す。

[0079] ユーザ 91 は、この帯グラフ A T を見ることによって、喘鳴の頻度の集計単位期間毎の時間推移とともに、喘鳴の重症度の集計単位期間毎の時間推移を、視覚を通して直感的に知ることができる。

[0080] 例えば、図 12 の帯グラフ A T の例では、集計単位期間「3」番では、イエロー Y とレッド R とを併せた時間割合は約 2 % であるから、1 時間のうち 1.2 分間程度喘鳴があったことが分かる。また、イエロー Y の時間割合とレッド R の時間割合はそれぞれ約 1 % であるから、比較的小さい喘鳴と比較的大きい喘鳴とが略同じ時間割合だけあったことが分かる。また、集計単位期間「4」番では、イエロー Y とレッド R とを併せた時間割合は約 4 % であるから、1 時間のうち 2.4 分間程度喘鳴があったことが分かる。また、イエロー Y の時間割合は約 3 % であり、レッド R の時間割合は約 1 % であるから、比較的小さい喘鳴の時間割合が、比較的大きい喘鳴の時間割合の約 3 倍程度に増えたことが分かる。また、集計単位期間「5」番、「6」番では、概ね集計単位期間「3」番の状態に戻ったことが分かる。

[0081] このように、ユーザ 91 は、帯グラフ A T を見ることによって、被験者としての幼児 90 の呼吸音に含まれた喘鳴の頻度および喘鳴の重症度の集計単位期間毎の時間推移を、視覚を通して直感的に知ることができる。また、この帯グラフ A T を表す情報はメモリ 220 に自動的に記憶されている。したがって、ユーザ 91 は、幼児 90 の次回の受診時にその情報をメモリ 220 から読み出して帯グラフ A T を表示画面 10 に表示させることで、幼児 90 の呼吸音に含まれた喘鳴の頻度および喘鳴の重症度の集計単位期間毎の時間推移を、医師に見せることができる。この結果、医師は、幼児 90 が喘息であるか否かや喘息の重症度を診断し易くなり、治療方針を容易に立てることができる。

[0082] また、ユーザ 91 は帯グラフ A T の喘鳴の頻度および喘鳴の重症度の集計単位時間毎の時間推移状況を視覚することで、喘息が酷くなりつつあるのか、快方に向かうのかがわか。例えば、喘息が酷くなりつつある場合は、投薬

等の事前処置が可能となり、喘息の増悪予防にもつながる。

[0083] スマートフォン200の表示画面10において、喘鳴検出結果表示欄50の下には、喘鳴検出結果表示欄50に表示される対象期間を繰り上げる方向キー61と、繰り下げる方向キー62とが設けられている。ユーザは、方向キー61, 62を押すことによって、喘鳴検出結果として表示画面10に表示される対象期間を選択することができる。また、ユーザが「メモの編集」スイッチ63を押せば、メモ画面（図示せず）を開いて、喘鳴検出結果を見て感じたことを手入力して記録することができる。なお、「喘鳴音再生」スイッチ64については、後述する。

[0084] また、集計単位期間内で喘鳴音のパワーがレッドRに達した時間割合が予め定められた閾値 β （＝5 [%]）を超えたとき、スマートフォン200は、近距離無線通信部280を介して、喘鳴検出器100からのアラーム信号を受信する。このアラーム信号を受信すると、スマートフォン200の制御部210が、スピーカ260によって警報としてのアラーム音を発生させる。このアラーム音によって、ユーザ91は、たとえ子供部屋（幼児90が寝ている）98とは別の居間99に居たとしても、被験者としての幼児90の症状が悪化したことを知ることができる。したがって、幼児90に対して投薬を行うなどの対処をとることができる。この警報は、被験者が意思表示が困難な幼児90や重篤者等である場合に、特に有益である。

[0085] なお、警報は、スピーカ260によるアラーム音の発生に限られるものではなく、表示画面10上のアラーム表示（図示せず）や、着信を知らせるバイブレータ（図示せず）による振動であってもよい。

[0086] （第2の動作例）

図18は、ユーザ91が、この喘鳴検出システム1によって、幼児90の喘鳴の頻度の時間推移を表す帯グラフATと、投薬に関する情報とを併せて、スマートフォン200の表示画面に表示させるための操作手順を示している。

[0087] （1） 図18のステップS11からS15までは、図17のステップS

1 から S 5 までと同様に進める。

[0088] ここで、図 1 5 (A) は、図 1 8 のステップ S 1 3 でユーザ 9 1 がスマートフォン 2 0 0 にインストールされている「喘鳴チェッカー」プログラムを起動したときに、表示画面 1 0 に表示される初期メニュー画面を例示している。

[0089] この図 1 5 (A) の初期メニュー画面では、「AsthmaChecker」表示 1 3 と「喘鳴チェッカー」表示 1 4 との間に、近距離無線通信部 2 8 0 による喘鳴検出器 1 0 0 との間の B T 通信、B L E 通信の「未接続」または「接続」の状態 1 6 が表示される。また、「喘鳴チェッカー」表示 1 4 の下方には、「予約」スイッチ 2 1 と、「設定」スイッチ 2 2 と、「喘鳴検査開始」スイッチ 2 3 と、「喘鳴検査停止」スイッチ 2 4 と、「録音開始」スイッチ 2 5 と、「録音停止」スイッチ 2 6 と、「設定画面」スイッチ 2 7 と、「測定結果の読み込み」スイッチ 2 8 と、「投薬時」スイッチ 3 0 と、フェーズ指示入力部としてのフェーズ選択スイッチ 4 0 とが設けられている。

[0090] 「予約」スイッチ 2 1 は、ユーザ 9 1 が、喘鳴検出器 1 0 0 によって測定を行うべき期間を、例えば 2 0 1 4 年 1 2 月 2 6 日 2 1 時 0 分から 2 0 1 4 年 1 2 月 2 7 日 7 時 0 分までというように、予約するために用いられる。「設定」スイッチ 2 2 は、喘鳴検出器 1 0 0 が既述のアラーム信号を発生するための条件（この例では、閾値 β ）を設定したり、スマートフォン 2 0 0 がアラーム信号を受信したときアラーム音を発生させるか否か、アラーム表示を行うか否か、自動録音を行うか否かなどを設定するために用いられる。「喘鳴検査開始」スイッチ 2 3 は、喘鳴検出器 1 0 0 へ測定開始を指示するために用いられる。「喘鳴検査停止」スイッチ 2 4 は、喘鳴検出器 1 0 0 へ測定停止を指示するために用いられる。「録音開始」スイッチ 2 5 は、喘鳴検出器 1 0 0 へ呼吸音信号 B S の送信を指示するために用いられる。「録音停止」スイッチ 2 6 は、喘鳴検出器 1 0 0 へ呼吸音信号 B S の送信停止を指示するために用いられる。「設定画面」スイッチ 2 7 は、スマートフォン 2 0 0 の近距離無線通信部 2 8 0 と喘鳴検出器 1 0 0 の近距離無線通信部 1 8 0

との間のSSID（サービスセット識別子）と暗号化キー（パスワード）を設定するために用いられる。「投薬時」スイッチ30は、投薬時期（年月日時分）を入力するために用いられる。なお、フェーズ選択スイッチ40については、後述する。

[0091] (2) この例では、スマートフォン200の表示画面10に図15（A）の初期メニュー画面が表示された状態で、ユーザ91は、「投薬時」スイッチ30を押す（図18のステップS16）。すると、この「投薬時」スイッチ30を押した現時点がメモリ220に投薬時期（年月日時分）として記憶される。なお、ユーザ91が「投薬時」スイッチ30を押すと、投薬時期を入力するための画面が開き、その画面においてユーザ91が投薬時期（年月日時分）を入力し、再びユーザ91が「投薬時」スイッチ30を押すと、その入力された投薬時期が記憶されるようにしてもよい。投薬時期が記憶されると、表示画面10に、図15（B）に例示するような、投薬された薬剤の種類を入力するための投薬情報入力画面が表示される。この例では、「薬剤A」スイッチ31、「薬剤B」スイッチ32、「薬剤C」スイッチ33の3種類のスイッチが表示される。なお、実際には、予め、図示しない薬剤名登録画面によって、「薬剤A」、「薬剤B」、「薬剤C」として、医師によって処方箋で指定された具体的な薬剤名をそれぞれ登録しておく。図15（B）中の「薬剤A」、「薬剤B」、「薬剤C」の表示箇所には、登録された具体的な薬剤名が表示される。これらのスイッチ30、31、32、33は、投薬情報入力部を構成している。

[0092] (3) この図15（B）の投薬情報入力画面が表示された状態で、ユーザ91は、いずれかの薬剤スイッチを押して、薬剤の種類を入力する（図18のステップS17）。例えば、ユーザ91が「薬剤A」スイッチ31を押すと、スマートフォン200の表示画面10に、図16（A）に例示するように、「2014年12月25日11時22分 投薬A」という投薬情報34を含む確認のための画面が表示される（図18のステップS18）。

[0093] (4) さらに、ユーザ91が「戻る」スイッチ18を2回押して、図1

5 (A) の初期メニュー画面に戻って「投薬時」スイッチ 30 を押し、図 15 (B) の投薬情報入力画面で「薬剤 B」スイッチ 32 を押すと、図 16 (A) に例示するように、先ほどの投薬情報 34 に加えて、「2014 年 12 月 25 日 11 時 24 分 薬剤 B」という投薬情報 35 を含む確認のための画面が表示される。すなわち、投薬毎に、図 18 のステップ S16 ~ S18 が繰り返される。

[0094] (5) この後、ユーザ 91 は、「戻る」スイッチ 18 を 2 回押して、図 15 (A) の初期メニュー画面に戻り、「測定結果の読み込み」スイッチ 28 を押して、喘鳴検出器 100 から、近距離無線通信部 280 (特に、BLE 通信) を介して画像データを受信する (図 18 のステップ S19)。受信したデータは、記憶部としてのメモリ 220 に自動的に記憶され、記録される。

[0095] すると、スマートフォン 200 の制御部 210 が表示処理部として働いて、表示画面 10 に、図 16 (B) に例示するように、喘鳴の頻度の時間推移を表す帯グラフ AT に併せて、集計単位期間ごとの投薬情報が表示される (図 18 のステップ S20)。図 16 (B) の例では、集計単位期間 5 番の帯グラフ AT1 の上方に「投薬 A」、集計単位期間 6 番の帯グラフ AT1 の上方に「投薬 B」と表示されている。ユーザ 91 は、集計単位期間内における喘鳴の頻度とともに、投薬に関する情報、この例では、集計単位期間 5 番で幼児 90 に対して薬剤 A が与えられ、また、集計単位期間 6 番で幼児 90 に対して薬剤 B が与えられたことを、視覚を通して直感的に知ることができる。これにより、ユーザ 91 や、この図 16 (B) の画面を見せてもらった医師は、幼児 90 に対する投薬による効果 (喘鳴の頻度の減少) があったか否かを容易に判断することができる。

[0096] 例えば、図 16 (B) の例では、集計単位期間 5 番 (レッド R の時間割合が約 3%) で「投薬 A」があったにもかかわらず、集計単位期間 6 番では、レッド R の時間割合が約 5% に上昇しており、幼児 90 の症状が悪化している。このため、「投薬 A」の効果が無かった可能性が高い。「投薬 B」の効

果は、集計単位期間 7 番以降の結果を見た後に判断すべきかも知れない。

[0097] (第 3 の動作例)

図 1 9 は、ユーザ 9 1 が、この喘鳴検出システム 1 によって、幼児 9 0 の呼吸音をスマートフォン 2 0 0 のメモリ 2 2 0 に録音させるための操作手順を示している。

[0098] (1) 図 1 9 のステップ S 2 1 から S 2 3 までは、図 1 7 のステップ S 1 から S 3 までと同様に進める。

[0099] ここで、図 1 9 のステップ S 2 3 では、スマートフォン 2 0 0 の表示画面 1 0 に、図 1 5 (A) に示した初期メニュー画面が表示される。この初期メニュー画面には、フェーズ指示入力部としてのフェーズ選択スイッチ 4 0 が含まれている。フェーズ選択スイッチ 4 0 は、呼吸音信号 B S を録音する際に、呼気フェーズのみを選択するための「呼気」スイッチ 4 1 と、呼気フェーズと吸気フェーズとの両方を選択するための「呼気／吸気」スイッチ 4 2 と、吸気フェーズのみを選択するための「吸気」スイッチ 4 3 とを含んでいる。

[0100] (2) スマートフォン 2 0 0 の表示画面 1 0 にフェーズ選択スイッチ 4 0 が表示された状態で、ユーザ 9 1 は、例えば医師の求めに応じて、呼気フェーズのみ、呼気フェーズと吸気フェーズとの両方、吸気フェーズのみのうちいずれを録音すべきかに応じて、「呼気」スイッチ 4 1、「呼気／吸気」スイッチ 4 2、「吸気」スイッチ 4 3 のうちいずれかのスイッチを押す(図 1 9 のステップ S 2 4)。これにより、録音すべきフェーズを選択する。

[0101] (3) 次に、ユーザ 9 1 は、手動録音をするか、または自動録音をするかを定める(図 1 9 のステップ S 2 5)。例えば、幼児 9 0 の現在の喘鳴症状が酷く、その喘鳴を直ちに録音したい場合は、手動録音を選択するのが望ましい。一方、幼児 9 0 の現在の喘鳴症状は良好であり、喘鳴症状が酷くなったときに録音したい場合は、自動録音を選択するのが望ましい。

[0102] (4) 手動録音をする場合(図 1 9 のステップ S 2 5 で Y E S)、ユーザ 9 1 は、図 1 5 (A) に示した初期メニュー画面で「録音開始」スイッチ 2 5 を押す(図 1 9 のステップ S 2 6)。すると、スマートフォン 2 0 0 の制

制御部 210 は、近距離無線通信部 280 を介して、喘鳴検出器 100 へ呼吸音信号 BS の送信を指示する。一方、自動録音をする場合、ユーザ 91 は、図 15 (A) 中の「設定」スイッチ 22 によって、予め「自動録音」を行うことを設定しておく。「自動録音」モードでは、スマートフォン 200 の制御部 210 は、喘鳴検出器 100 からの既述のアラーム信号（集計単位期間内でレッド R に達した時間割合が閾値 β を超えたことを示す。）を待ち（図 19 のステップ S29）、そのアラーム信号を受信した時点で（図 19 のステップ S29 で YES）、近距離無線通信部 280 を介して、喘鳴検出器 100 へ呼吸音信号 BS の送信を指示する。手動録音と自動録音のいずれの場合も、喘鳴検出器 100 は、スマートフォン 200 から呼吸音信号 BS の送信指示を受けると、近距離無線通信部 180（特に、BT 通信）を介して、呼吸音信号 BS をスマートフォン 200 へ送信する。

[0103] (5) その呼吸音信号 BS を受信すると、スマートフォン 200 では、制御部 210 が録音部として働いて、呼吸音信号 BS のうちフェーズ選択スイッチ 40 によって選択されたフェーズをメモリ 220 に保存して録音する（図 19 のステップ S27）。

[0104] 詳しくは、スマートフォン 200 の制御部 210 がフェーズ識別部として働いて、呼吸音信号 BS のフェーズを、次のようにして検出する。

[0105] まず、図 6 中に示すように、呼吸音信号 BS は、呼吸流量信号 BF がマイナス（吸気）からプラス（呼気）へ遷移するゼロクロス点に同期して極小となっている。したがって、制御部 210 は、呼吸音信号 BS の極小点 BS0, BS1, ... を検出することによって、被験者（この例では、幼児 90）の呼吸周期 t_c を求めることができる。

[0106] 次に、制御部 210 は、図 13 に示すように、呼吸音信号 BS に対して包絡線 BE を作成する（この例では、呼吸音信号 BS が 3000 以下であれば、簡単のため、0 に置換している。）。この呼吸音信号 BS に対する包絡線 BE と、図 6 中に示した呼吸流量信号 BF とを併せると、図 14 に示すように、包絡線 BE のピーク BEp は、呼吸流量信号 BF がプラス（呼気）から

マイナス（吸気）へ遷移するゼロクロス点に同期している。したがって、制御部210は、包絡線BEのピークBE_pを検出することによって、呼吸周期 t_c 内の呼気フェーズ t_e と吸気フェーズ t_i とを区分して識別することができる。なお、包絡線BEのうち本来のピークBE_pの周期から外れたピークBE_nについては、本来のピークBE_pの平均的な周期に基づいて、ノイズであるとして無視する。

[0107] このようにして、呼吸周期 t_c 内の呼気フェーズ t_e と吸気フェーズ t_i とを区分して識別した上で、制御部210は、呼吸音信号BSのうちフェーズ選択スイッチ40によって選択されたフェーズをメモリ220に保存して録音する。なお、図16（B）中の「呼気」表示44は、呼気フェーズが録音されたことを表している。

[0108] なお、手動録音の場合、ユーザ91は、図15（A）に示した初期メニュー画面で「録音停止」スイッチ26を押すと、スマートフォン200による録音が停止する。喘鳴検出器100は、その「録音停止」を表す信号を近距離無線通信部180を介して受けて、呼吸音信号BSの送信を停止する。自動録音モードでは、喘鳴検出器100が呼吸音信号BSを送信する期間、および、スマートフォン200が録音する期間は、デフォルトでは、録音開始時点から30秒間として設定されている（それをユーザ91が可変して設定することは可能である。）。

[0109] 自動録音モードでは、被験者としての幼児90の喘鳴が比較的大きいとき（つまり、喘鳴が酷いとき）に、幼児90の呼吸音を自動的に録音できる。これにより、ユーザ91は、例えば幼児90の次回の受診時にその録音内容を再生することで、喘鳴が酷いときの幼児90の呼吸音を医師に聴いてもらうことができる。この結果、医師は、幼児90が喘息であるか否かや喘息の重症度を診断し易くなり、治療方針を容易に立てることができる。ただし、スマートフォン200が喘鳴検出器100からのアラーム信号を受信しなければ（図19のステップS29でNO）、録音はされない。

[0110] （6） この後、ユーザ91は、例えば図12に示した画面で「喘鳴音再

生」スイッチ64を押して、メモリ220に保存された呼吸音信号BSを、例えばスピーカ260によって、再生することができる（図19のステップS28）。

[0111] この動作例によれば、呼吸音信号BSのうちフェーズ選択スイッチ40によって選択されたフェーズを録音できる。したがって、例えば前回の受診時に医師が求めたフェーズを選択しておけば、ユーザ91は、幼児90の喘鳴の録音内容を次の受診時に医師に聴いてもらうときに、呼吸周期tcのうち医師が求めたフェーズの録音内容を聴いてもらうことができる。

[0112] また、スマートフォン200の表示画面10に表示された喘鳴検出結果（図12、図16（B）中の帯グラフAT）や呼吸音信号BSの録音内容を、ネットワーク通信部290を介して、医師のコンピュータ（病院内の端末）へ送信してもよい。これにより、ユーザ91は、病院から離れた遠隔地で医師の診断を受けることができる。

[0113] 上述の実施形態では、本発明の喘鳴検出装置を、喘鳴検出器100とスマートフォン200とを含む喘鳴検出システムとして構成したが、これに限られるものではない。例えば、スマートフォン200に代えて、市販のコンピュータ（パーソナルコンピュータなど）を用いて構成することができる。その場合、市販のコンピュータに上述の「喘鳴チェッカー」プログラムをインストールしておく。

[0114] また、本発明の喘鳴検出装置を、例えばスマートフォン200のみで構成しても良い。その場合、スマートフォン200に、第1のマイクロフォン111および第2のマイクロフォン112を接続し、音信号処理回路115を搭載しておく（音信号処理回路115の機能をソフトウェアで構成して、制御部210によって実行してもよい。）。その場合、本発明の喘鳴検出装置を、小型かつコンパクトに構成することができる。この構成は、被験者がスマートフォン200のユーザである場合に有益である。

[0115] 上述の実施形態では、喘鳴の頻度の時間推移を帯グラフATで表示したが、これに限られるものではない。喘鳴の頻度の時間推移を他の形式のグラフ

で表示してもよい。例えば、棒グラフで、イエローYとレッドRとを併せた時間割合(%)のみの時間推移を表示してもよい。

[0116] 上述の実施形態は例示に過ぎず、この発明の範囲から逸脱することなく種々の変形が可能である。上述した複数の実施の形態は、それぞれ単独で成立し得るものであるが、実施の形態同士の組み合わせも可能である。また、異なる実施の形態の中の種々の特徴も、それぞれ単独で成立し得るものであるが、異なる実施の形態の中の特徴同士の組み合わせも可能である。

符号の説明

- [0117] 1 喘鳴検出システム
- 1 0 表示画面
- 5 0 喘鳴検出結果表示欄
- 1 0 0 喘鳴検出器
- 1 1 1 第1のマイクロフォン
- 1 1 2 第2のマイクロフォン
- 2 0 0 スマートフォン
- A T 帯グラフ
- A T 1, A T 2, A T 3, A T 4 帯
- T 1, T 2, T 3, T 4 集計単位期間
- T w 1, T w 2, T w 3, T w 4 喘鳴期間

請求の範囲

- [請求項1] 被験者の呼吸音を検知して、その呼吸音を表す時系列の呼吸音信号を取得する呼吸音検知部と、
- 上記呼吸音信号に基づいて、予め定められた処理単位期間毎に、上記呼吸音に喘鳴が含まれているか否かを判定する判定処理部と、
- 上記判定処理部の判定結果に基づいて、上記喘鳴の頻度の時間推移を表す情報を表示画面に表示する表示処理部と
- を備えたことを特徴とする喘鳴関連情報表示装置。
- [請求項2] 請求項1に記載の喘鳴関連情報表示装置において、
- 上記表示処理部は、上記喘鳴の頻度の時間推移を表す情報として、上記処理単位期間を複数含む集計単位期間毎の、上記判定処理部によって喘鳴が含まれていると判定された処理単位期間の頻度を表示することを特徴とする喘鳴関連情報表示装置。
- [請求項3] 請求項2に記載の喘鳴関連情報表示装置において、さらに、
- 上記集計単位期間内における上記喘鳴が含まれていると判定された処理単位期間の長さを集計して喘鳴期間として求める集計処理部を備え、
- 上記表示処理部は、上記喘鳴の頻度の時間推移を表す情報を、上記集計単位期間に対応する一定の長さの帯において上記喘鳴期間が占める割合を示す帯グラフとして表示することを特徴とする喘鳴関連情報表示装置。
- [請求項4] 請求項3に記載の喘鳴関連情報表示装置において、
- 上記表示処理部は、上記表示画面に、それぞれ上記集計単位期間に対応する複数の帯を平行に並べて表示することを特徴とする喘鳴関連情報表示装置。
- [請求項5] 請求項3または4に記載の喘鳴関連情報表示装置において、
- 上記集計処理部は、上記処理単位期間毎に、上記呼吸音信号を周波数空間へ変換して上記呼吸音の周波数スペクトルを取得し、上記周波

数スペクトルにおける複数のピークのうち周波数対音圧グラフ上で最大の面積を与える支配的ピークの面積に基づいて喘鳴音のパワーを複数の段階に分類するとともに、上記喘鳴が含まれていると判定された処理単位期間の長さを上記分類された段階毎に集計し、

上記表示処理部は、上記集計処理部による集計に基づいて、上記集計単位期間に対応する上記帯において上記喘鳴期間を上記各段階毎に区分して表示することを特徴とする喘鳴関連情報表示装置。

[請求項6] 請求項3から5までのいずれか一つに記載の喘鳴関連情報表示装置において、さらに、

上記被験者に対する投薬に関する情報を入力する投薬情報入力部を備え、

上記表示処理部は、上記帯グラフに併せて、上記集計単位期間ごとの上記投薬に関する情報を上記表示画面に表示することを特徴とする喘鳴関連情報表示装置。


[請求項7] 請求項1から6までのいずれか一つに記載の喘鳴関連情報表示装置において、さらに、

上記呼吸音検知部が取得した上記呼吸音信号に基づいて、上記被験者の呼吸周期を呼気フェーズと吸気フェーズとに区分して識別するフェーズ識別部と、


上記呼吸音信号のうち上記呼気フェーズと上記吸気フェーズとのいずれか一方または両方のフェーズを選択する指示を入力するフェーズ指示入力部と、

上記呼吸音信号のうち上記フェーズ指示入力部によって指示されたフェーズを録音する録音部と
を備えたことを特徴とする喘鳴関連情報表示装置。


[図1]

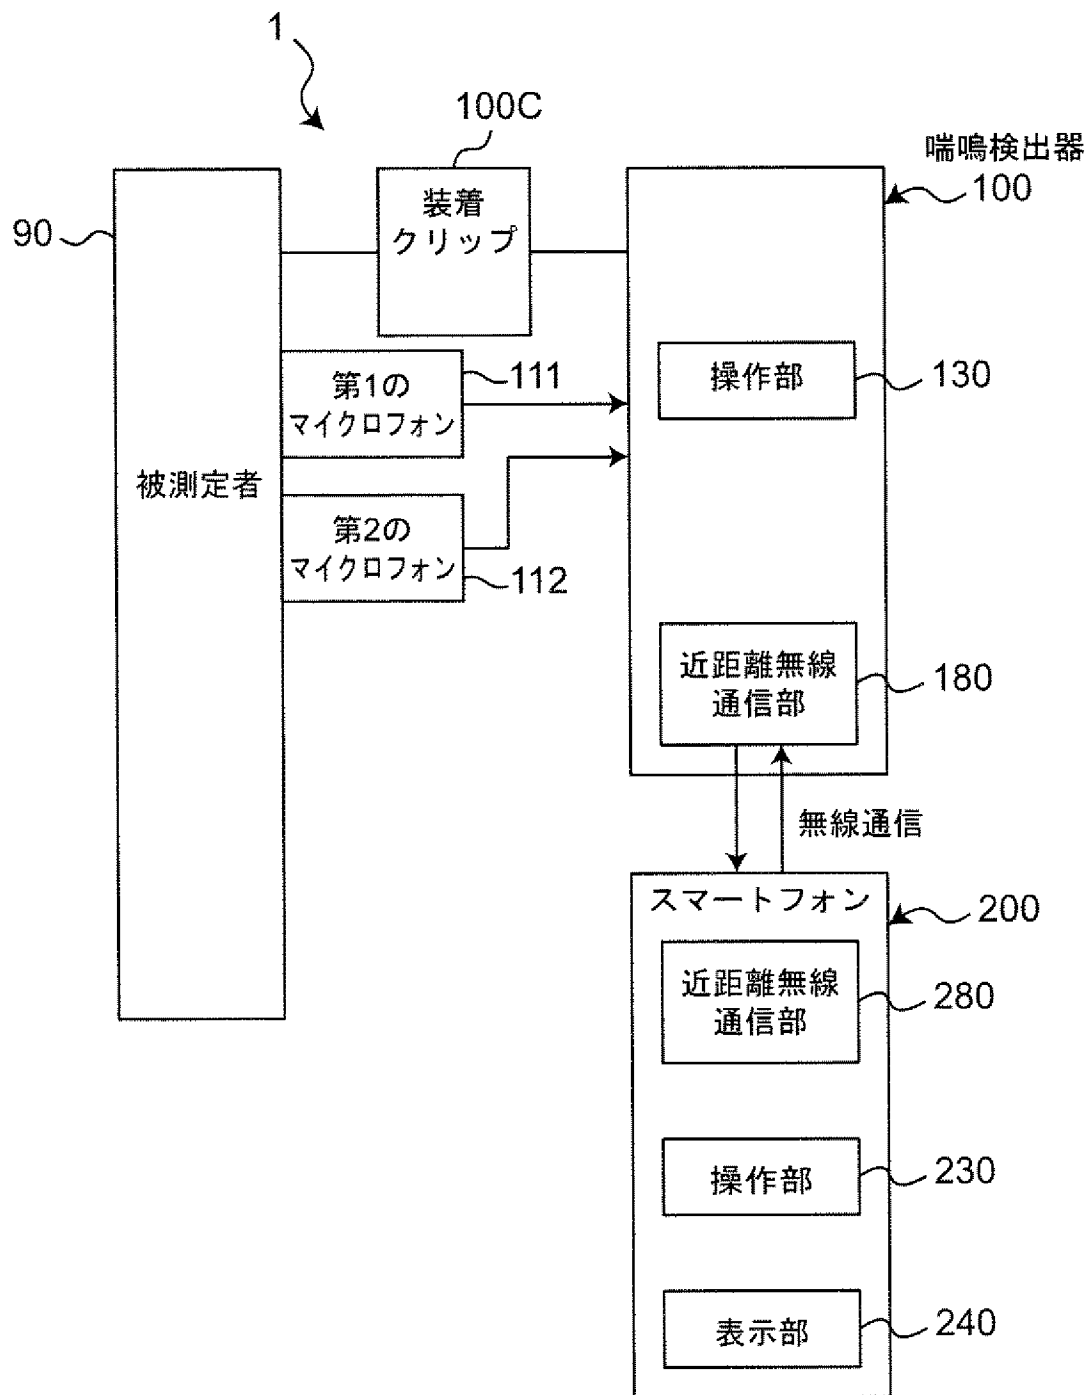


[図2]

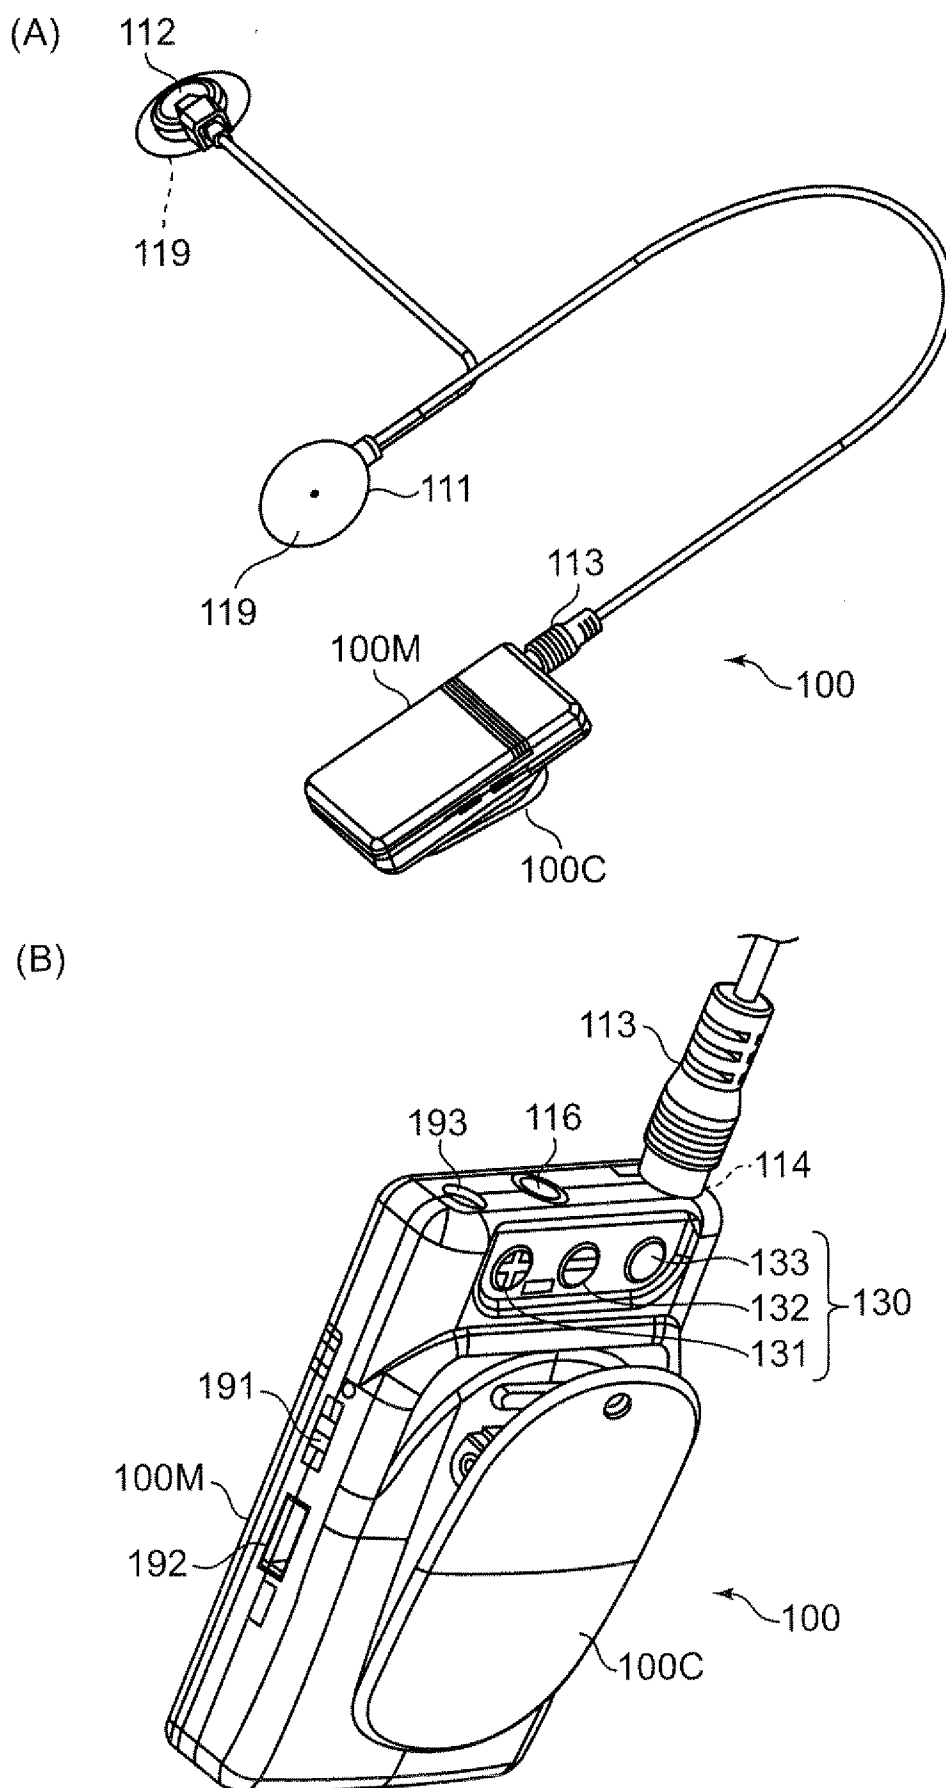

[図3]

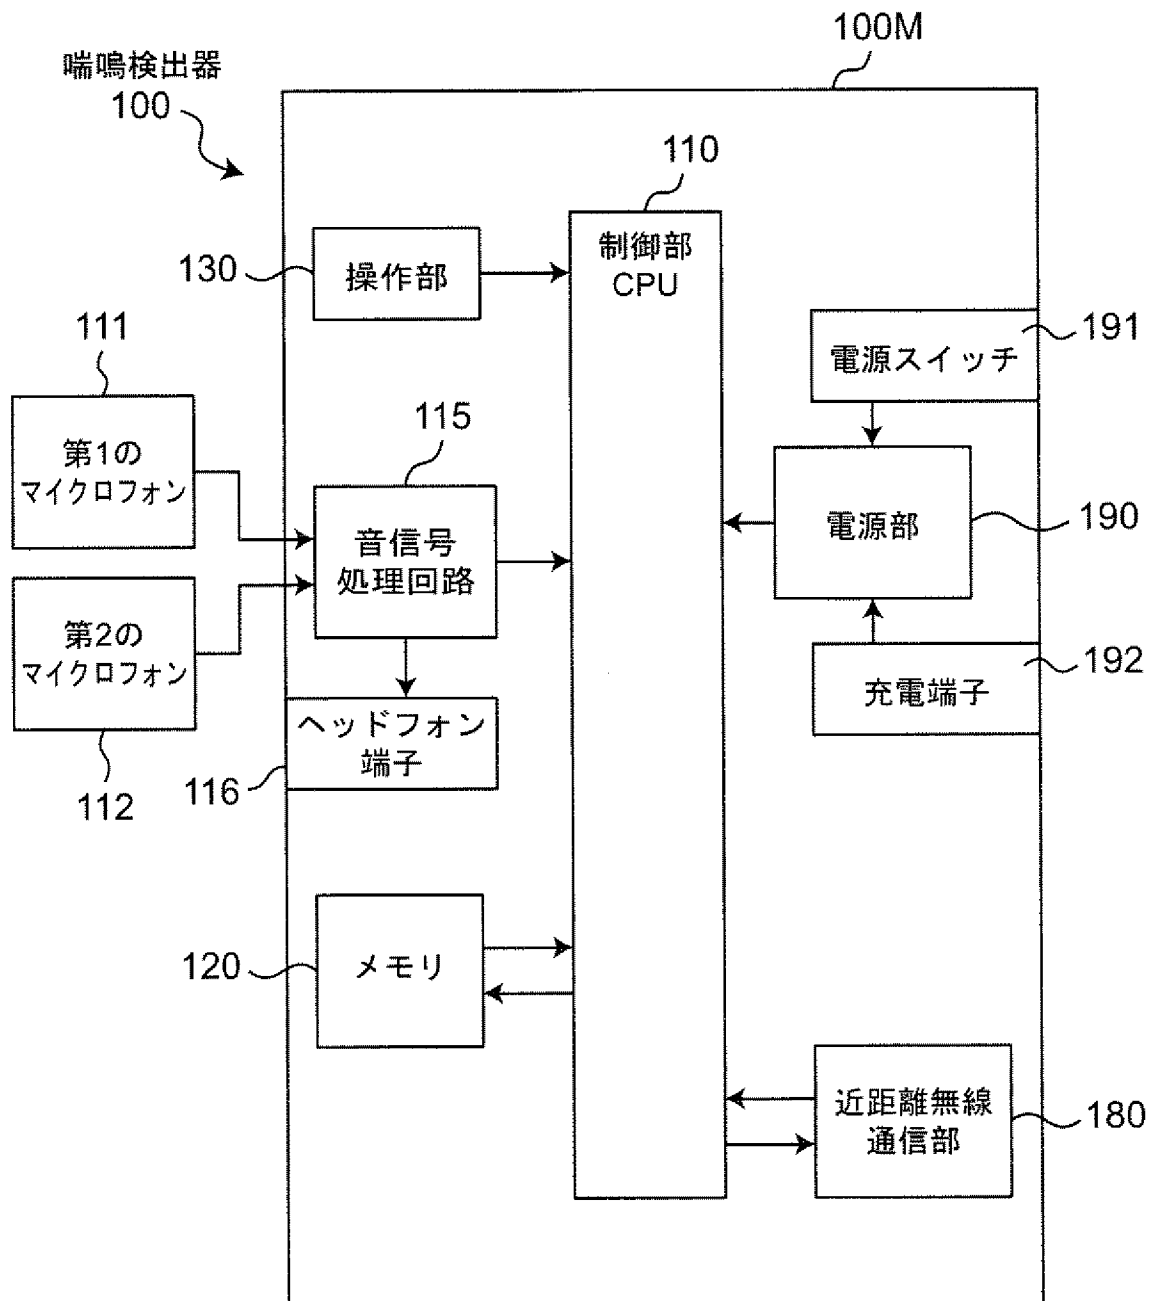


[図4]

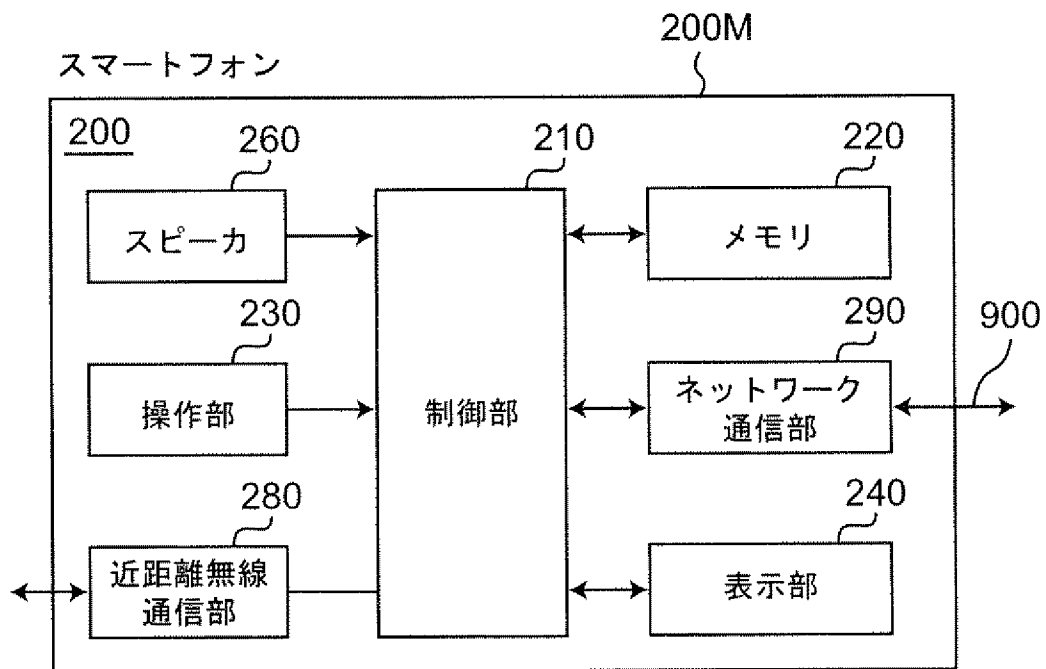


[図5]


(A)

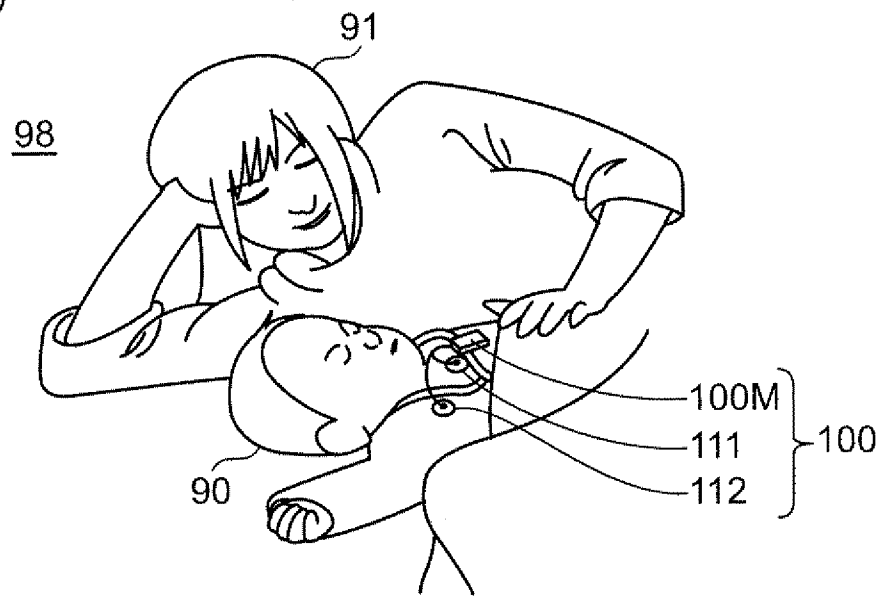


(B)

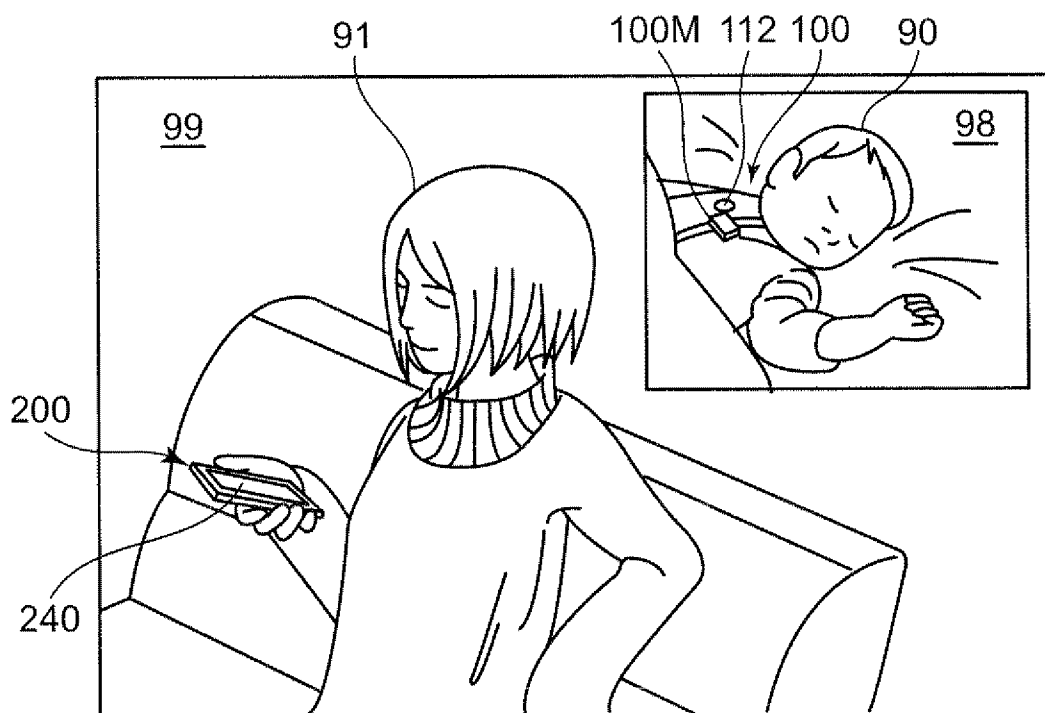


[図6]

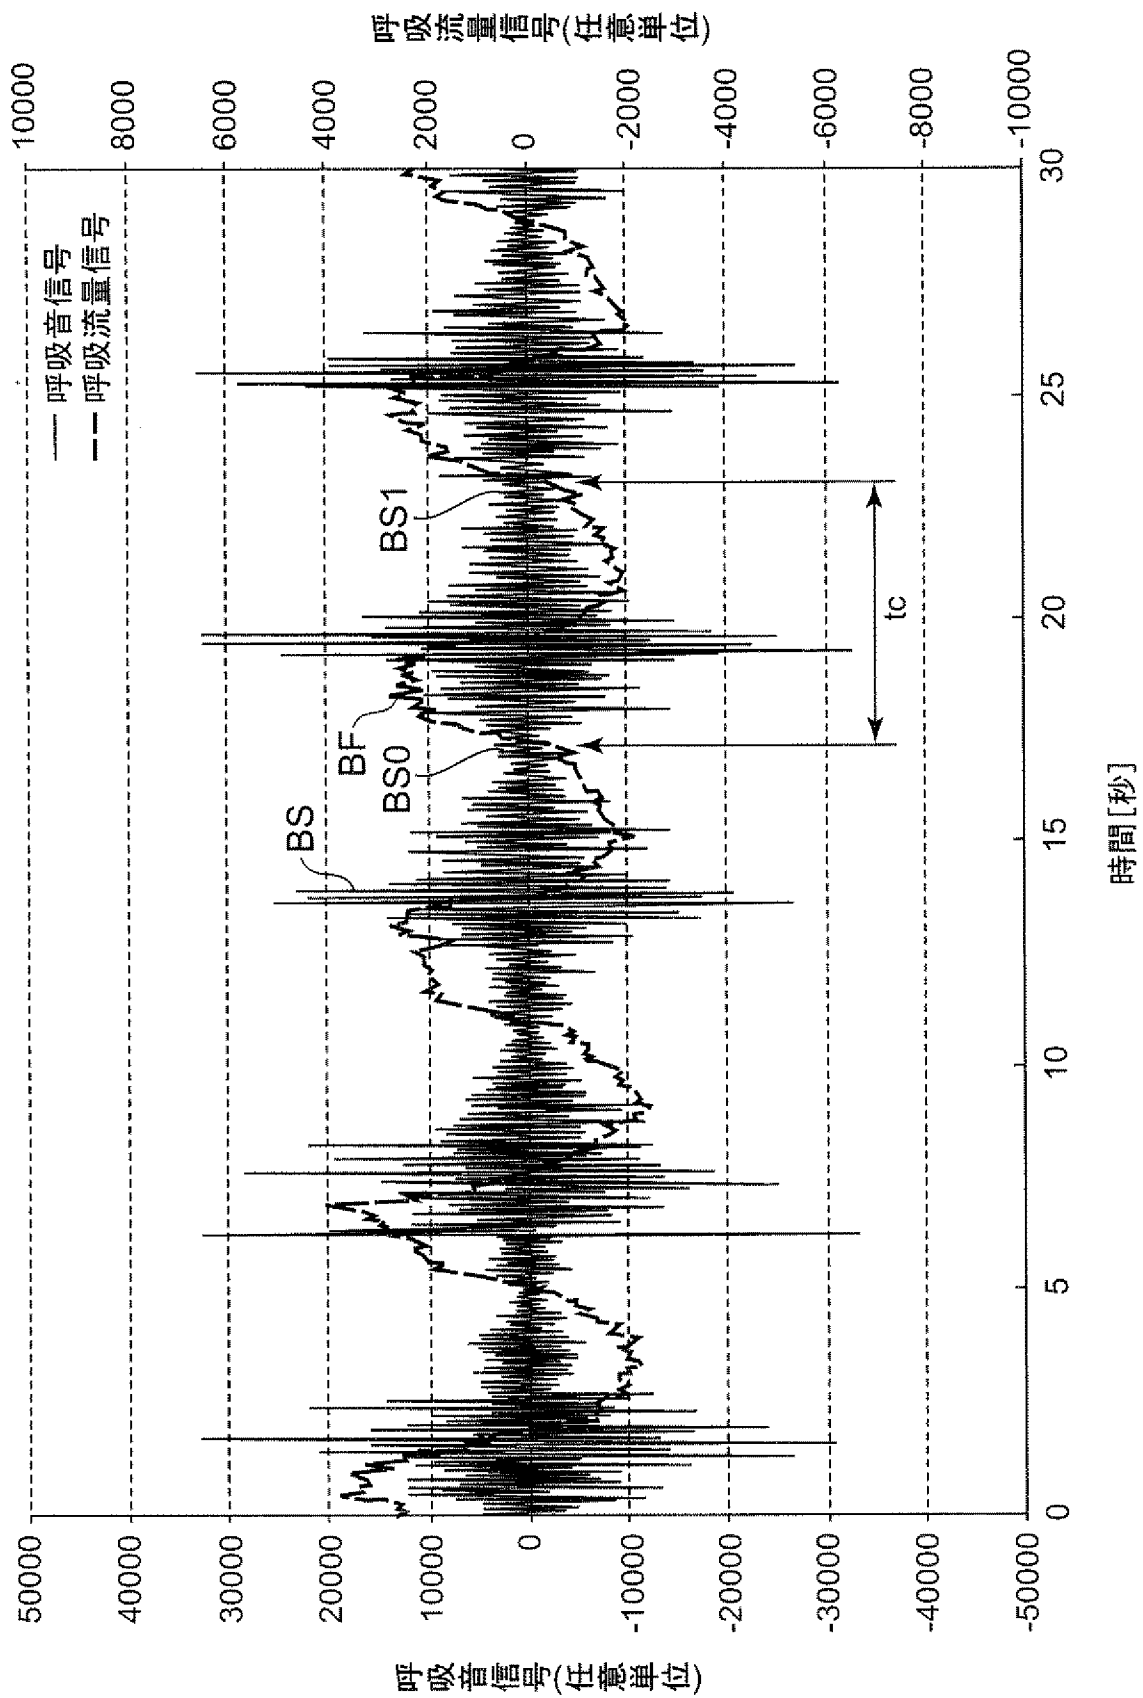


[図7]

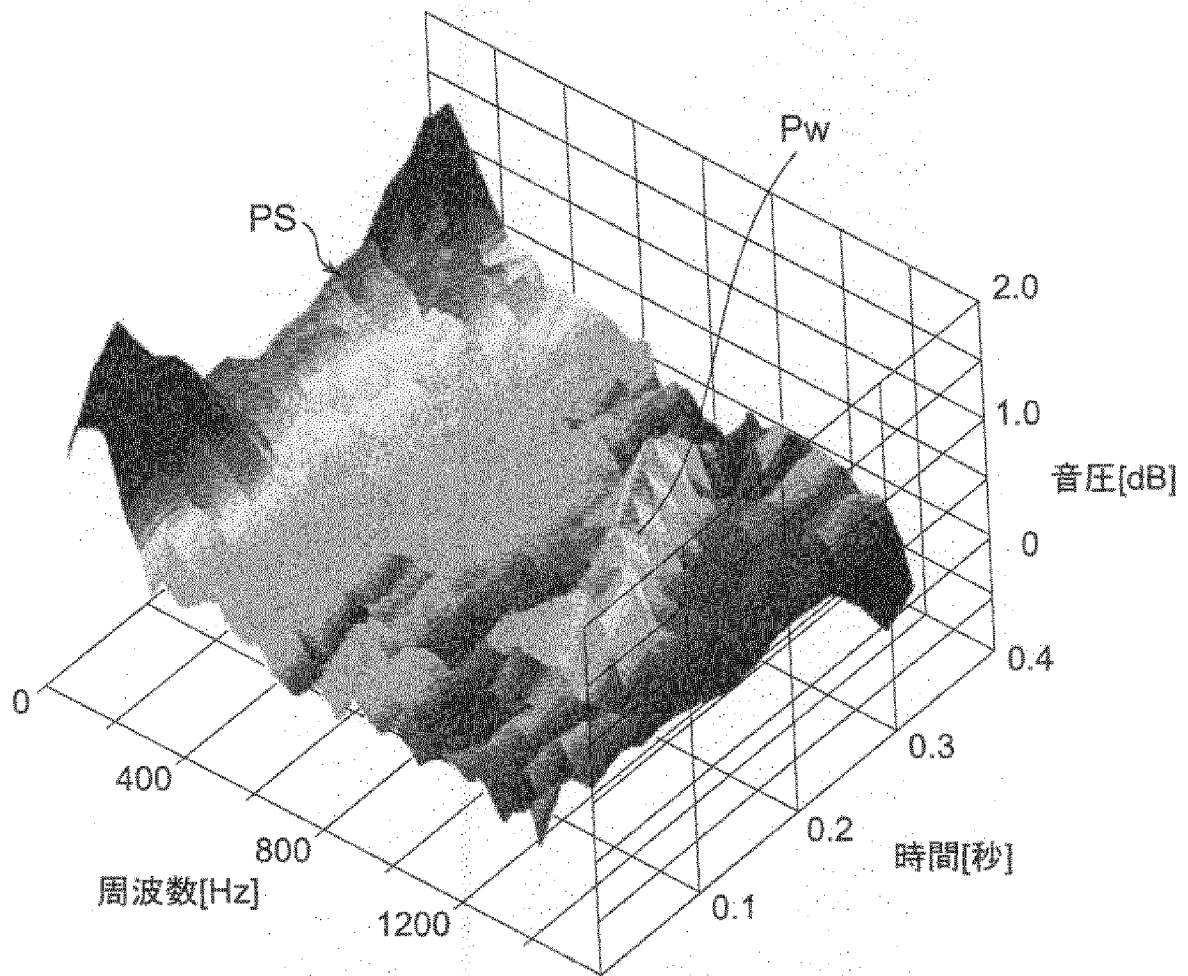


[図8]

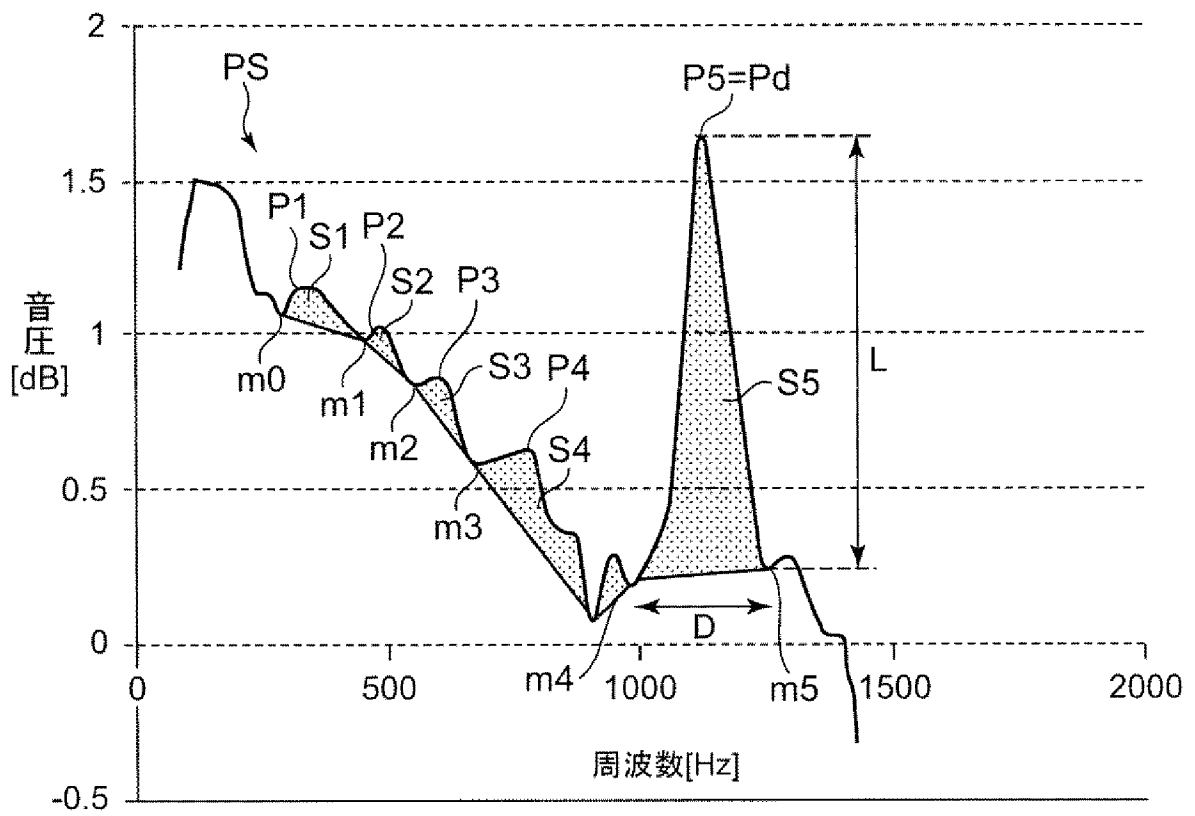


[図9]

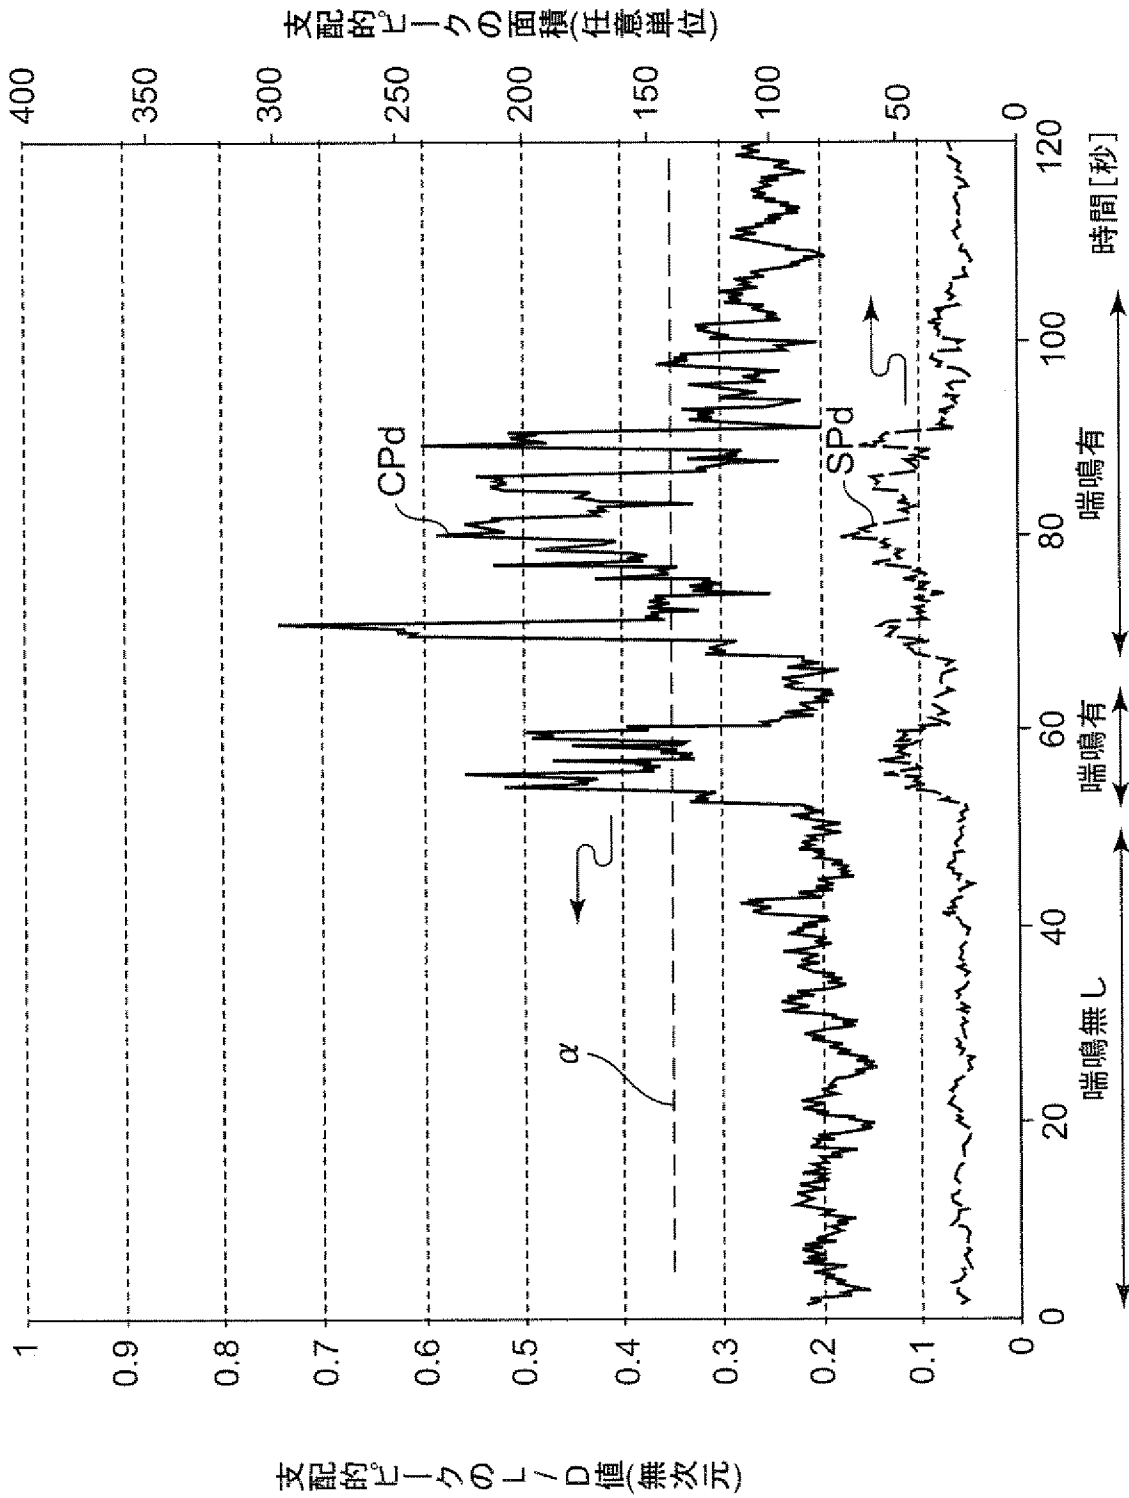


[図10]

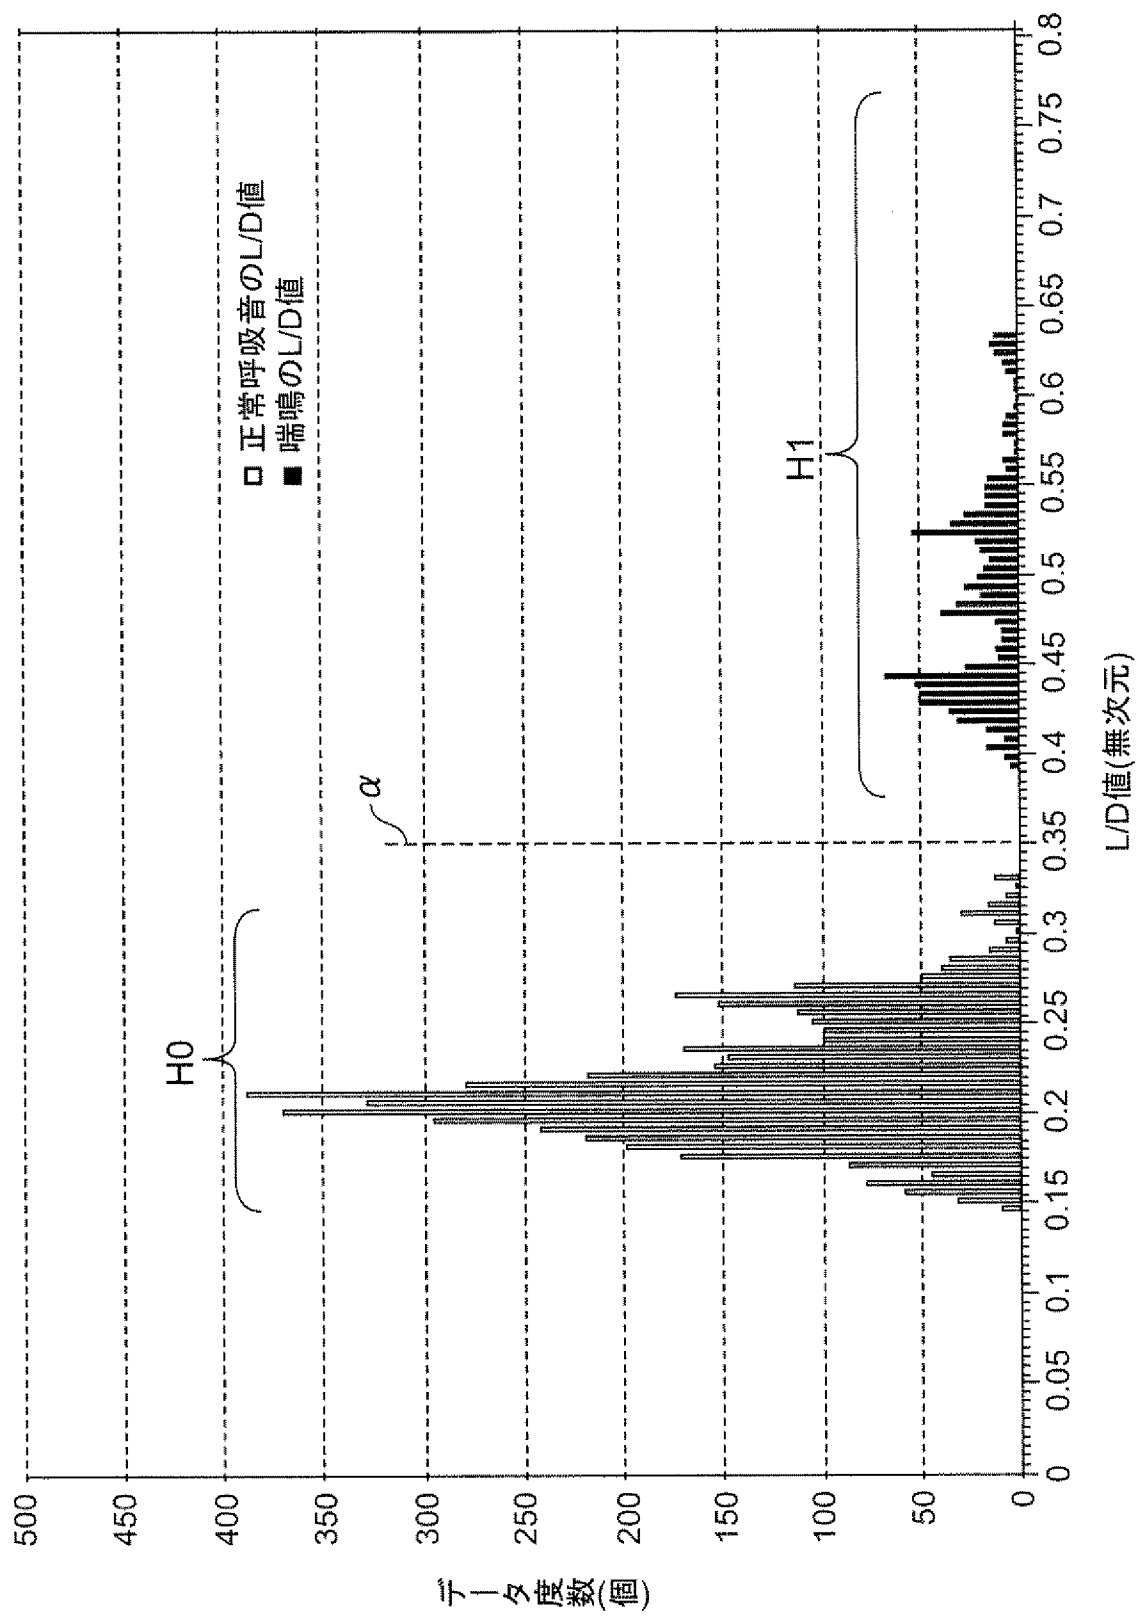


[図11]

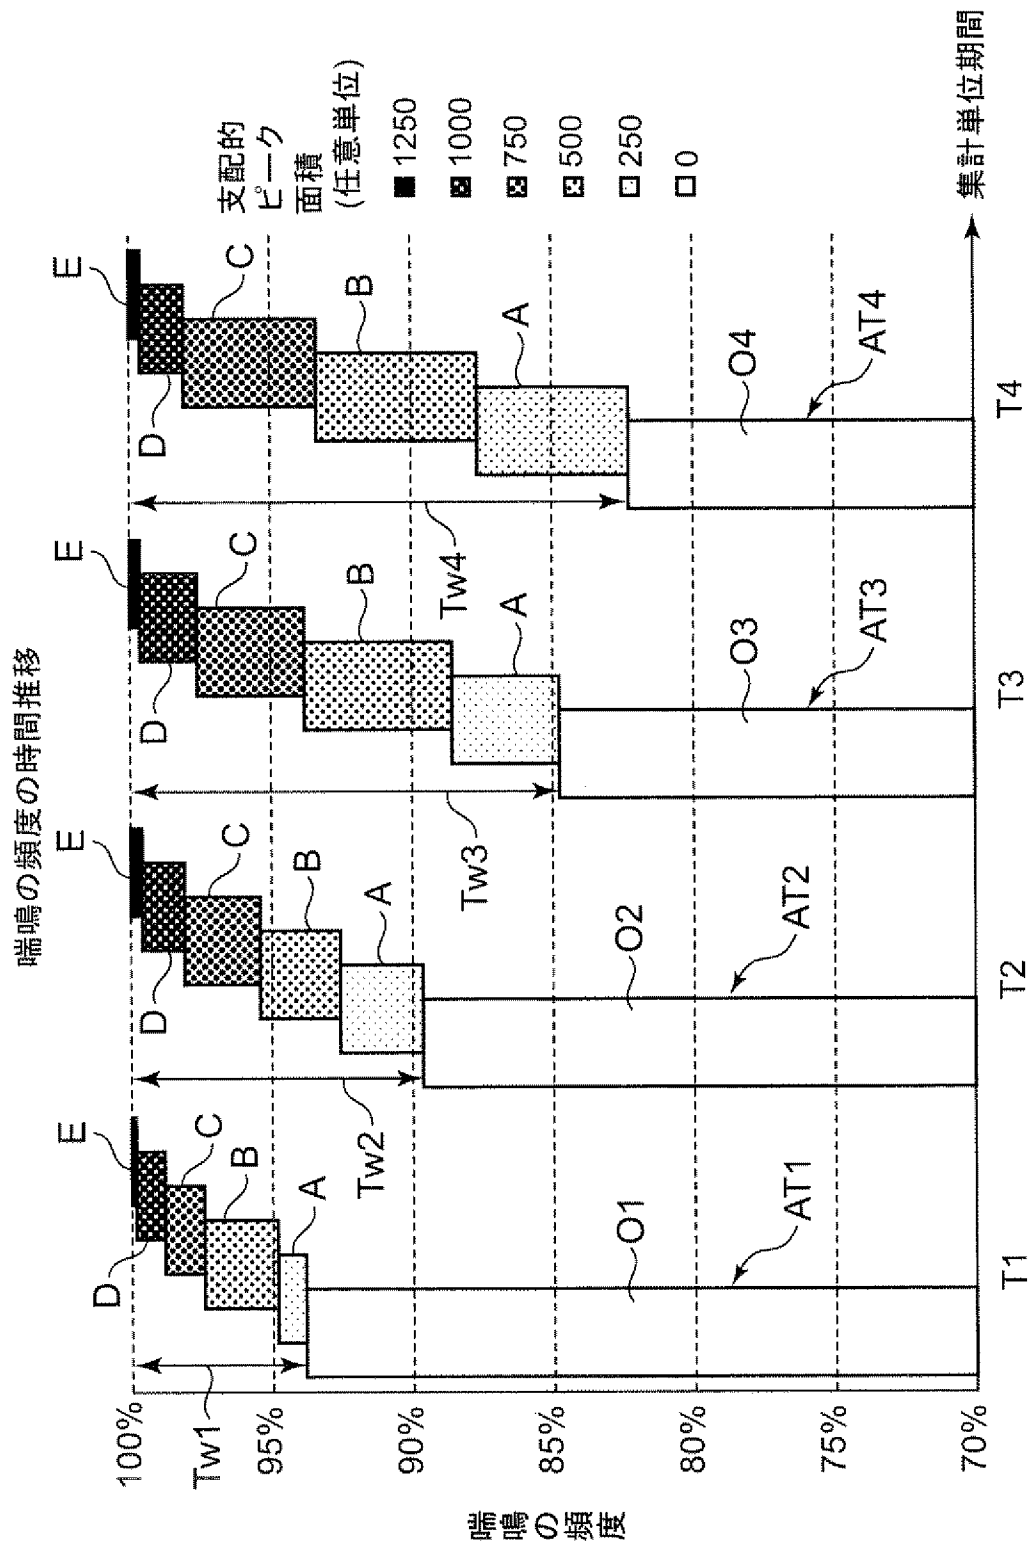


[図12]

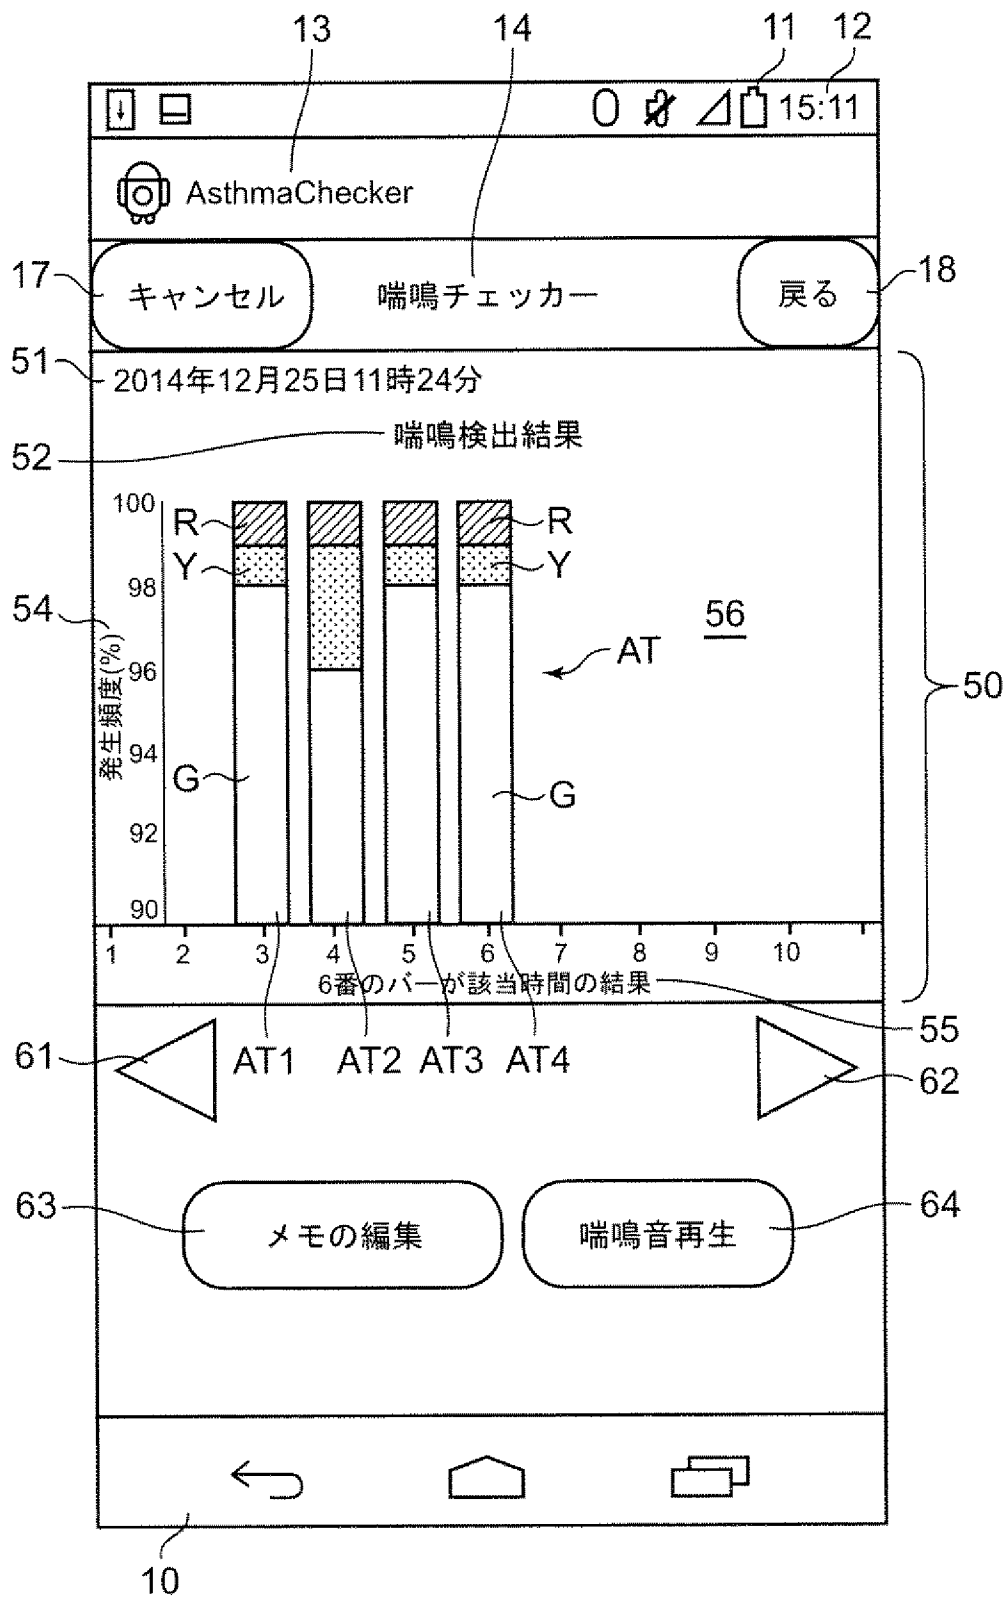


[図13]

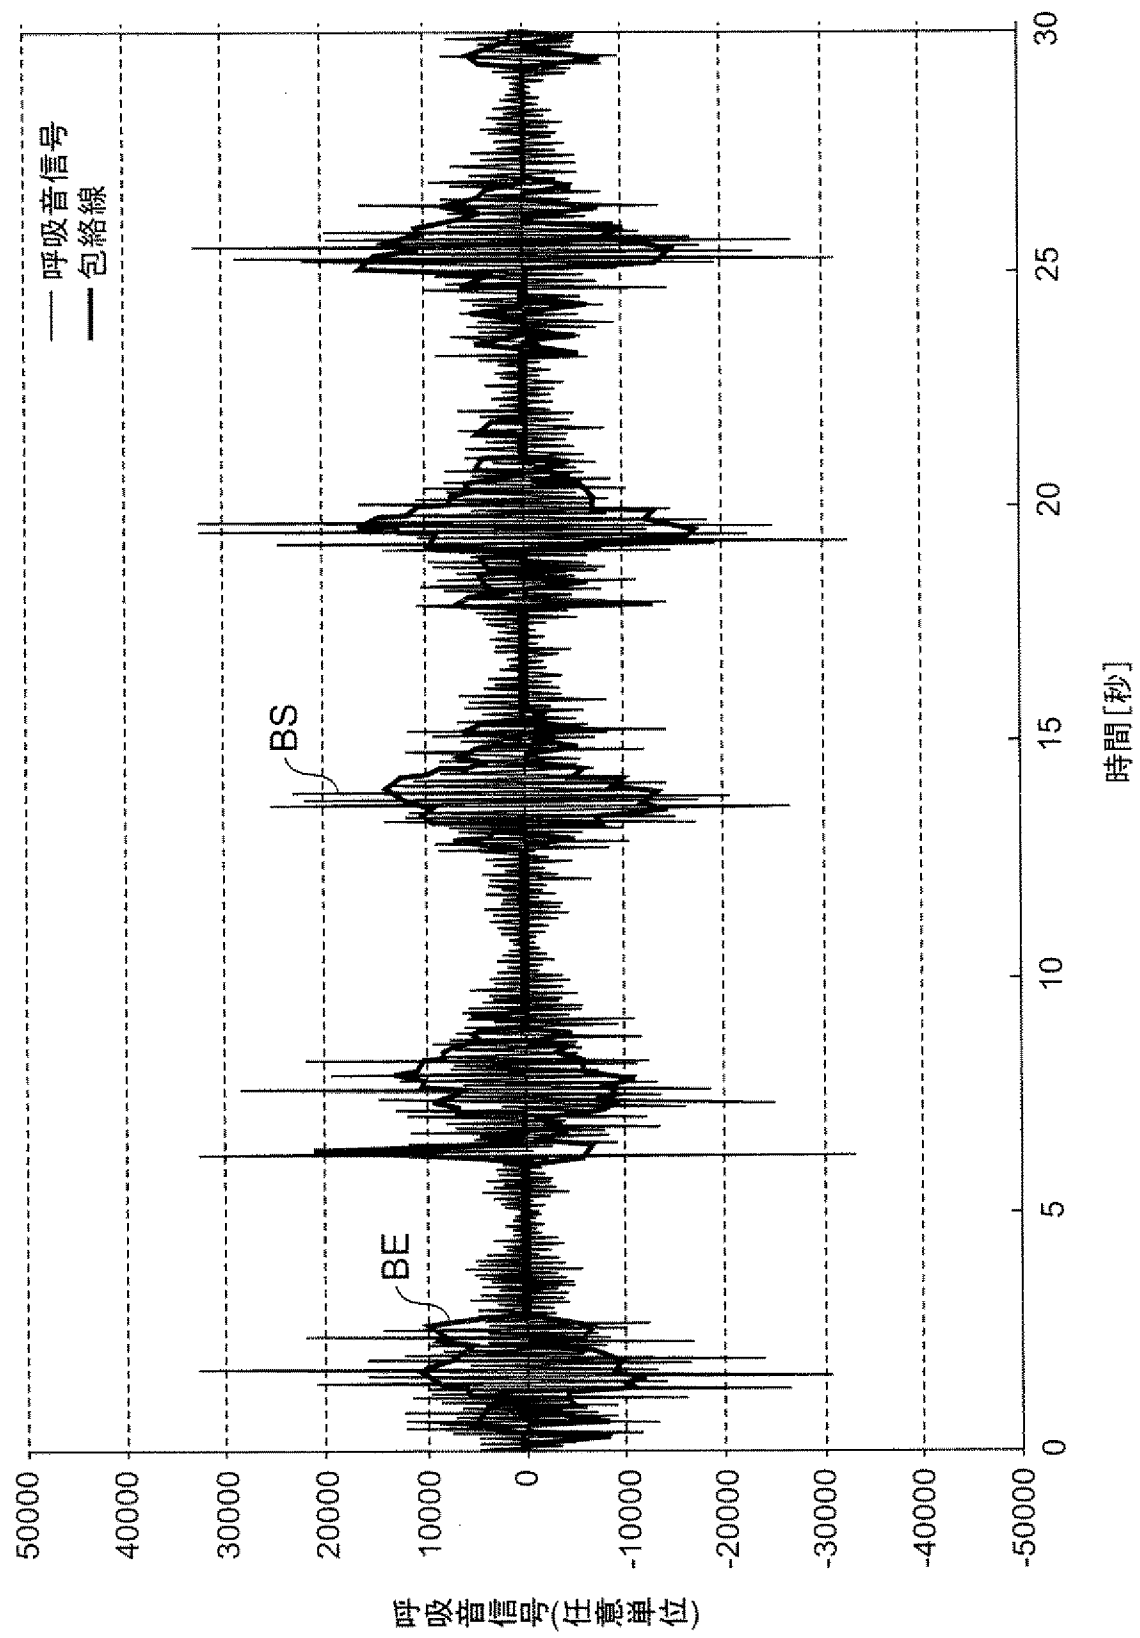


[図14]

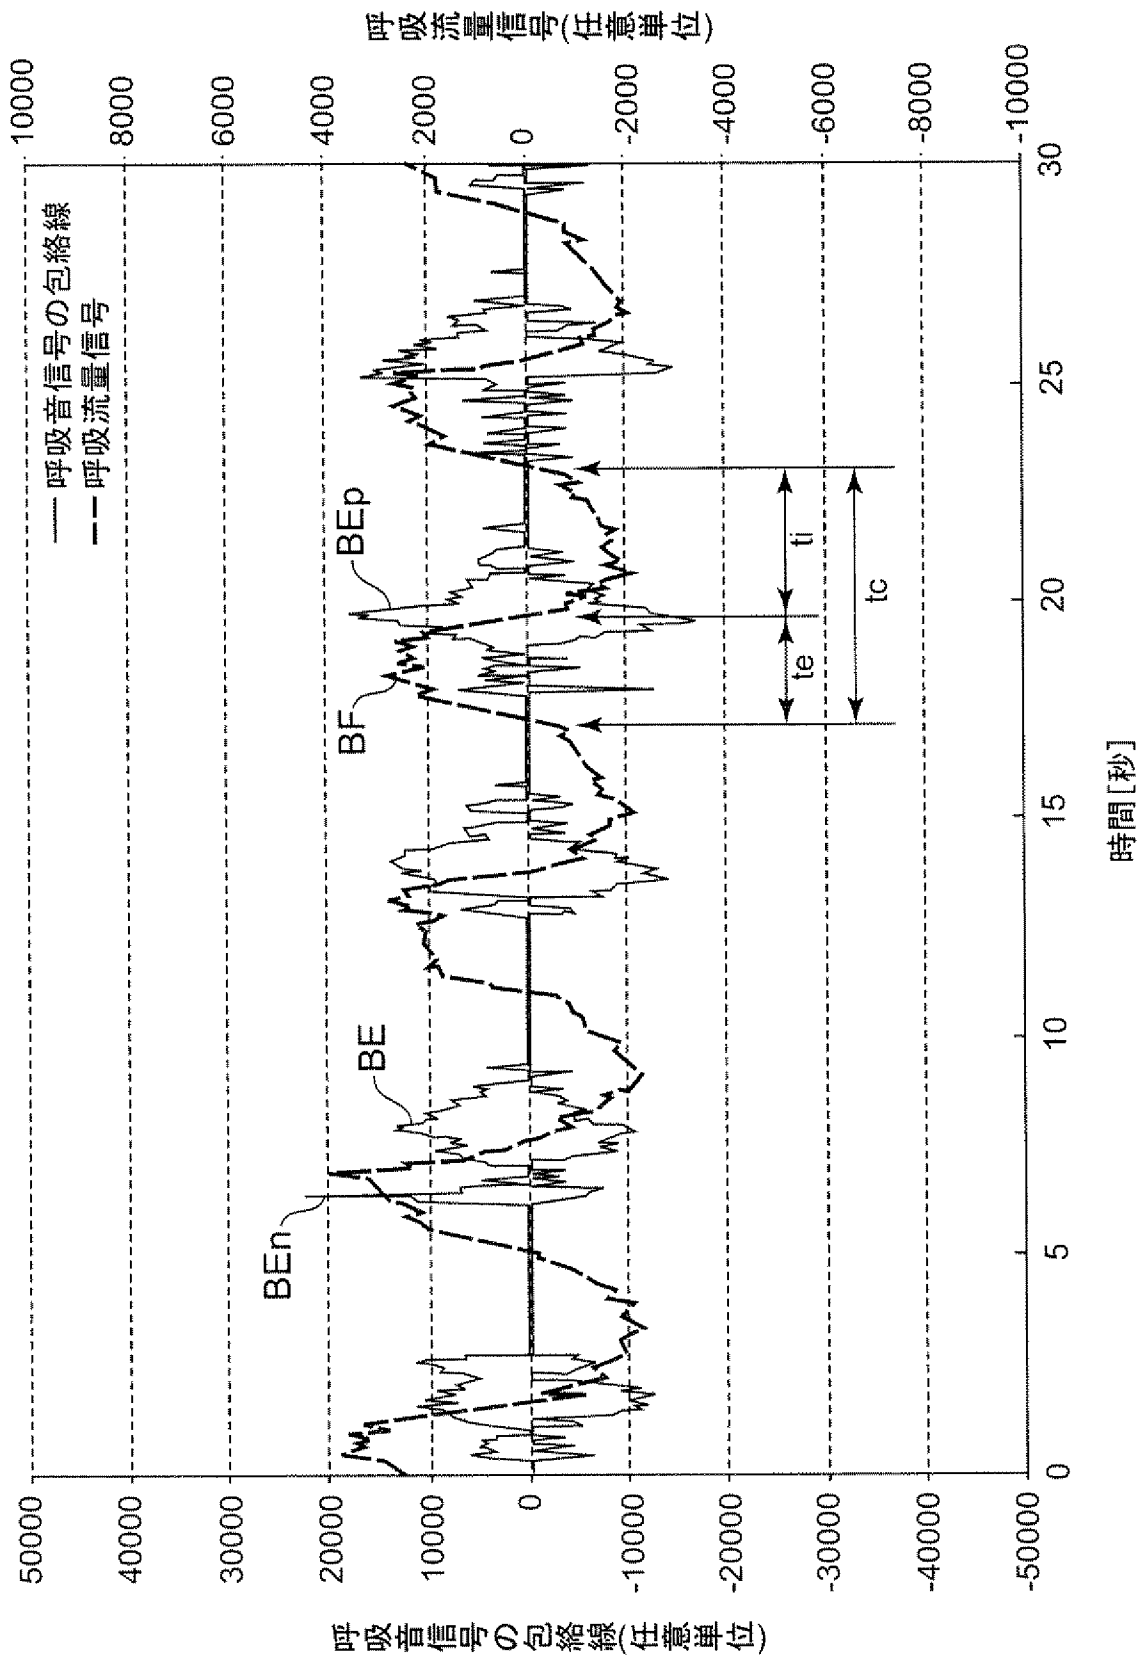


[図15]

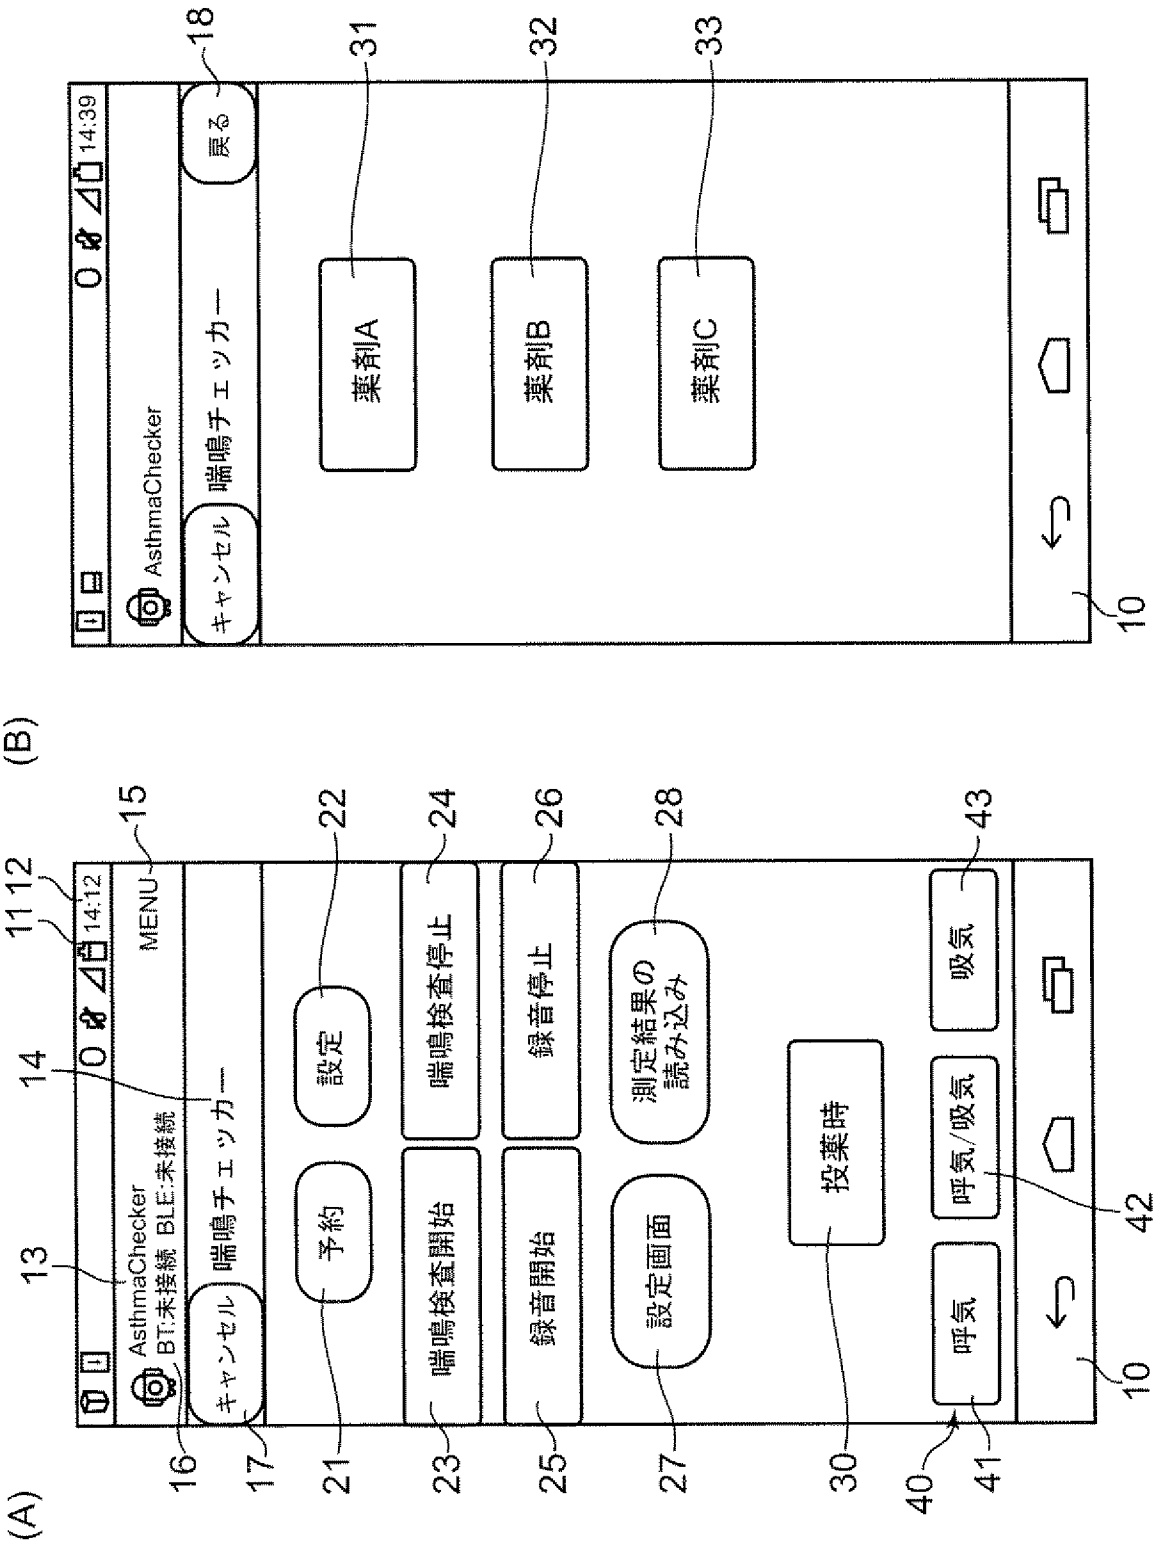


[図16]

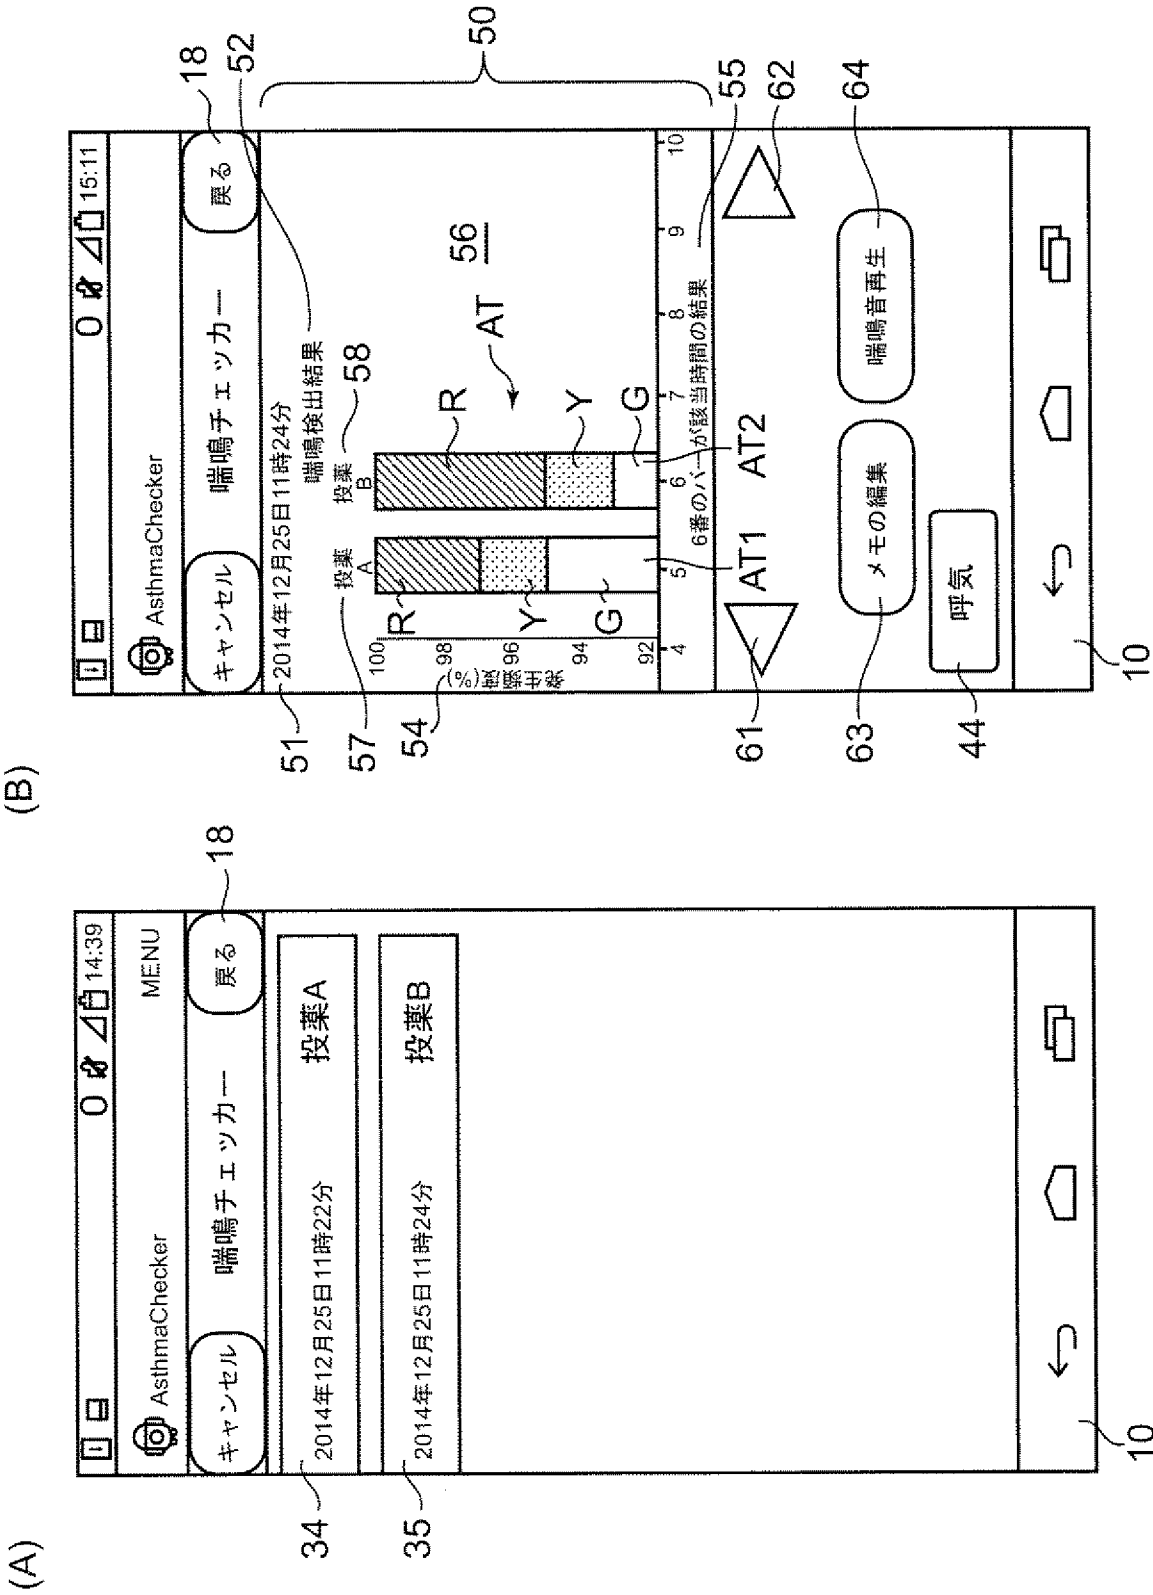


[図17]

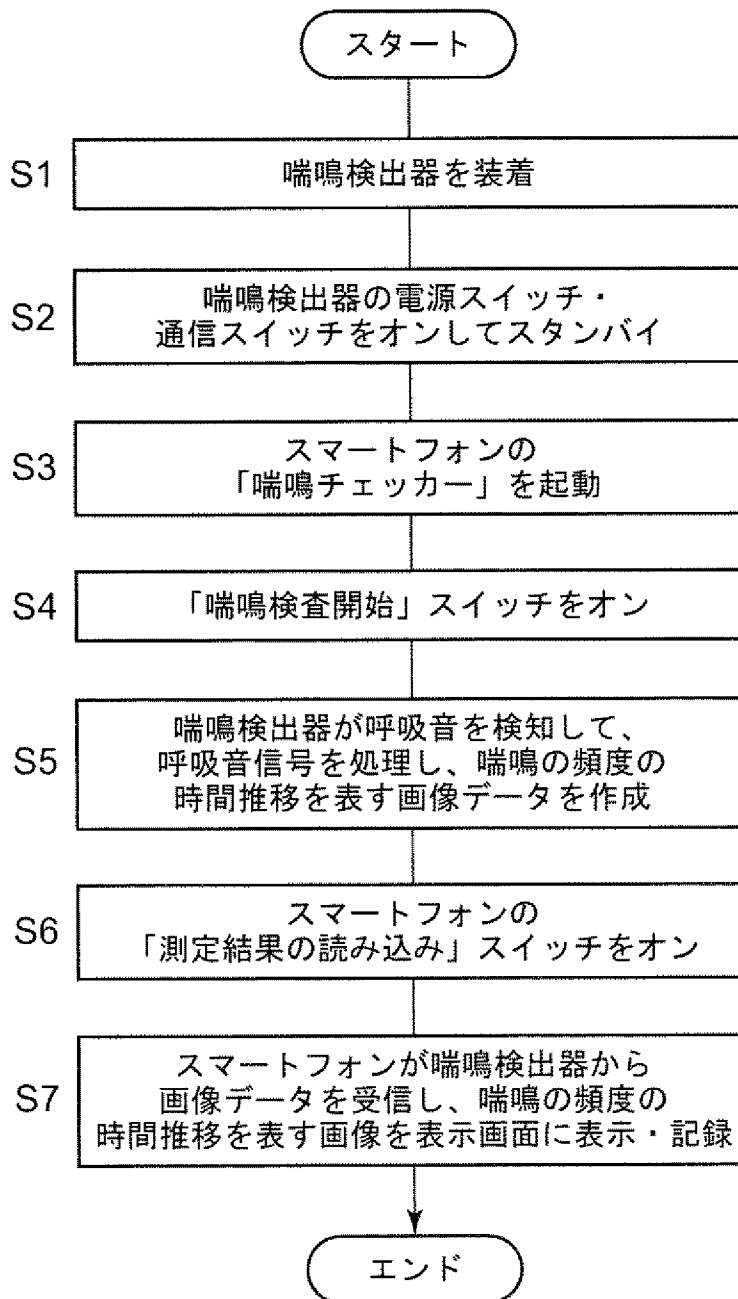

[図18]

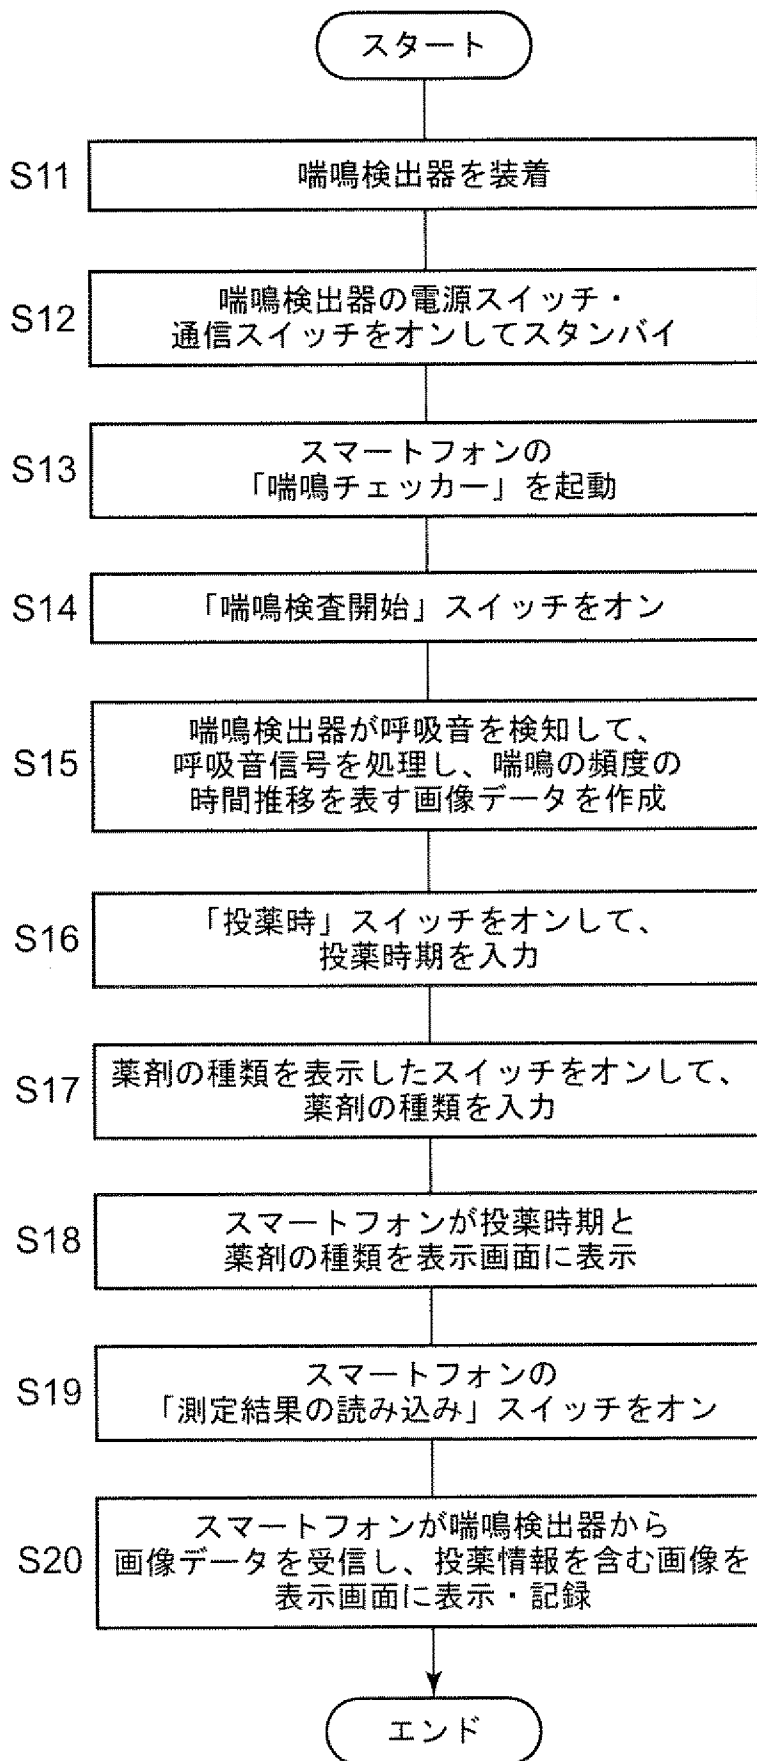

[図19]

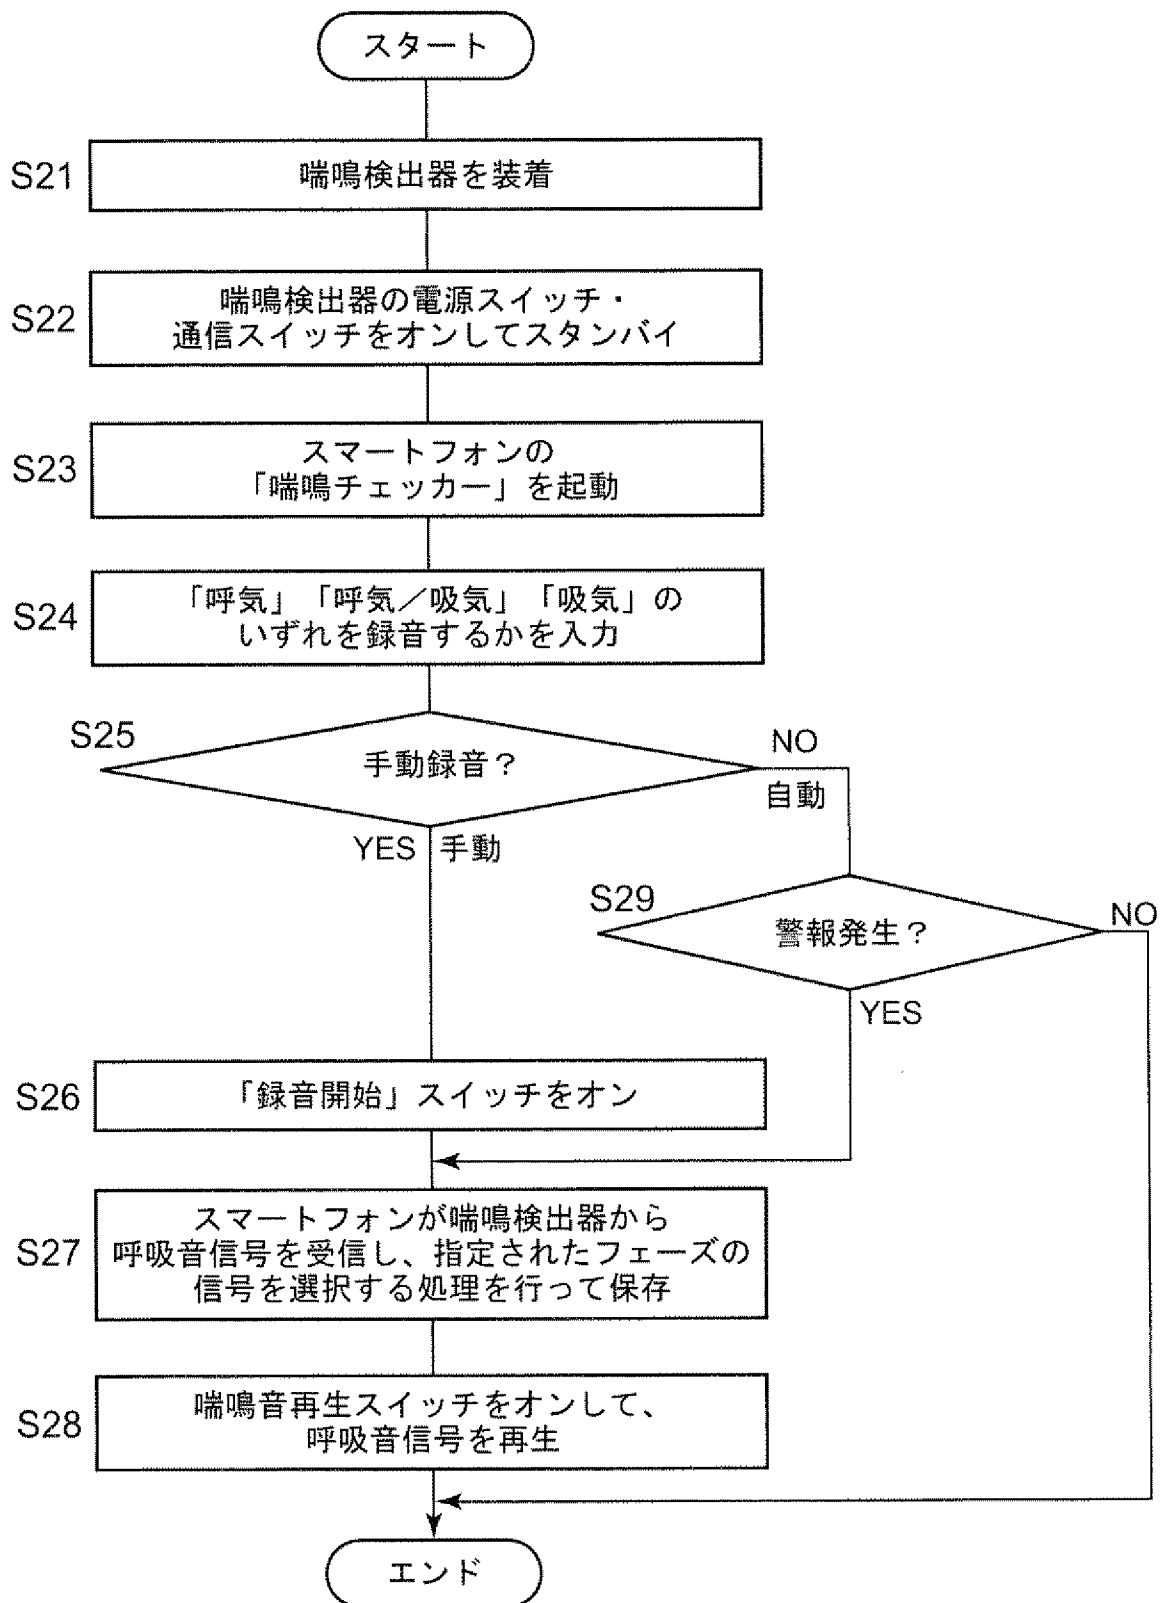

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2015/082505

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61B5/08(2006.01)i, A61B7/04(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61B5/08, A61B7/00-7/04, A61B5/00, A61B10/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2016
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2016	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2016

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamIII)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	US 2011/0125044 A1 (RHEE Hyekyun), 26 May 2011 (26.05.2011), paragraphs [0027], [0032] to [0035], [0045] to [0074], [0084], [0087] (Family: none)	1-4, 6 5, 7
Y	JP 2005-388 A (Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.), 06 January 2005 (06.01.2005), paragraphs [0019] to [0027]; fig. 2 to 3 (Family: none)	1-4, 6

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
09 February 2016 (09.02.16)

Date of mailing of the international search report
23 February 2016 (23.02.16)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2015/082505

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2000-316820 A (Remote Medical Corp.), 21 November 2000 (21.11.2000), paragraph [0039]; fig. 3 to 4 & US 2004/0015132 A1 paragraphs [0051] to [0052]; fig. 3 & EP 1034734 A1	6
A	JP 2013-521833 A (Sharp Corp.), 13 June 2013 (13.06.2013), paragraphs [0025] to [0035]; fig. 2 to 4 & US 2011/0230777 A1 paragraphs [0040] to [0049]; fig. 2 to 4 & WO 2011/115239 A1 & EP 2547256 A1 & CN 102781318 A	1-7

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. A61B5/08(2006.01)i, A61B7/04(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. A61B5/08, A61B7/00-7/04, A61B5/00, A61B10/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2016年
日本国実用新案登録公報	1996-2016年
日本国登録実用新案公報	1994-2016年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamIII)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y A	US 2011/0125044 A1 (RHEE Hyekyun) 2011.05.26, [0027], [0032]-[0035], [0045]-[0074], [0084], [0087] (ファミリー なし)	1-4, 6 5, 7
Y	JP 2005-388 A (住友大阪セメント株式会社) 2005.01.06, [0019]-[0027], 図 2-3 (ファミリーなし)	1-4, 6
Y	JP 2000-316820 A (リモート・メディカル・コーポレイション) 2000.11.21, [0039], 図 3-4 & US 2004/0015132	6

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

09.02.2016

国際調査報告の発送日

23.02.2016

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

門田 宏

2 Q

9 2 2 4

電話番号 03-3581-1101 内線 3292

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	A1, [0051]-[0052], Fig. 3 & EP 1034734 A1 JP 2013-521833 A (シャープ株式会社) 2013. 06. 13, [0025]-[0035], 図 2-4 & US 2011/0230777 A1, [0040]-[0049], Figs. 2-4 & WO 2011/115239 A1 & EP 2547256 A1 & CN 102781318 A	1-7