



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213964212 U

(45) 授权公告日 2021.08.17

(21) 申请号 202022825471.X

(22) 申请日 2020.11.30

(73) 专利权人 常州市儿童医院

地址 213000 江苏省常州市延陵中路468

(72) 发明人 李红新 唐霞 黄颖兰 张琴芬
华祎

(74) 专利代理机构 常州市英诺创信专利代理事
务所(普通合伙) 32258

代理人 蒋华

(51) Int.Cl.

A61G 15/04 (2006.01)

A61G 15/10 (2006.01)

A61G 15/12 (2006.01)

A61H 23/00 (2006.01)

A61M 21/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54) 实用新型名称

袋鼠式护理靠背椅

(57) 摘要

本实用新型提供一种袋鼠式护理靠背椅,包括坐部以及与所述坐部铰接的椅背,所述椅背与所述坐部角度可调节;所述袋鼠式护理靠背椅还设有:垫子,可加热,并覆盖所述坐部与所述椅背;弹性绑带,用于固定婴儿;拍背器,用于婴儿拍背。通过调节椅背角度,使婴儿的母(父)亲舒适的躺在靠背椅上,椅背放平还能充当床使用;由于婴儿是全裸置于母(父)亲裸露的胸前,因此垫子选用加热式,用于婴儿和母(父)亲保暖;绑带采用棉质,用于婴儿臀部以上固定,避免婴儿滑脱,便于婴儿听到妈妈的心跳声音,促进大脑发育;拍背器选用复苏囊面罩,便于妈妈准确的把握拍背位置和拍背力度,不易疲劳。

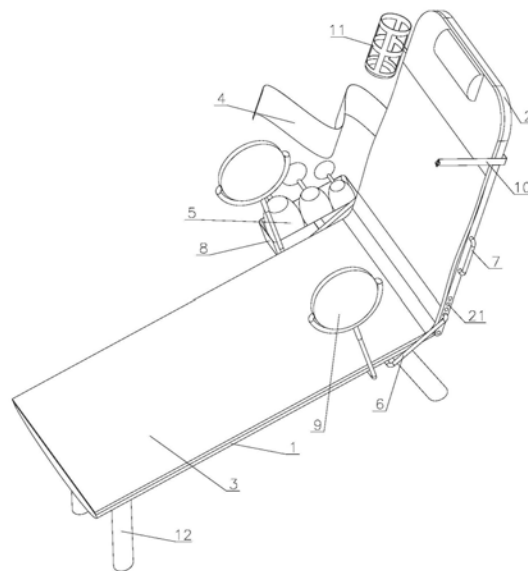

1. 一种袋鼠式护理靠背椅, 其特征在于: 包括坐部 (1) 以及与所述坐部 (1) 铰接的椅背 (2), 所述椅背 (2) 与所述坐部 (1) 角度可调节;

所述袋鼠式护理靠背椅还设有:

垫子 (3), 可加热, 并覆盖所述坐部 (1) 与所述椅背 (2);

弹性绑带 (4), 用于固定婴儿;

拍背器 (5), 用于婴儿拍背。

2. 根据权利要求1所述的袋鼠式护理靠背椅, 其特征在于: 所述坐部 (1) 与所述椅背 (2) 通过连接杆 (6) 连接, 通过所述连接杆 (6) 连接所述椅背 (2) 的不同位置改变所述椅背 (2) 与所述坐部 (1) 的角度。

3. 根据权利要求2所述的袋鼠式护理靠背椅, 其特征在于: 所述椅背 (2) 设有多个卡接孔 (21), 所述连接杆 (6) 一端与所述坐部 (1) 弹性连接, 另一端卡接所述卡接孔 (21)。

4. 根据权利要求1所述的袋鼠式护理靠背椅, 其特征在于: 所述垫子 (3) 内设有电加热丝 (31)。

5. 根据权利要求1所述的袋鼠式护理靠背椅, 其特征在于: 所述绑带 (4) 设于所述椅背 (2) 一端, 所述椅背 (2) 另一端设有用于固定所述绑带 (4) 的固定杆 (7)。

6. 根据权利要求1所述的袋鼠式护理靠背椅, 其特征在于: 所述坐部 (1) 一端设有挂篮 (8), 所述挂篮 (8) 中放置有多个不同尺寸的所述拍背器 (5)。

7. 根据权利要求1所述的袋鼠式护理靠背椅, 其特征在于: 所述坐部 (1) 两端设有观察镜 (9), 所述观察镜 (9) 可旋转, 用于观察婴儿面部。

8. 根据权利要求7所述的袋鼠式护理靠背椅, 其特征在于: 所述观察镜 (9) 包括与所述坐部 (1) 固定连接的镜杆 (91), 所述镜杆 (91) 上端套接有镜架 (92), 所述镜架 (92) 内铰接有镜子 (93)。

9. 根据权利要求1所述的袋鼠式护理靠背椅, 其特征在于: 所述椅背 (2) 一端还设有支架 (10), 用于固定管子。

10. 根据权利要求1所述的袋鼠式护理靠背椅, 其特征在于: 所述椅背 (2) 一端还设有水壶架 (11), 所述水壶架 (11) 靠近所述椅背 (2) 端部位置。

11. 根据权利要求1所述的袋鼠式护理靠背椅, 其特征在于: 所述垫子 (3) 覆盖所述椅背 (2) 部分的上端面设为仿形人体脊柱生理曲线的曲面。

12. 根据权利要求1所述的袋鼠式护理靠背椅, 其特征在于: 所述坐部 (1) 下端铰接有多个均布的支腿 (12), 并设有放置所述支腿 (12) 的放置槽 (13)。

袋鼠式护理靠背椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及婴儿护理用具技术领域,具体是一种袋鼠式护理靠背椅。

背景技术

[0002] 早产儿的母(父)亲,以类似袋鼠等有袋动物照顾幼儿的方式,将早产儿60度倾斜地贴在母(父)亲的胸口,提供他(她)所需的温暖及安全感。这种方式被欧美以及国际卫生组织确认为最佳的新生儿护理方法,尤其适合早产宝宝。但是在早产妈妈参与袋鼠式护理的过程中,经常会出现宝宝滑脱等安全隐患。另外袋鼠式护理过程中还需要妈妈经常给宝宝拍背,促进支气管肺发育不良的恢复,但是宝妈的手由于太大,拍背效果欠佳。还有很多早产在袋鼠式护理期间还需要简易呼吸机支持,简易呼吸机的管道无法固定,容易脱落等现象。为了避免这些不良现象,设计并制造一种用于给早产儿进行袋鼠式护理的靠背椅。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是:为解决上述问题,本实用新型提供了一种袋鼠式护理靠背椅。

[0004] 本实用新型提供一种袋鼠式护理靠背椅,包括坐部以及与所述坐部铰接的椅背,所述椅背与所述坐部角度可调节;

[0005] 所述袋鼠式护理靠背椅还设有:

[0006] 垫子,可加热,并覆盖所述坐部与所述椅背;

[0007] 弹性绑带,用于固定婴儿;

[0008] 拍背器,用于婴儿拍背。

[0009] 通过调节椅背角度,使婴儿的母(父)亲舒适的躺在靠背椅上,椅背放平还能充当床使用;由于婴儿是全裸置于母(父)亲裸露的胸前,因此垫子选用加热式,用于婴儿和母(父)亲保暖;绑带采用棉质,用于婴儿臀部以上固定,避免婴儿滑脱,便于婴儿听到妈妈的心跳声音,促进大脑发育;拍背器选用复苏囊面罩,便于妈妈准确的把握拍背位置和拍背力度,不易疲劳。

[0010] 进一步的,所述坐部与所述椅背通过连接杆连接,通过所述连接杆连接所述椅背的不同位置改变所述椅背与所述坐部的角度。通过连接杆连接椅背的不同位置调节椅背的角度,结构简单、操作方便。

[0011] 进一步的,所述椅背设有多个卡接孔,所述连接杆一端与所述坐部弹性连接,另一端卡接所述卡接孔。连接杆一端通过弹簧与坐部弹性连接;通过不同的卡接孔卡接连接杆,实现椅背角度调节,结构简单。

[0012] 进一步的,所述垫子内设有电加热丝。垫子通过电加热丝加热,制作成本低。

[0013] 进一步的,所述绑带设于所述椅背一端,所述椅背另一端设有用于固定所述绑带的固定杆。绑带端部设置毛刺搭扣,并通过毛刺搭扣固定在固定杆上,结构简单,操作方便。

[0014] 进一步的,所述坐部一端设有挂篮,所述挂篮中放置有多个不同尺寸的所述拍背

器。挂篮用于放置多个不同尺寸的拍背器,根据婴儿生长选用不同的拍背器;挂篮中还可以放置音乐播放器,播放一些古典音乐,有利于早产宝宝大脑发育。

[0015] 进一步的,所述坐部两端设有观察镜,所述观察镜可旋转,用于观察婴儿面部。观察镜用于妈妈检查婴儿是否有吐奶现象,是否呼吸正常。

[0016] 进一步的,所述观察镜包括与所述坐部固定连接的镜杆,所述镜杆上端套接有镜架,所述镜架内铰接有镜子。通过镜架套接镜杆的方式实现镜子纵向旋转,通过镜架铰接镜子实现镜子横向旋转。

[0017] 进一步的,所述椅背一端还设有支架,用于固定管子。早产宝宝一般会带着呼吸机,通过支架固定呼吸机的管子,使管子不易脱落,减去医护人员的顾虑。

[0018] 进一步的,所述椅背一端还设有水壶架,所述水壶架靠近所述椅背端部位置。水壶架用于放置水壶,在水壶中插入吸管就能提供妈妈饮水。

[0019] 进一步的,所述垫子覆盖所述椅背部分的上端面设为仿形人体脊柱生理曲线的曲面。如此,使护理婴儿的母(父)亲更加舒适,不易疲劳,身体不易产生酸痛。

[0020] 进一步的,所述坐部下端铰接有多个均布的支腿,并设有放置所述支腿的放置槽。将连接杆与椅背脱离,椅背与坐部可以折叠;支腿旋转,可放置于放置槽中,如此便于妈妈拿取。

附图说明

[0021] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0022] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0023] 图2是本实用新型的俯视图;

[0024] 图3是图2中A-A的剖视图;

[0025] 图4是图2中B-B的剖视图;

[0026] 图5是本实用新型另一个视角的结构示意图;

[0027] 图6是本实用新型椅背放平后的结构示意图;

[0028] 图7是本实用新型椅背放平后的主视图;

[0029] 图中:1、坐部;2、椅背;3、垫子;4、绑带;5、拍背器;6、连接杆;7、固定杆;8、挂篮;9、观察镜;10、支架;11、水壶架;12、支腿;13、放置槽;21、卡接孔;31、电加热丝;91、镜杆;92、镜架;93、镜子。

具体实施方式

[0030] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0031] 如图1和图2所示,本实用新型是一种袋鼠式护理靠背椅,包括坐部1以及与坐部1铰接的椅背2,椅背2与坐部1角度可调节;坐部1与椅背2通过连接杆6连接,如图4所示,连接杆6一端通过弹簧与坐部1弹性连接,椅背2设有多个卡接孔21,通过连接杆6另一端连接不同的卡接孔21改变椅背2与坐部1的角度,结构简单、操作方便。

[0032] 如图3所示,袋鼠式护理靠背椅还设有垫子3,垫子3覆盖坐部1与椅背2并通过内部设置的电加热丝31加热。垫子3覆盖椅背2部分的上端面设为仿形人体脊柱生理曲线的曲

面。如此,使护理婴儿的母(父)亲更加舒适,不易疲劳,身体不易产生酸痛。

[0033] 坐部1一端设有挂篮8,挂篮8中放置有多个不同尺寸的拍背器5,拍背器5选用复苏囊面罩,根据婴儿生长选用不同的复苏囊面罩,便于妈妈准确的把握拍背位置和拍背力度,不易疲劳;挂篮8中还可以放置音乐播放器,播放一些古典音乐,有利于早产宝宝大脑发育。

[0034] 坐部1两端设有观察镜9,用于观察婴儿面部;观察镜9包括与坐部1固定连接的镜杆91,镜杆91上端套接有镜架92,镜架92内铰接有镜子93。通过镜架92套接镜杆91的方式实现镜子93纵向旋转,通过镜架92铰接镜子93实现镜子93横向旋转。如此便于妈妈调整镜子93的角度,便于检查婴儿是否有吐奶现象,是否呼吸正常。

[0035] 椅背2一端设有弹性绑带4,另一端设有固定杆7,绑带4端部设置毛刺搭扣,并通过毛刺搭扣固定在固定杆7上,实现婴儿固定,结构简单,操作方便。

[0036] 椅背2一端还设有水壶架11,水壶架11靠近椅背2端部位置。水壶架11用于放置水壶,在水壶中插入吸管就能提供妈妈饮水。

[0037] 椅背2一端还设有支架10,用于固定管子。早产宝宝一般会带着呼吸机,通过支架10固定呼吸机的管子,使管子不易脱落,减去医护人员的顾虑。

[0038] 如图5所示,坐部1下端铰接有四个均布的支腿12,并设有放置支腿12的放置槽13。将连接杆6与椅背2脱离,椅背2与坐部1可以折叠;支腿12旋转,可放置于放置槽13中,如此便于妈妈拿取。

[0039] 通过调节椅背2角度,使婴儿的母(父)亲舒适的躺在靠背椅上,如图6和图7所示,椅背2放平还能充当床使用;由于婴儿是全裸置于母(父)亲裸露的胸前,因此垫子3选用加热式,用于婴儿和母(父)亲保暖;绑带4采用棉质,用于婴儿臀部以上固定,避免婴儿滑脱,便于婴儿听到妈妈的心跳声音,促进大脑发育。

[0040] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

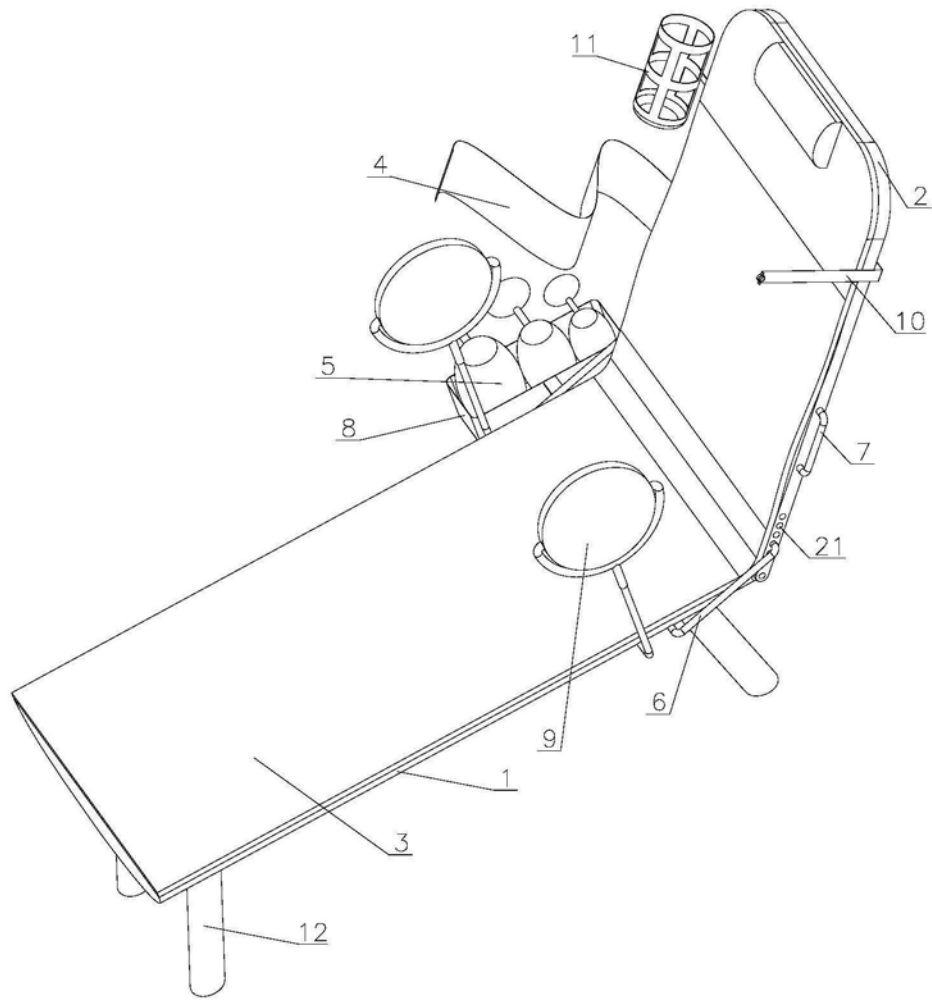


图1

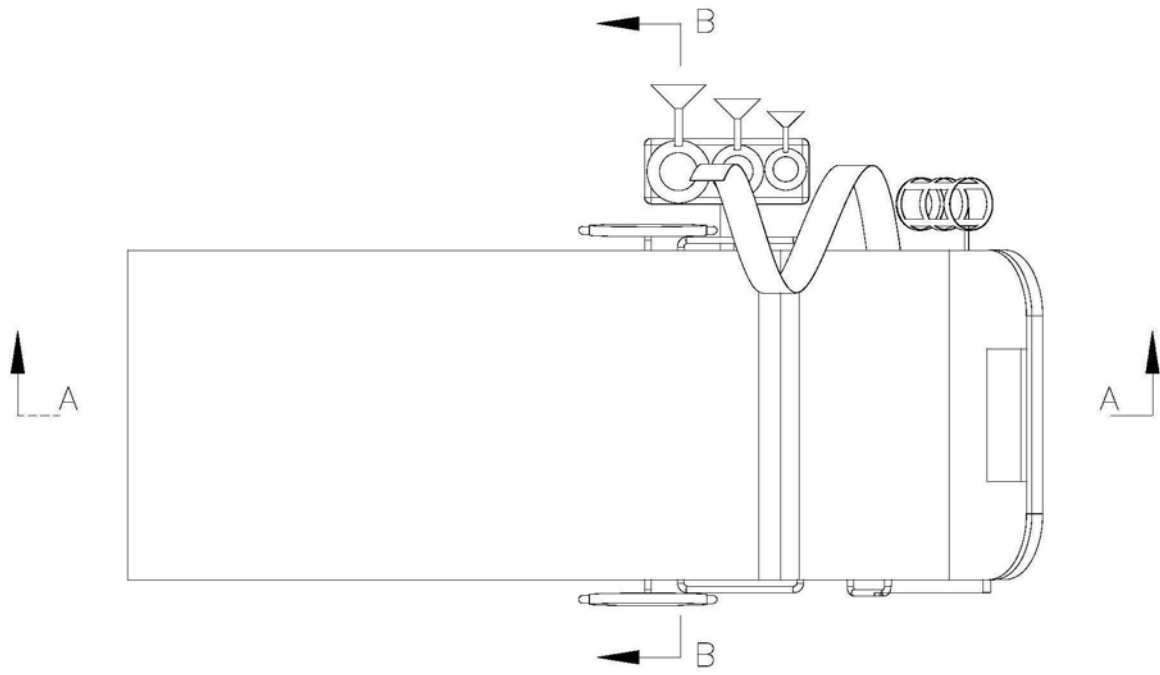


图2

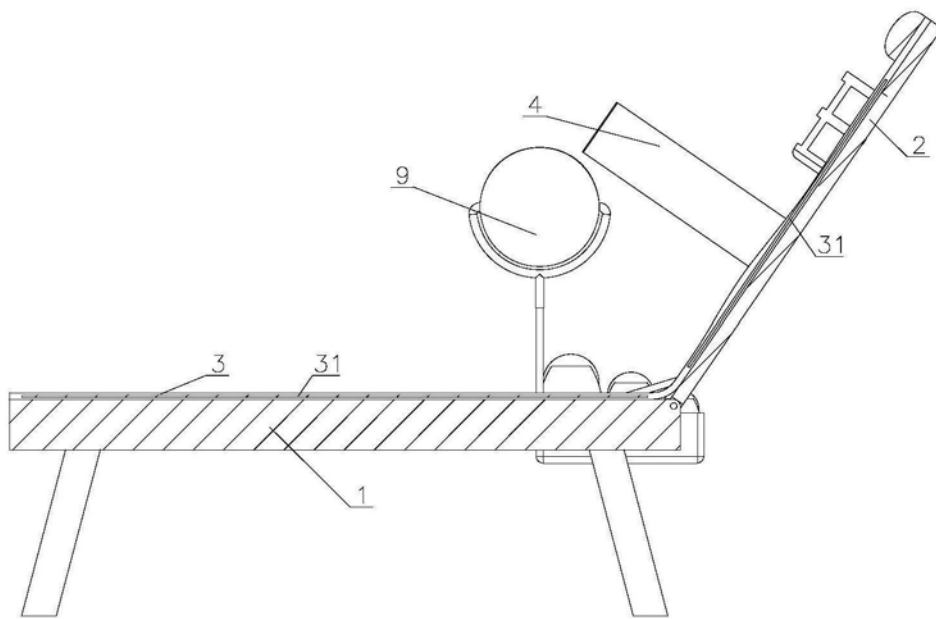


图3

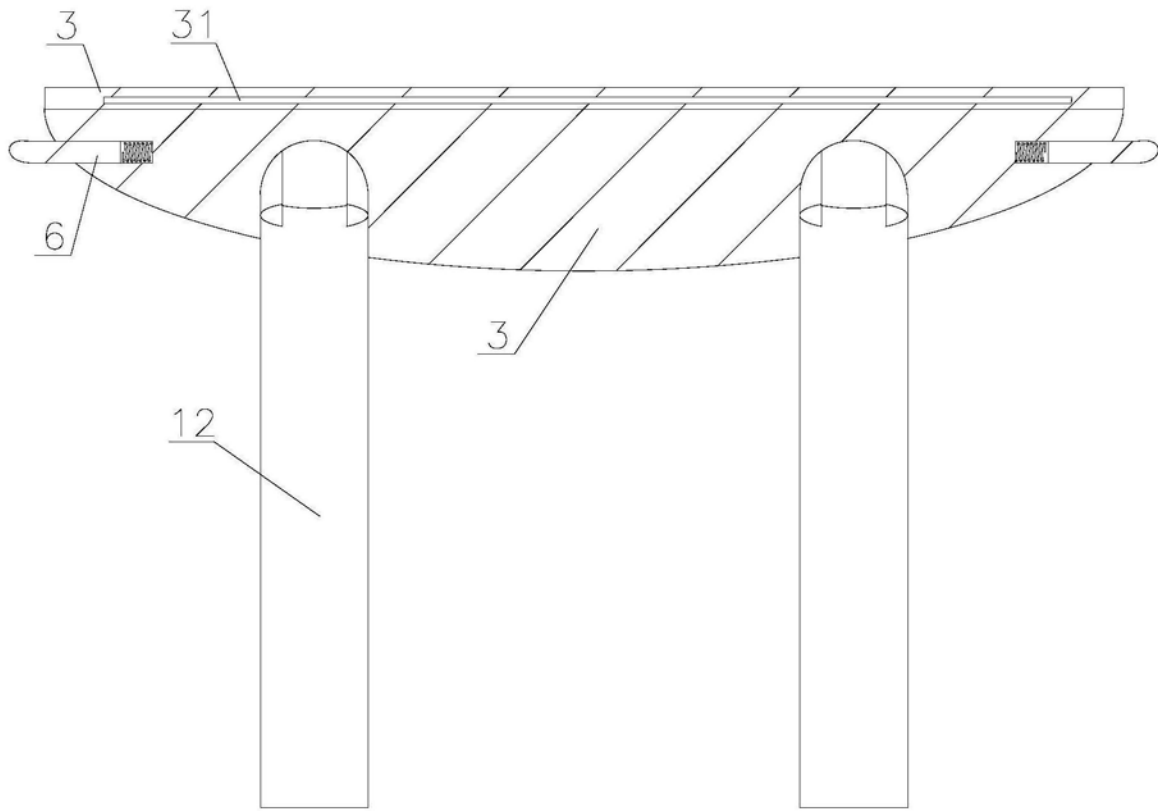


图4

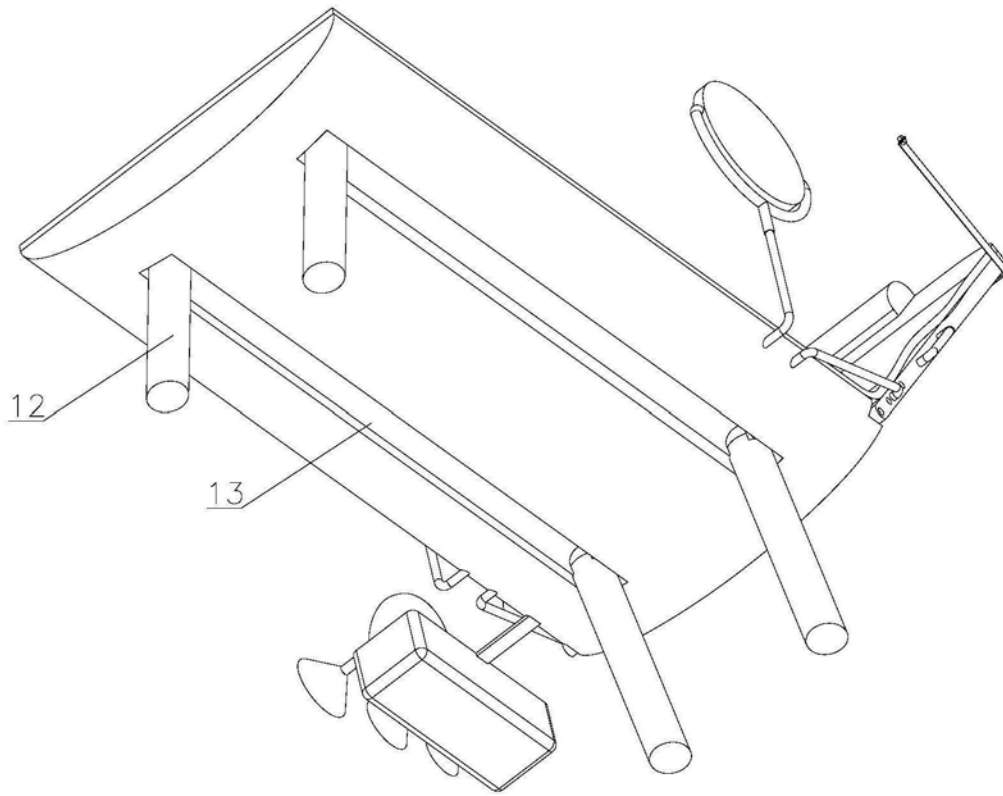


图5

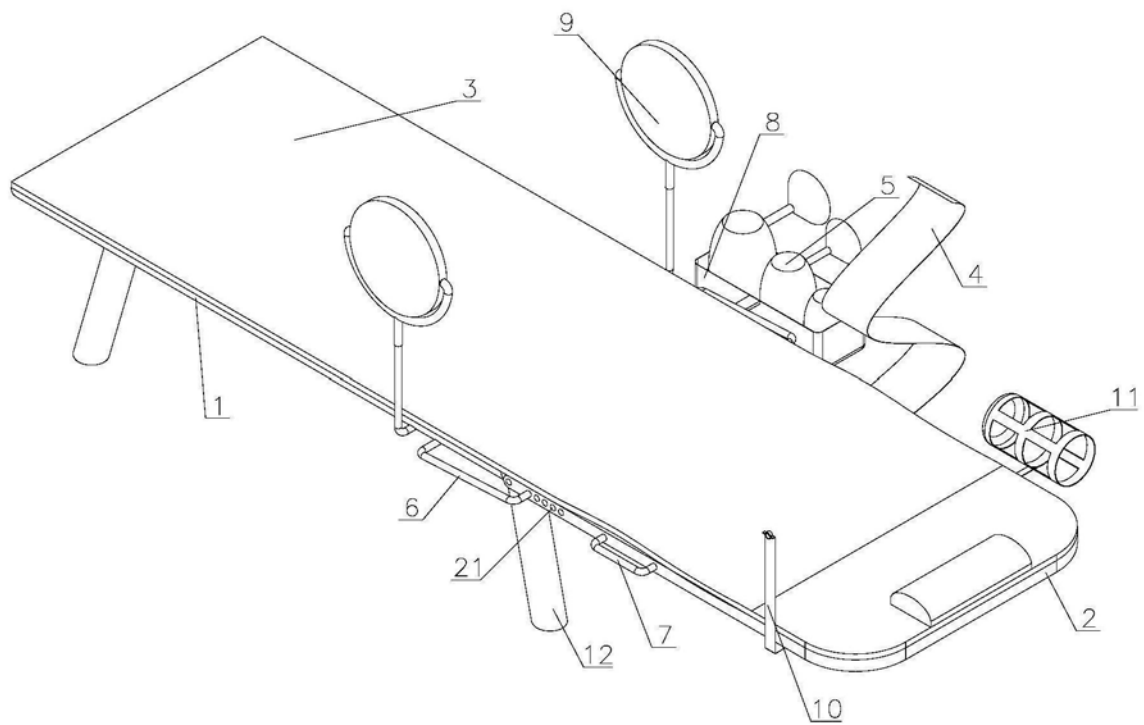


图6

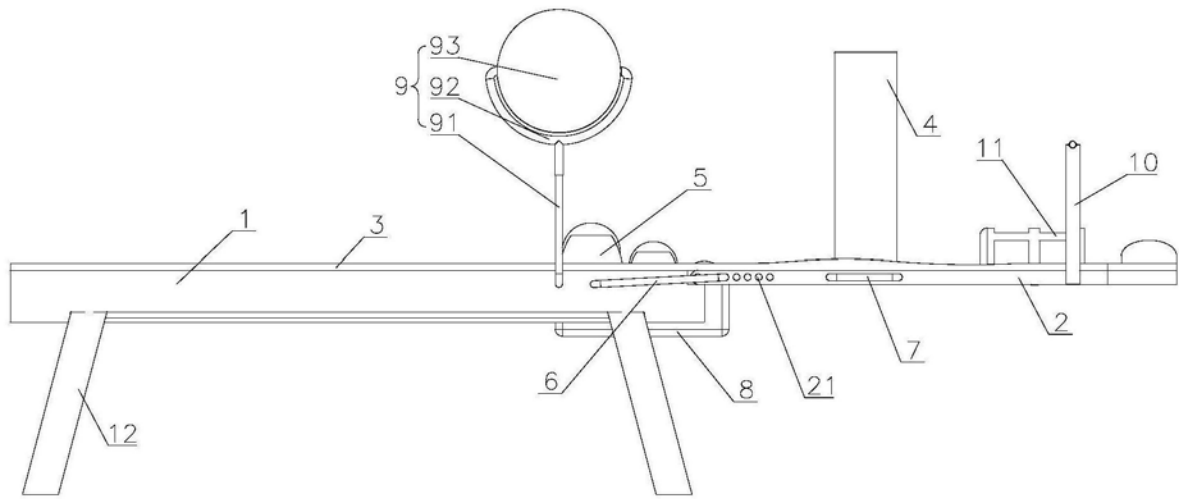


图7