

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202554277 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 28

(21) 申请号 201220190864. 0

(22) 申请日 2012. 04. 21

(73) 专利权人 王玉霞

地址 261100 山东省潍坊市寒亭区民主街
202 号寒亭区人民医院

(72) 发明人 王玉霞 郭涛

(51) Int. Cl.

A61F 15/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

眼科术后包扎器

(57) 摘要

眼科术后包扎器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括眼镜框和弹力耳套,其特征是在眼镜框周边设有弹力丝,弹力丝上设有定位环。本实用新型结构简单,在给病人进行眼科疾病手术后加压包扎时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。

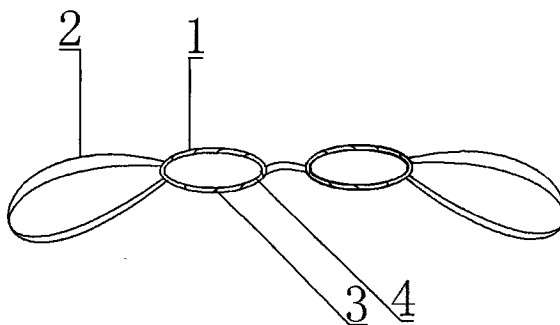

1. 眼科术后包扎器,包括眼镜框(1)和弹力耳套(2),其特征是:在眼镜框(1)内面周边设有弹力丝(3),弹力丝(3)上设有定位环(4)。

眼科术后包扎器

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种眼科术后包扎器。

[0003] 背景技术：

[0004] 目前，临床上多种眼科疾病手术后需要进行局部加压包扎，传统方法是将纱布多层折叠，然后缠绕固定，这样操作起来十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0005] 发明内容：

[0006] 本实用新型的目的是提供一种在给病人进行眼科疾病手术后加压包扎时操作简便、省时省力的眼科术后包扎器。

[0007] 本实用新型的技术方案是：包括眼镜框和弹力耳套，其特征是在眼镜框周边设有弹力丝，弹力丝上设有定位环。

[0008] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行眼科疾病手术后加压包扎时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0009] 附图说明：

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图中 1、眼镜框，2、弹力耳套，3、弹力丝，4、定位环。

[0012] 具体实施方式：

[0013] 包括眼镜框 1 和弹力耳套 2，其特征是在眼镜框 1 周边设有弹力丝 3，弹力丝 3 上设有定位环 4。在给病人进行眼科疾病手术后加压包扎时，纱布垫置于眼外，定位环 4 压在纱布垫上，弹力耳套 2 戴在病人耳后根部即可。

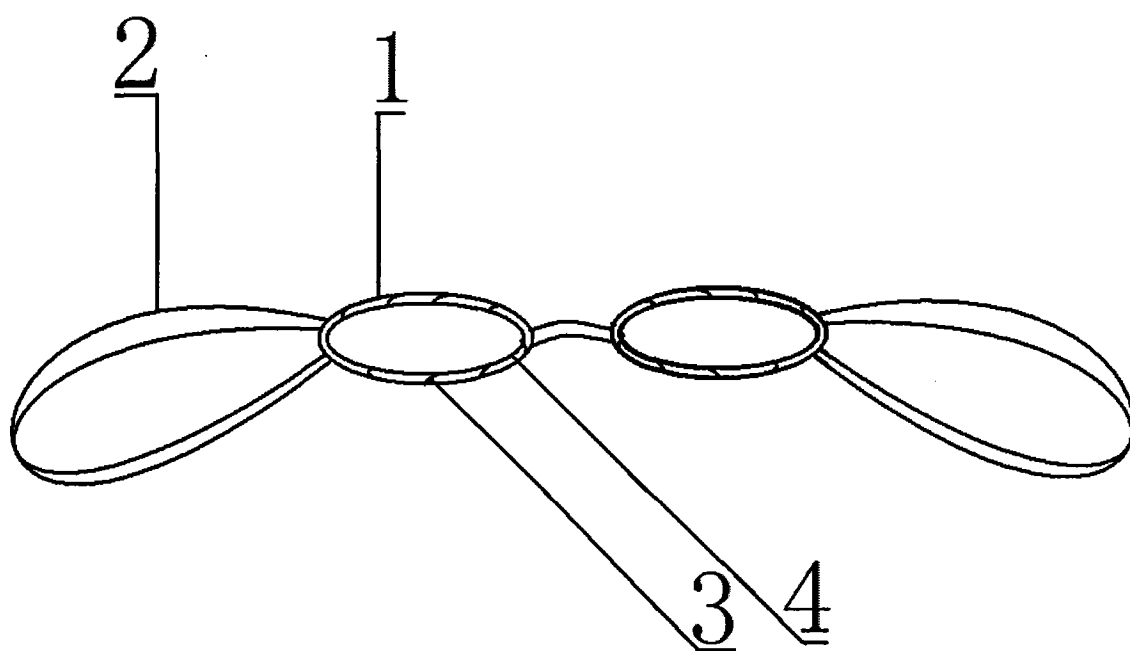


图 1