



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203000969 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 19

(21) 申请号 201320027326. 4

(22) 申请日 2013. 01. 18

(73) 专利权人 秦建华

地址 276800 山东省日照市东港区人民医院

(72) 发明人 秦建华 宋景国

(74) 专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务  
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51) Int. Cl.

A61B 6/04 (2006. 01)

A61B 6/03 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

新型 CT 检查床

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型 CT 检查床,包括床板、床腿和滑轮,所述床板上设有头部固定枕,所述床板上设有两个侧挡板,同时沿床板宽度方向上设有两个滑动槽,所述两个侧挡板沿滑动槽来回移动,所述床板上还设有固定带。本实用新型中检查床上两个侧挡板之间间距的可调性以及固定带的设计,使得本实用新型能根据患者的实际身体宽度进行相应的调整、固定患者的位置,以更好、更快的对那些不配合的儿童患者进行检查。

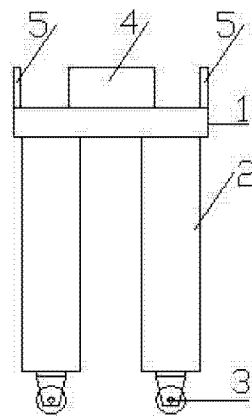

1. 新型 CT 检查床,包括床板、床腿和滑轮,所述床板上设有头部固定枕,其特征在于:所述床板上设有两个侧挡板,同时沿床板宽度方向上设有两个滑动槽,所述两个侧挡板沿滑动槽来回移动,所述床板上还设有固定带。

## 新型 CT 检查床

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械用具领域，具体来说是一种新型 CT 检查床。

### 背景技术

[0002] 目前，医生为患者做 CT 检查时，所用检查床没有用来固定患者的束缚带，同时检查床上的侧板一般都不能移动，不能根据患者的实际身体宽度进行相应的调整，以更好的固定患者的位置，这些对不配合检查的儿童患者来说很重要。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对上述技术不足，提供一种新型 CT 检查床。

[0004] 本实用新型解决技术问题所采用的技术方案是：新型 CT 检查床，包括床板、床腿和滑轮，所述床板上设有头部固定枕，所述床板上设有两个侧挡板，同时沿床板宽度方向上设有两个滑动槽，所述两个侧挡板沿滑动槽来回移动，所述床板上还设有固定带。

[0005] 本实用新型所能带来的有益效果是：检查床上两个侧挡板之间间距的可调性以及固定带的设计，使得本实用新型能根据患者的实际身体宽度进行相应的调整、固定患者的位置，以更好、更快的对那些不配合的儿童患者进行检查。

### 附图说明

[0006] 图 1、本实用新型主视图。

[0007] 图 2、本实用新型俯视图。

[0008] 图 3、本实用新型左视图。

### 具体实施方式

[0009] 下面结合附图，对本实用新型做以下详细说明：

[0010] 如图 1、图 2 和图 3 所示，本实用新型公开了一种新型 CT 检查床，包括床板 1、床腿 2 和滑轮 3，所述床板 1 上设有头部固定枕 4，所述床板 1 上设有两个侧挡板 5，同时沿床板 1 宽度方向上设有两个滑动槽 6，所述两个侧挡板 5 沿滑动槽 6 来回移动，所述床板 1 上还设有固定带 7。本实用新型中检查床上两个侧挡板 5 之间间距的可调性以及固定带 7 的设计，使得本实用新型能根据患者的实际身体宽度进行相应的调整、固定患者的位置，以更好、更快的对那些不配合的儿童患者进行检查。

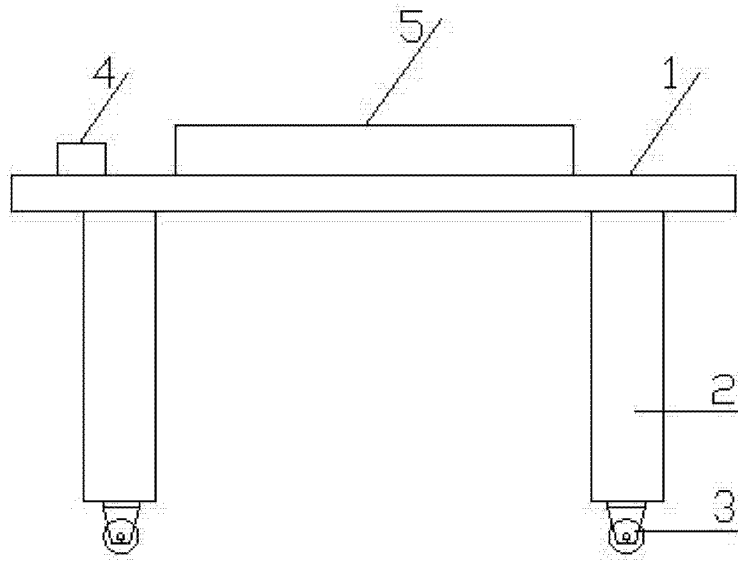


图 1

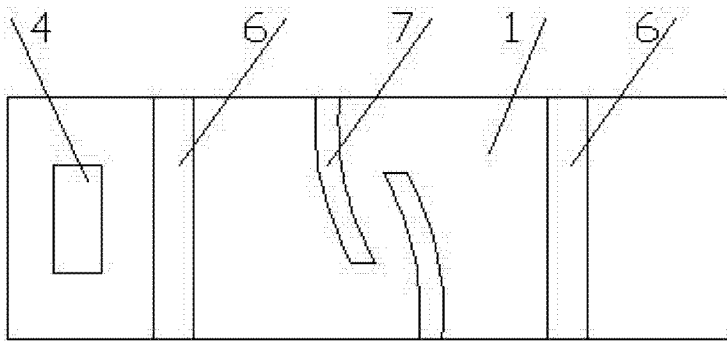


图 2

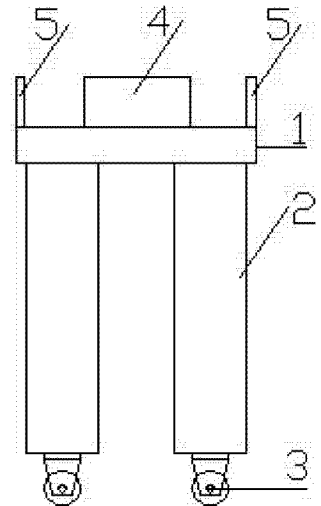


图 3