

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6719**

(21) Numer zgłoszenia: **4499**

(22) Data zgłoszenia: **17.11.2003**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Lampa zabiegowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego
FAMED S.A., Żywiec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Wójcik Jerzy, Żywiec, (PL);
Witas Andrzej, Sopotnia Wielka, (PL)**

PL 6719

Nr Rp. 6719

Klasa 26-05

**Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A.
Żywiec, Rzeczpospolita Polska**

Lampa zabiegowa

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 17 listopada 2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa zabiegowa składająca się z jednej jednostki oświetleniowej w postaci halogenowego źródła światła zabudowanego w szczelnej obudowie z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać lampy zabiegowej, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Lampa zabiegowa, według wzoru przemysłowego, składa się z jednej jednostki oświetleniowej w postaci halogenowego źródła światła, zabudowanego w zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego, charakteryzuje się tym, że jej obudowa ma kształt półsferycznej kopuły utworzonej ze środkowej półkuli opasanej wzdłuż jej średnicy przez półłukową opaskę, rozszerzoną na obu jego końcach w obrębie

płaskiej, czołowej powierzchni na kształt litery „V”, przy czym czołowa powierzchnia ma wgłębioną do wewnątrz okrągłą szybę, gdzie do jednego końca opaski zamocowany jest prostopadły do niej cylindryczny uchwyt o ryflowanej powierzchni, utworzonej z równoległych do siebie półokrągłych, wypukłych żeber i półokrągłych wklęsłych rowków, a do bocznej powierzchni końca opaski zamocowany jest cylindryczny przegub łączący się z ćwierćlukowym pałakiem wyposażonym na drugim końcu w cylindryczny przegub.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono lampę zabiegową w widoku aksonometrycznym od strony jednego boku, fig. 2 – przedstawiono lampę zabiegową w widoku aksonometrycznym od strony drugiego boku, a na fig. 3 – przedstawiono lampę zabiegową w widoku aksonometrycznym z góry.

Jak pokazano na rysunku lampa zabiegowa składa się z jednej jednostki oświetleniowej w postaci halogenowego źródła światła, zabudowanego w zamkniętej obudowie 1 z tworzywa sztucznego. Obudowa 1 ma kształt półsferycznej kopuły utworzonej ze środkowej półkuli 2 opasanej wzdłuż jej średnicy przez półlukową opaskę 3, rozszerzoną na obu jej końcach 4 i 5 w obrębie płaskiej, czołowej powierzchni 6 na kształt litery „V”. Czołowa powierzchnia 6 ma wgłębioną do wewnątrz okrągłą szybę 7. Do jednego końca 4 opaski 3 zamocowany jest prostopadły do niej cylindryczny uchwyt 8 o ryflowanej powierzchni utworzonej z równoległych do siebie z półokrągłych, wypukłych żeber 9 i półokrągłych wklęsłych rowków 10, a do bocznej powierzchni końca 4 opaski 3 zamocowany jest

cylindryczny przegub 11 łączący się z ćwierćlukowym pałąkiem 12 wyposażonym na drugim końcu w cylindryczny przegub 13 stanowiący uchwyt do zawieszenia lampy.

Regulacja wielkości pola świetlnego, polegająca na ogniskowaniu odbywa się w za pomocą uchwytu 8, który jest też łatwo demontowalny dla ułatwienia procesu jego sterylizacji.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Lampa zabiegowa składająca się z jednej jednostki oświetleniowej w postaci halogenowego źródła światła, zabudowanego w zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego, **charakteryzuje się tym**, że jej obudowa (1) ma kształt półsferycznej kopuły utworzonej ze środkowej półkuli (2) opasanej wzdłuż jej średnicy przez półlukową opaskę (3), rozszerzoną na obu jej końcach (4) i (5) w obrębie płaskiej, czołowej powierzchni (6) na kształt litery „V”, przy czym czołowa powierzchnia (6) ma wgłębioną do wewnątrz okragłą szybę (7), gdzie do jednego końca (4) opaski (3) zamocowany jest prostopadły do niej cylindryczny uchwyt (8) o ryflowanej powierzchni utworzonej z równoległych do siebie z półokrągłych, wypukłych żeber (9) i półokrągłych wklęsłych rowków (10), a do bocznej powierzchni końca (4) opaski (3) zamocowany jest cylindryczny przegub (11) łączący się z ćwierćlukowym pałąkiem (12) wyposażonym na drugim końcu w cylindryczny przegub (13), jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego

FAMED S.A.

Żywiec

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel

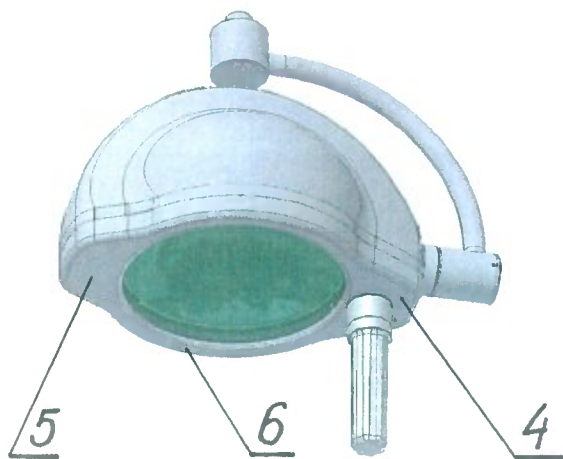


Fig. 1

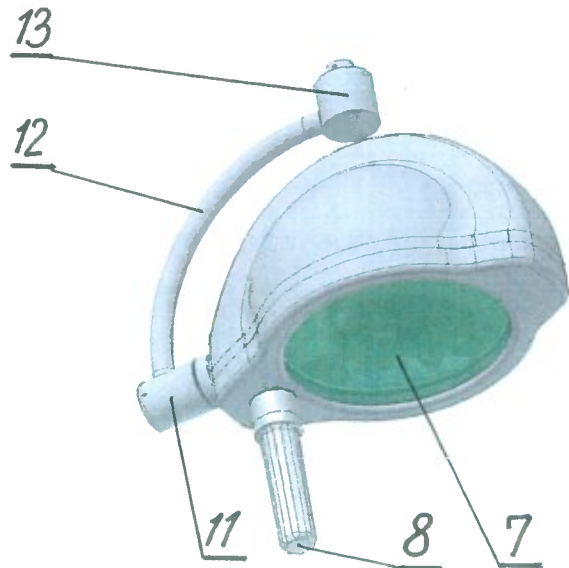


Fig. 2

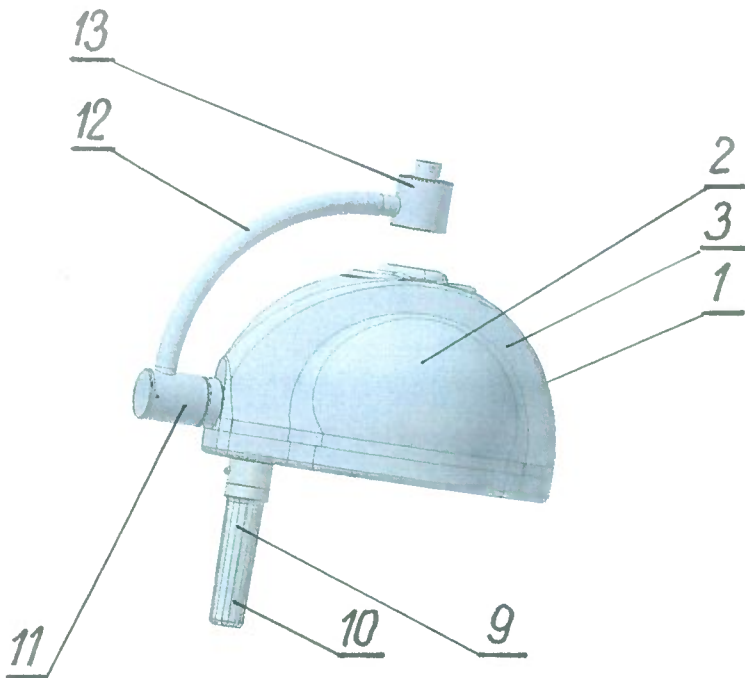


Fig. 3

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego

FAMED S.A.

Żywiec

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel

AR KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. Andrzej Rygiel
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 25B - Tel./Fax (33) 812-62-05
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40
REGON: 070375895 NIP: 547-106-10-36