



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205215522 U

(45) 授权公告日 2016. 05. 11

(21) 申请号 201520392872. 7

(22) 申请日 2015. 06. 09

(73) 专利权人 宁夏医科大学总医院

地址 750004 宁夏回族自治区银川市胜利南街 804 号

(72) 发明人 郭淑萍 高学琴 马富珍 张竹英

(74) 专利代理机构 宁夏专利服务中心 64100

代理人 张尚星

(51) Int. Cl.

A61F 13/14(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种心脏术后弹性胸带

(57) 摘要

本实用新型提供一种心脏术后弹性胸带,包括由纯棉布料制作而成的长方形胸带本体、由弹力松紧带制作而成的长方形肩带和固定带;长方形胸带本体对应两肩的部位设有2条肩带,两侧各缝制有4条固定带;固定带的两端设置有可相互粘和的固定带母扣和固定带子扣;肩带的末端设有用于与设在固定带上相应部位的粘扣相配合的肩带粘扣。本实用新型的心脏术后弹性胸带,可根据患者体型及胸围直接调整松紧度,有效固定患者胸部伤口,易于观察伤口及各种管路,且更换方便,减少了护理工作量,棉质的弹性材料柔软透气,增加患者舒适度,有利于患者术后早期功能恢复。

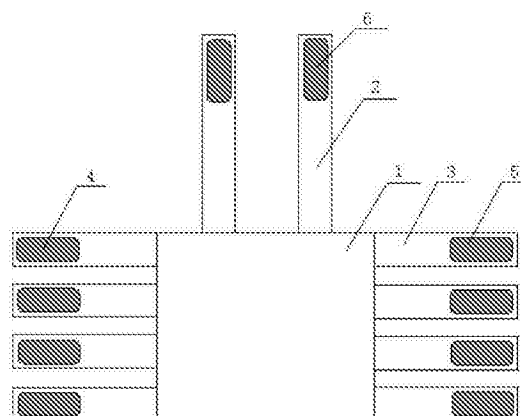

1. 一种心脏术后弹性胸带,其特征是:包括由纯棉布料制作而成的长方形胸带本体(1)、由弹力松紧带制作而成的长方形肩带(2)和固定带(3);所述长方形胸带本体(1)对应两肩的部位设有2条肩带(2),两侧各缝制有4条固定带(3);所述固定带(3)的两端设置有可相互粘和的固定带母扣(4)和固定带子扣(5);所述肩带(2)的末端设有用于与设在固定带(3)上相应部位的粘扣相配合的肩带粘扣(6)。

2. 按照权利要求1所述的心脏术后弹性胸带,其特征是:所述相邻固定带(3)中间有2cm的间隙。

3. 按照权利要求1所述的心脏术后弹性胸带,其特征是:所述心脏术后弹性胸带的胸带本体(1)长度为40cm,宽度为34cm,肩带(2)长度为40cm,宽度为7cm,固定带(3)宽度为7cm。

4. 按照权利要求1或2或3所述的心脏术后弹性胸带,其特征是:所述心脏术后弹性胸带分为大、中、小3个型号,大号心脏术后弹性胸带的固定带(3)长度为40cm,中号心脏术后弹性胸带的固定带(3)长度为30cm,小号心脏术后弹性胸带的固定带(3)长度为20cm。

一种心脏术后弹性胸带

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗护理器械的技术领域,具体涉及一种心脏术后弹性胸带。

背景技术

[0002] 心脏术后伤口大,术后常采用胸带来保护伤口,以减轻伤口张力,防止胸骨裂开,减轻疼痛。而且有助于患者进行有效的咳嗽来震动肺部,促进肺的复张,预防肺部感染。目前临床普遍采用传统胸带以达到对伤口固定和保护的作用。传统的胸带常采用棉布多头带,在临床使用中发现这种胸带存在以下不足:1、无弹性,长度固定限制了胸式呼吸,患者有压迫感和呼吸窘迫感。2、不便于观察局部伤口和引流管的情况,易造成引流管打折,引流不畅等。3、容易松开、脱落,固定效果不佳而且不美观,无法持续恒定加压,频繁地为患者调整胸带的松紧度增加了护士的工作量。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术中的缺陷,提供能妥善固定和保护胸部伤口的一种心脏术后弹性胸带。

[0004] 为实现上述实用新型目的所采取的技术方案为:

[0005] 一种心脏术后弹性胸带,包括由纯棉布料制作而成的长方形胸带本体、由弹力松紧带制作而成的长方形肩带和固定带;所述长方形胸带本体对应两肩的部位设有2条肩带,两侧各缝制有4条固定带;所述固定带的两端设置有可相互粘和的固定带母扣和固定带子扣;所述肩带的末端设有用于与设在固定带上相应部位的粘扣相配合的肩带粘扣;

[0006] 所述相邻固定带中间有2cm的间隙;

[0007] 所述心脏术后弹性胸带的胸带本体长度为40cm,宽度为34cm,肩带长度为40cm,宽度为7cm,固定带宽度为7cm;

[0008] 所述心脏术后弹性胸带分为大、中、小3个型号,大号心脏术后弹性胸带的固定带长度为40cm,中号心脏术后弹性胸带的固定带长度为30cm,小号心脏术后弹性胸带的固定带长度为20cm。

[0009] 本实用新型的胸带具有以下特点:

[0010] 1.采用有弹性的棉质材料制作,且分为大、中、小3个型号,可根据患者体型及胸围直接调整松紧度,完全满足不同体型患者的需求;

[0011] 2.设计新颖、科学,具有的弹性空间不影响呼吸和各种引流管的引流效果,同时方便观察引流管,加压恒定,不易松开,有效的固定胸部伤口,提高了医疗护理质量;

[0012] 3.能有效的观察和保护伤口,不影响电极片的粘贴及监护效果,缓解疼痛,患者感觉舒适有利于术后早期功能恢复,有效的预防伤口裂开给病人造成的创伤及经济负担。

[0013] 4.选择纯棉布制作,制作简单,成本低,使用方便,增加了术后患者舒适度,柔软、透气、美观舒适,易于拆洗消毒,提高了工作效率。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种心脏术后弹性胸带的结构示意图简图;附图中:1——胸带本体;2——肩带;3——固定带;4——固定带母扣;5——固定带子扣;6——肩带粘扣。

具体实施方式

[0015] 本实用新型的一种心脏术后弹性胸带,包括由纯棉布料制作而成的长方形胸带本体1、由弹力松紧带制作而成的长方形肩带2和固定带3;长方形胸带本体1对应两肩的部位设有2条肩带2,两侧各缝制有4条固定带3;固定带3的两端设置有可相互粘和的固定带母扣4和固定带子扣5,相邻固定带3中间有2cm的间隙,这样有利于将引流管口位置留开,可以有效观察引流管有无脱出、管口有无渗液及周围皮肤情况,观察引流液,同时可以有效的避开粘贴电极片的位置,便于监护和观察伤口情况。肩带2的末端设有用于与设在上部两条固定带3上相应部位的粘扣相配合的肩带粘扣6。

[0016] 本实用新型的一种心脏术后弹性胸带,胸带本体1长度为40cm,宽度为34cm,肩带2长度为40cm,宽度为7cm,固定带3宽度为7cm。为了进一步满足不同体型患者的需求,本实用新型的心脏术后弹性胸带设计为大、中、小3个型号,大号心脏术后弹性胸带的固定带3长度为40cm,中号心脏术后弹性胸带的固定带3长度为30cm,小号心脏术后弹性胸带的固定带3长度为20cm。

[0017] 可根据患者体型及胸围选择对应型号的胸带,使用时,将长方形的胸带本体1至于患者背部,两侧的固定带3拉好粘扣固定于前胸,以不影响患者呼吸,舒适为主,然后下拉肩带2使肩带粘扣6粘和在与之相配合的上部两条固定带3上相应粘扣上,即可固定。本实用新型使用起来极其方便,不仅有效的固定胸骨,预防刀口哆开及胸骨错位,减轻伤口疼痛,而且方便观察伤口及各种引流管,同时方便监测生命体征。

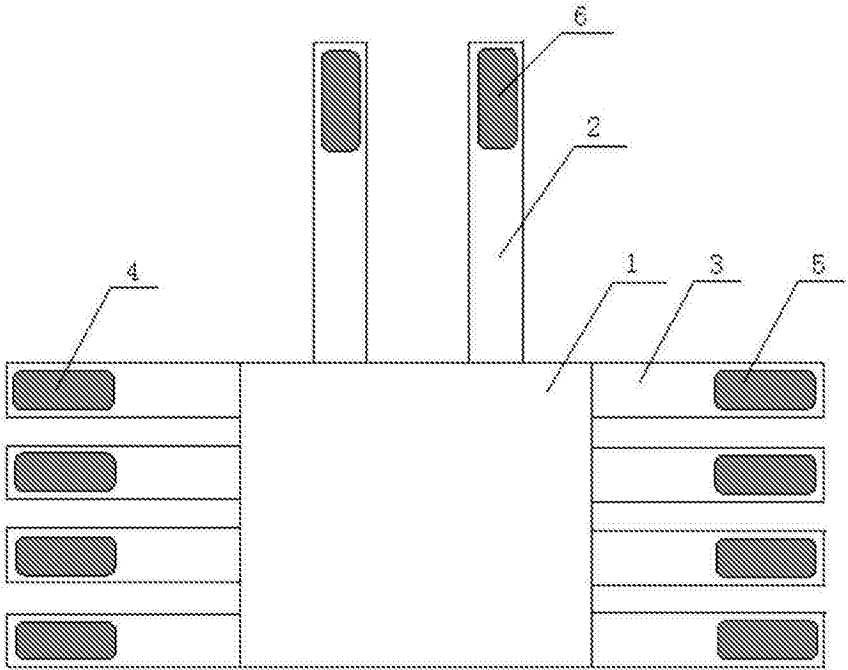


图1