



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2004129421/14, 07.10.2004

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
07.10.2004

(43) Дата публикации заявки: 20.03.2006

(45) Опубликовано: 10.11.2007 Бюл. № 31

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2085222 C1, 27.07.1997. RU 2029573 C1, 27.02.1995. RU 33016 U1, 06.12.2002. ГРИГОРЬЕВ Ю.Г. и др. Персональный компьютер - физические факторы, воздействие на пользователя. - Кремлевская медицина. Клинический вестник, 2001, № 4, с.35-39. Основные понятия теории фракталов, 18.01.2006 [он-лайн] [Найдено 2006.03.27] найдено из Интернет (см. прод.)

Адрес для переписки:

121471, Москва, ул. Гвардейская, 17, корп.2,
кв.23, Ю.И.Белякову

(72) Автор(ы):

Беляков Юрий Иванович (RU),
Ровенский Олег Александрович (RU)


(73) Патентообладатель(и):

Беляков Юрий Иванович (RU)

(54) СПОСОБ БИОКОРРЕКЦИИ ОРГАНИЗМА

(57) Реферат:

Изобретение относится к физиотерапии и предназначено для воздействия на организм постоянным и/или пульсирующим одним или несколькими потоками электронов. На организм воздействуют потоком электронов в виде тока утечки. Перед подачей в организм их подвергают воздействию пульсирующего электростатического и/или электромагнитного поля, пульсирующего с частотой от 0,001 до 500×10^3 Гц. Предлагаемое изобретение позволяет стабилизировать здоровье живого организма, способствует регенерации и повышению жизнестойкости клеточных структур. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

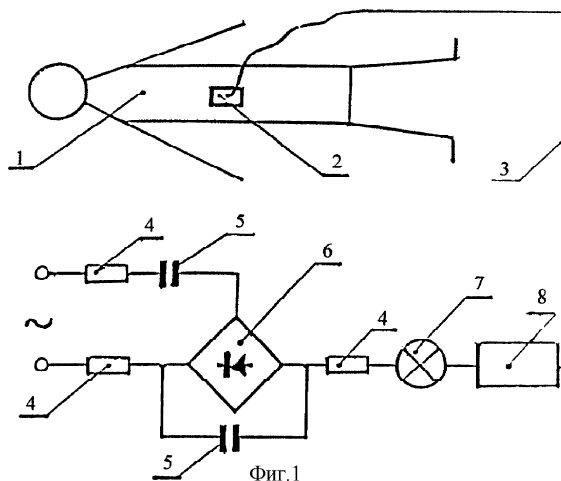

(56) (продолжение):

<http://multifractal.narod.ru/2vocabulary/2vocabulary.htm>. СЕРОВ И.Н. Проект Экологический конвектор «Айрес». Фонд развития новых медицинских технологий «Айрес», 2006, с.2. КАРЕВ В.М. Краткая российская энциклопедия. БРЭ, 2004, т.2, с.958. ПОЛИЩУК Р. и др. Патентная экспертиза заявок, не основанных на научных знаниях. Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность, №3, 2002, с.40-59. БЯЛКО А.В. Торсионные мифы. Природа, 1998, 39, с.3-7, протокол измерения сопротивлений меди, обработанных т.н. торсионным генератором. ПОКРОВСКИЙ В.И. Энциклопедический словарь медицинских

RU 2309779 C2

RU 2309779 C2



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: **2004129421/14**, 07.10.2004

(24) Effective date for property rights: **07.10.2004**

(43) Application published: **20.03.2006**

(45) Date of publication: **10.11.2007 Bull. 31**

Mail address:

**121471, Moskva, ul. Gvardejskaja, 17, korp.2,
kv.23, Ju.I.Beljakovu**

(72) Inventor(s):

**Beljakov Jurij Ivanovich (RU),
Rovenskiy Oleg Aleksandrovich (RU)**

(73) Proprietor(s):

Beljakov Jurij Ivanovich (RU)

(54) METHOD FOR CARRYING OUT ORGANISM BIOCORRECTION


(57) Abstract:

FIELD: medicine.

SUBSTANCE: method involves treating organism with electron beam as leakage current. Before being delivered into the organism, the electrons are exposed to pulsating electrostatic or electromagnetic field pulsating with frequency of $0.001-500 \times 10^3$ Hz.

EFFECT: stabilized living organism health; stimulating recovery and increased viability of cellular structures.

3 cl, 2 dwg

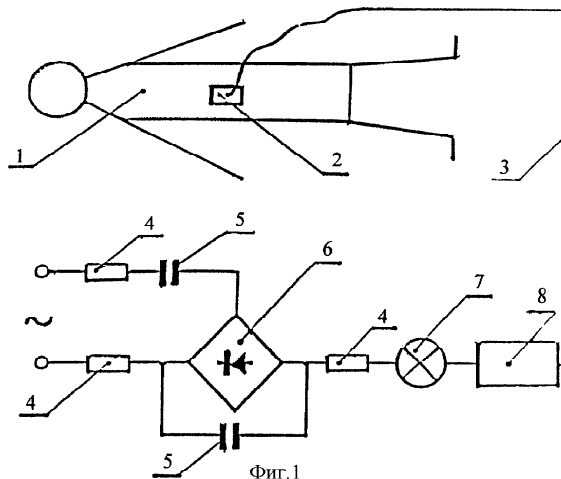

Изобретение относится к области медицины, в частности к физиотерапии, может также применяться для сельскохозяйственных животных, пушных и домашних животных и растений.

Известны способы лечения с применением электромагнитных излучений [1], которые позволяют лечить многие заболевания, но имеют также значительные противопоказания, например пароксизмальные нарушения сердечного ритма, язвенная болезнь желудка со стенозом и опасностью кровотечения и др., и не обеспечивают достаточную нейтрализацию свободных радикалов.

Известны различные способы лечения человека воздействием фрактальными матрицами (аппликаторами) [2].

Способы позволяют лечить многие заболевания, но не эффективны для нейтрализации свободных радикалов в организме.

Наиболее близким по назначению является способ (прототип) лечения [3, 4], по которому пациента бесконтактно размещают под положительно заряженный электрод в зону сильного электростатического поля и прикладывают к его телу отрицательно заряженный электрод. Способ позволяет снижать кислотность тканей, нейтрализовать свободные радикалы. Однако он не позволяет осуществлять универсальную коррекцию обменных взаимосвязей организма.

В изобретении «Способ биокоррекции организма» ставится задача усилить эффективность лечения и стабилизировать здоровье живого организма, в том числе нейтрализовать токсины, способствовать выводу токсинов, регенерации и повышению жизнестойкости клеточных структур. Решение поставленной задачи достигается тем, что в живой организм подают электроны в виде тока утечки, на которые воздействуют устройством, регулирующим пульсацию тока утечки в пределах от 0,001 до 500×10^3 Гц. При этом организм рассматривается как чисто волновая макроструктура, образовавшаяся за счет взаимодействия субволновых структур образующих ее атомов. На волновую структуру можно эффективно воздействовать, если воспользоваться явлением резонанса с такой же волновой структурой, подобрав для этого соответствующий волновой объект. В данном случае используются: в качестве физического объекта электрон, имеющий сложную волновую структуру, и поток электронов в виде тока утечки.

Электроны и пульсирующий поток электронов в организме существенно корректируют в положительную сторону искажения обменных связей и устраняют окислительный стресс, кислотность тканей, мутацию и гибель клеток [1, 5].

Пример 1, фиг.1.

Пациента 1 с диагнозом артериосклероз, вегетососудистая дистония по гипотоническому типу укладывают на кушетку или усаживают на стул (ноги располагают на электроизоляционном коврике), затем на обнаженную поверхность тела пациента 1 накладывают один или несколько плоских латунных электродов 2 аппарата «Биэнерджи (ЭЛВИТА)» (на фиг.1 условно показан 1 электрод), принципиальная электрическая схема которого представлена на фиг.1.

Аппарат включают в электросеть переменного тока (220 В, 50 Гц), и электроны через сопротивления 4, диоды 6, соединенные с конденсаторами 5, поступают в модулятор 8, который представляет из себя устройство, регулирующее пульсацию тока утечки в пределах от 0,001 до 500×10^3 Гц. Электроны, подвергшиеся воздействию модулятора 8, через электропровод 3 и электрод 2 поступают в организм пациента 1. По истечении 5-120 минут аппарат выключается, процедура закончена.

Пример 2, фиг.1.

То же, что и по примеру 1, но используют не плоский, а точечный электрод, которым воздействуют на точки Фолля по меридианам: дегенерация сосудов, дегенерация нервов, сердце, кровообращение, эндокринная система и др. Длительность процедур от 10 до 90 минут.

Пример 3, фиг.1.

Пациента, подвергшегося ионизирующему излучению, подвергают воздействию так же,

как и в примере I, но над пациентом бесконтактно размещают один или несколько положительно заряженных электродов от 5 до 150 кВ. Длительность процедуры до 45 минут.

Пример 4, фиг.1.

5 То же, что и в примерах 1, 2 и 3, но воздействуют на пациента электродом, в который встроен модулятор.

Пример 5, фиг.2.

10 Пациента 1 размещают в бароциклоне 9. В нем сажают его на стул 10 и оголенные подошвы ног устанавливают на электрод 2 с встроенным модулятором 8 аппарата «ЭЛВИТА», затем в бароциклоне 9 изменяют давление воздуха в пульсирующем режиме с частотой от 0 до 20 кГц в пределах от -15 мм рт.ст. до +15 мм рт.ст. и одновременно и/или попеременно подают в организм электроны. Длительность процедуры от 1 до 45 минут.

Пример 6.

15 То же, что и в примерах 1, 2, 3, 4, 5, но на пациента подают пульсирующий поток электронов в диапазоне биорезонансных частот живых организмов, в том числе микробов, вирусов, грибов и др. Пульсацию осуществляют с помощью аппаратов «ДЭТА» или «Мини-Эксперт-ДТ», встроенных в устройство подачи электронов в организм.

Пример 7.

20 То же, что и в примерах 1, 2, 3, 4, 5, но дополнительно на пациента воздействуют постоянным или пульсирующим светом различного цвета.

Литература.


1. Боголюбов В.М., Понаморенко Г.Н. «Общая физиотерапия». АООТ «Фабрика детской книги», С-Петербург, 1997 г.
- 25 2. Рыбина Л., Серов И. «Аналитическое программирование информационно-обменных процессов активных биологических форм». ФРМНТ «АЙРЕС», С-Петербург, 2001 г.
3. Фомин М.И. «Интегральная медицина». Гефест, С-Петербург. 1996 г.
4. Фомин М.И. Патент № 2025142, «Способ профилактики и лечения лучевой болезни», 1993 г. Бюлл. №24 от 30.12.94 г.
- 30 5. Владимиров Ю.А., Азизов О.А. и др. «Свободные радикалы в живых системах». Итоги науки и техники. Биофизика, Т.29, с.3-250. 1992 г.

Формула изобретения

35 1. Способ физиотерапии воздействием на организм постоянным и/или пульсирующим одним или несколькими потоками электронов, отличающийся тем, что на организм воздействуют потоком электронов в виде тока утечки, при этом перед подачей в организм их подвергают воздействию пульсирующего электростатического и/или электромагнитного поля пульсирующего с частотой от 0,001 до $500 \cdot 10^3$ Гц.

40 2. Способ по п.1, включающий подачу на организм электронов, отличающийся тем, что одновременно с подачей электронов на организм воздействуют постоянным или пульсирующим потоком света разных цветов.

3. Способ по пп.1 и 2, включающий воздействие на организм электронов, отличающийся тем, что их воздействие осуществляют в бароциклоне, при этом в бароциклоне давление воздуха изменяют в пределах от ± 15 мм рт.ст. с частотой от 0,001 до $500 \cdot 10^3$ Гц.

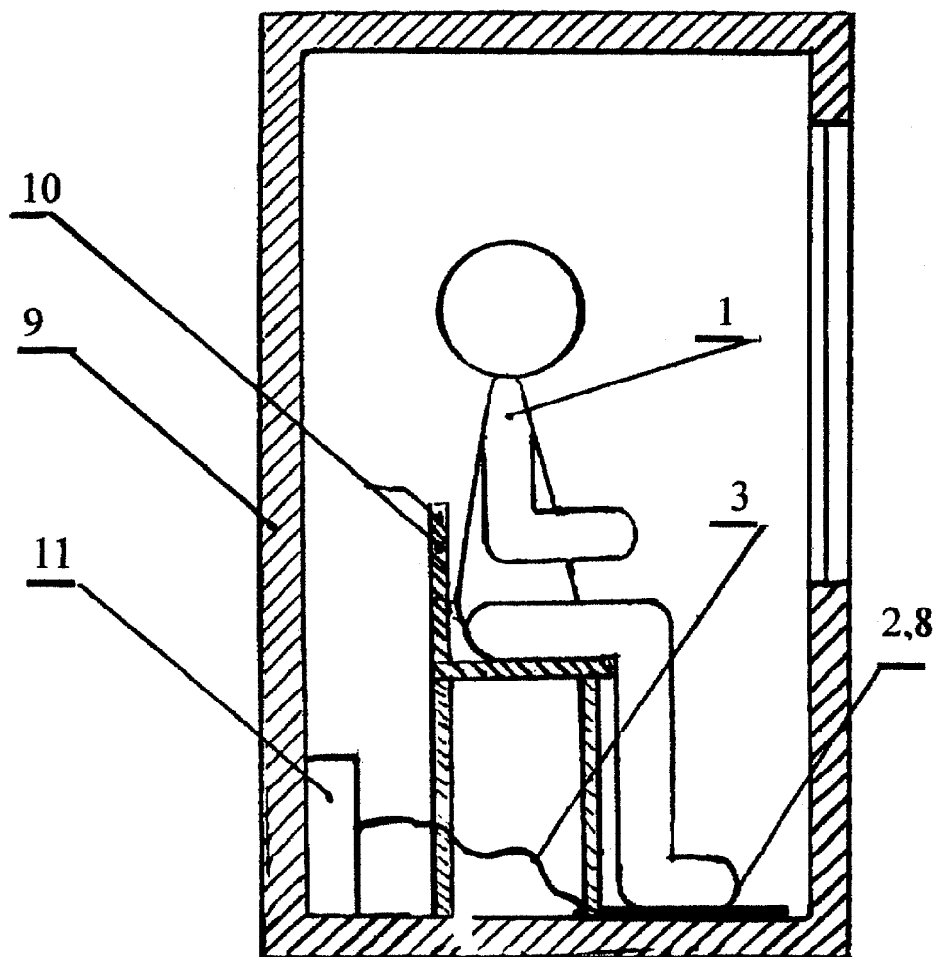

Фиг.2