

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2992**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **104**

(22) Data zgłoszenia: **13.09.2001**

(54)

Meble szpitalne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego
FAMED S.A., Żywiec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Zoń Paweł, Czernichów, (PL);
Konior Edward, Świnna, (PL);
Oleksiak Aleksander, Kocierz Rych., (PL);
Skrzyp Stanisław, Sopotnia Wielka, (PL);
Bysko Sławomir, Radziechowy, (PL);
Tomasik Mariusz, Żywiec, (PL)**

**Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED SA
Żywiec, Rzeczpospolita Polska**

Twórcy wzoru zdobniczego: **Zoń Paweł,
Konior Edward,
Oleksiak Aleksander,
Skrzyp Stanisław,
Bysko Sławomir,
Tomasik Mariusz**

Meble szpitalne

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **13 września 2001 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego są meble szpitalne złożone z asystora, szafki z szufladami oraz szafki z szufladami i drzwiami.

Istotę wzoru stanowi nowa postać mebli szpitalnych, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w kształcie ich szuflad, uchwytów oraz wykończenia kolorystycznego.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na fig. 1 – gdzie przedstawiono na rysunku asystor w widoku z przodu, fig. 2 – gdzie przedstawiono na

rysunku asystora w widoku z boku, fig. 3 – gdzie przedstawiono na rysunku podstawę asystora w widoku z boku, fig. 4 – gdzie przedstawiono na rysunku podstawę asystora w widoku z góry, fig. 5 – gdzie przedstawiono na rysunku w widoku z góry z częściowym przekrojem przez uchwyt blat asystora, fig. 6 – gdzie przedstawiono na rysunku w widoku i przekroju od czoła blat asystora, fig. 7 – gdzie przedstawiono na rysunku w widoku i przekroju z boku blat asystora, fig. 8 – gdzie przedstawiono na fotografii w widoku aksonometrycznym z boku asystor z zasuniętymi szufladami, fig. 9 – gdzie przedstawiono na fotografii w widoku aksonometrycznym z góry asystor z wysuniętymi szufladami, fig. 10 – gdzie przedstawiono na fotografii w widoku z przodu asystor z zasuniętymi szufladami, fig. 11 – gdzie przedstawiono na fotografii w widoku aksonometrycznym z góry szufladę dla asystora, szafki z szufladami i szafki z szufladami i drzwiami, fig. 12 – gdzie przedstawiono na rysunku w widoku z przodu szafkę z szufladami, fig. 13 – gdzie przedstawiono na rysunku w widoku z boku szafkę z szufladami, fig. 14 – gdzie przedstawiono na fotografii w widoku aksonometrycznym z boku szafkę z zasuniętymi szufladami, fig. 15 – gdzie przedstawiono na fotografii w widoku aksonometrycznym z boku szafkę z otwartymi dwoma dolnymi szufladami, fig. 16 – gdzie przedstawiono na rysunku w widoku z przodu szafkę z szufladami i drzwiami, fig. 17 – gdzie przedstawiono na rysunku w widoku z boku szafkę z szufladami i drzwiami, na fig. 18 – przedstawiono na fotografii w widoku aksonometrycznym z boku szafkę z szufladami i drzwiami.

Jak pokazano na rysunku meble szpitalne złożone są z asystora, szafki z szufladami i szafki z szufladami i drzwiami. Asystor ma podstawę 1, która w widoku z boku ma kształt litery „L”, a w widoku z góry ma kształt litery „W” i zaopatrzona jest od góry w dwie szuflady 8 z łukowo ukształtowanymi uchwytami 2 znajdującymi się wewnątrz owalnego wgłębienia 3. Asystor od góry zaopatrzony jest w blat 4 wyposażony w łukowy uchwyt 5 i otoczony jest z trzech pozostałych stron przez pionowe ściany 6 zakończone łukowymi krawędziami 7. Szafka z szufladami ma pięć

szuflad 8 umieszczonych jedna nad drugą z łukowo ukształtowanymi uchwytami 2 znajdującymi się wewnątrz owalnego wgłębienia 3. Szafka z szufladami i drzwiami ma cztery szuflady 8 umieszczone w dwóch podwójnych rzędach i ma łukowo ukształtowane uchwyty 2 znajdujące się wewnątrz owalnego wgłębienia 3 oraz ma dwoje drzwi 9 o kształcie prostokąta, wewnątrz którego znajduje się wypukły, prostokątny obszar 10 zawierający owalne wgłębienie 11, gdzie drzwi 9 umieszczone są obok siebie i mają łukowo ukształtowane uchwyty 2.

Czołowa ściana szuflad 8, blatu 4 asystora i drzwiczek 9 jest wykonana w kolorze kontrastowym w stosunku do ścian bocznych asystora, szafki z szufladami i szafki z szufladami i drzwiami oraz do górnej powierzchni szafki z szufladami i szafki z szufladami i drzwiami.

Zastrzeżenia ochronne


1. Meble szpitalne złożone z asystora, szafki z szufladami i szafki z szufladami i drzwiami, **znamiennie tym**, że asystor ma podstawę (1), która w widoku z boku ma kształt litery „L”, a w widoku z góry ma kształt litery „W” i zaopatrzona jest od góry w dwie szuflady (8) z łukowo ukształtowanymi uchwytami (2) znajdującymi się wewnątrz owalnego wgłębienia (3) i gdzie asystor od góry zaopatrzony jest w blat (4) wyposażony w łukowy uchwyt (5) i otoczony jest z trzech pozostałych stron przez pionowe ściany (6) zakończone łukowymi krawędziami (7), przy czym szafka z szufladami ma pięć szuflad (8) umieszczonych jedna nad drugą z łukowo ukształtowanymi uchwytami (2) znajdującymi się wewnątrz owalnego wgłębienia (3), a szafka z szufladami i drzwiami ma cztery szuflady umieszczone w dwóch podwójnych rzędach z łukowo ukształtowanymi uchwytami (2) znajdującymi się wewnątrz owalnego wgłębienia (3) i dwojgiem drzwi (9) o kształcie prostokąta

wewnątrz którego znajduje się wypukły, prostokątny obszar (10) zawierający owalne wgłębienie (11), gdzie drzwi (9) umieszczone są obok siebie i mają łukowo ukształtowane uchwyty (2), jak pokazano na załączonym rysunku i fotografiach, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9, fig. 10, fig. 11, fig. 12, fig. 13, fig. 14, fig. 15, fig. 16, fig. 17 i fig. 18.

2. Meble szpitalne według zastrz. 1, znamienne tym, że czołowa ściana szuflad (8), blatu (4) asystora i drzwiczek (9) jest wykonana w kolorze kontrastowym w stosunku do ścian bocznych asystora, szafki z szufladami i szafki z szufladami i drzwiami oraz do górnej powierzchni szafki z szufladami i szafki z szufladami i drzwiami, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig. 8, fig. 9, fig. 10, fig. 11, fig. 14, fig. 15 i fig. 18.

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego
FAMED S.A.

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel

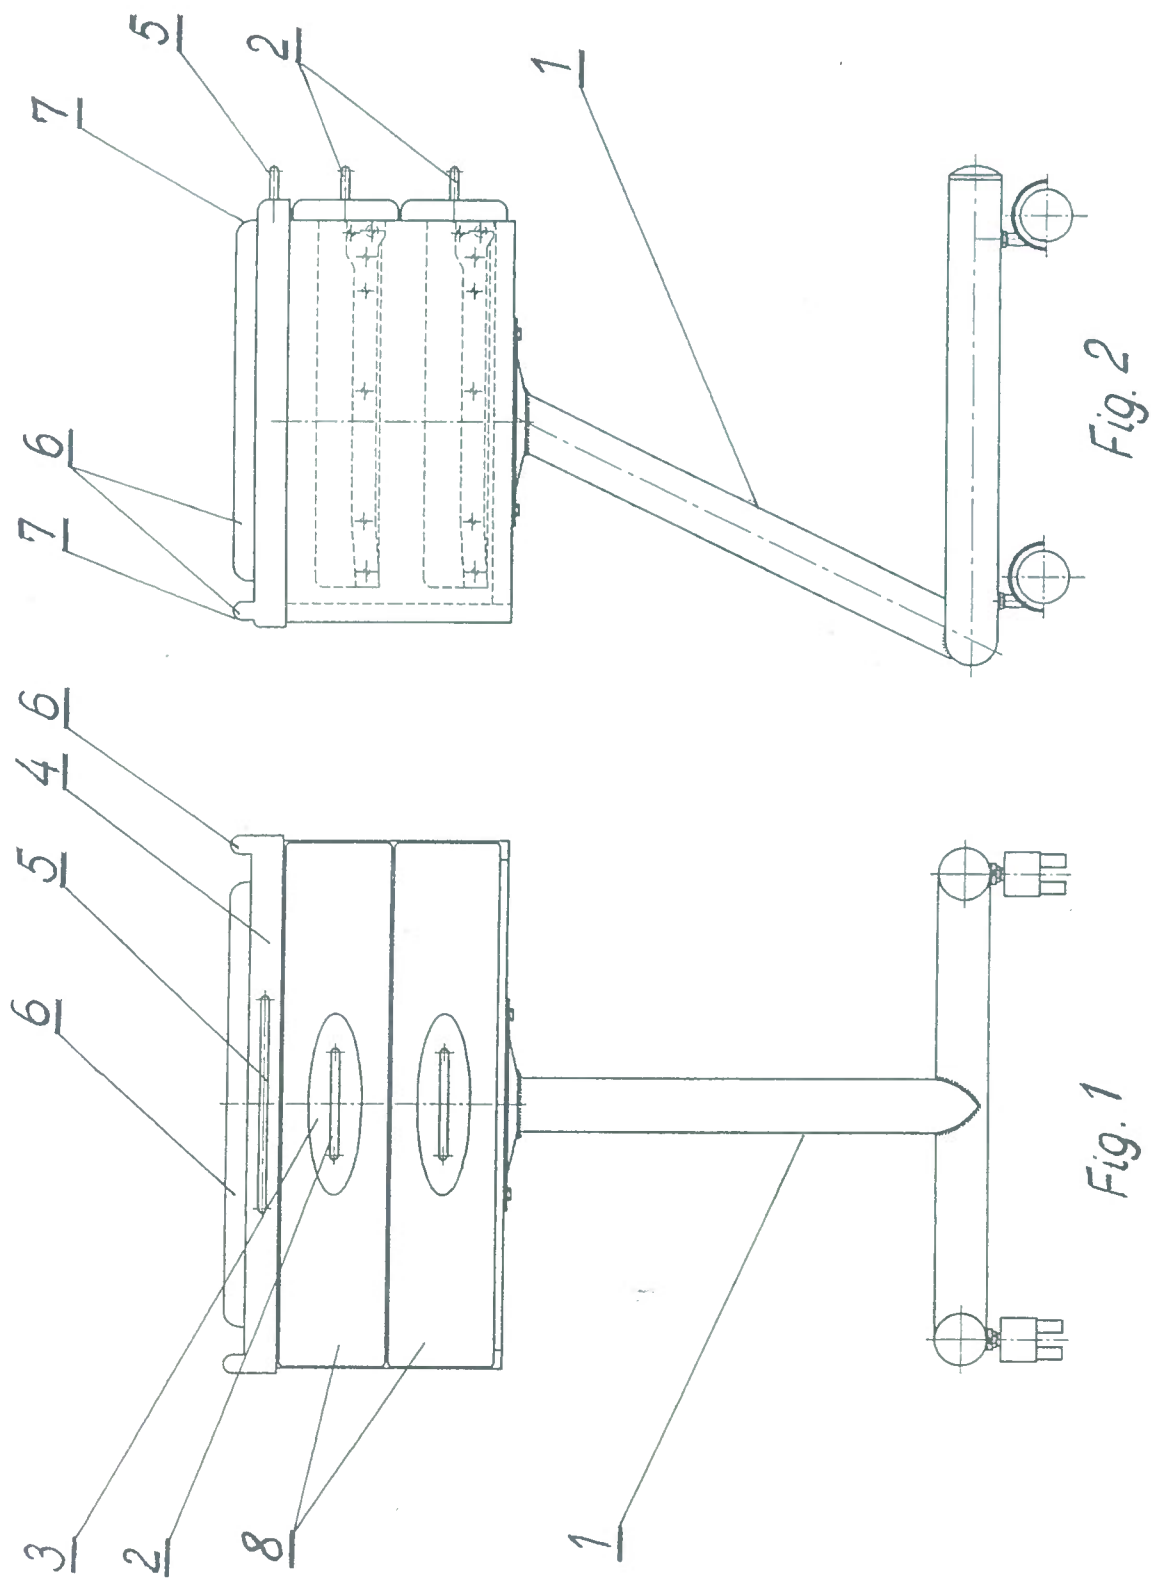

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego
FAMED S.A.

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Bygieł

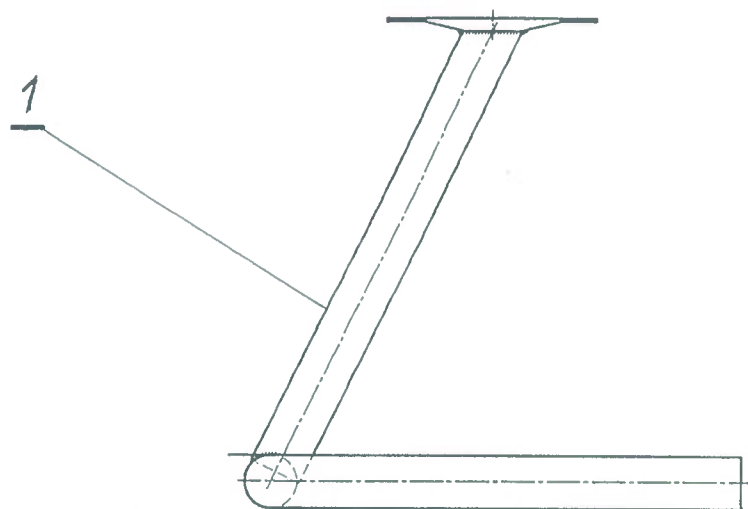


Fig. 3

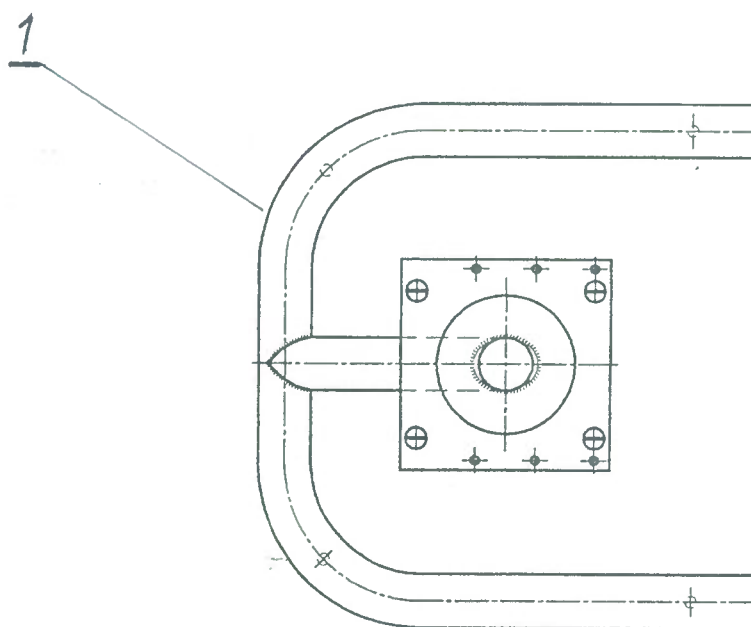


Fig. 4

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego
FAMED S.A.

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel

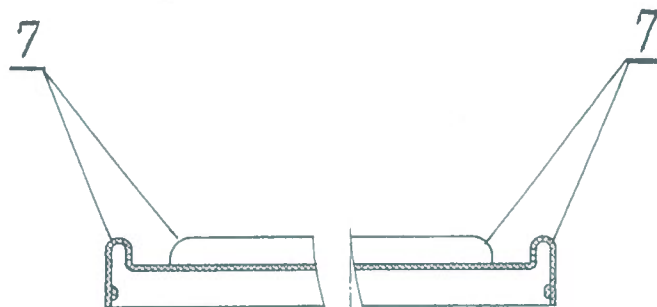


Fig. 6

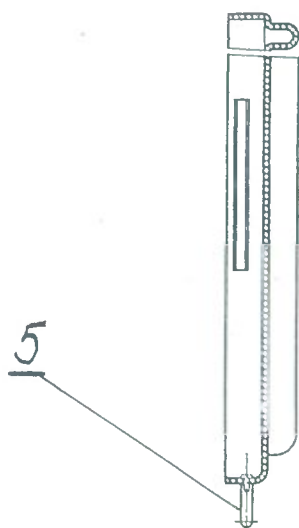


Fig. 7

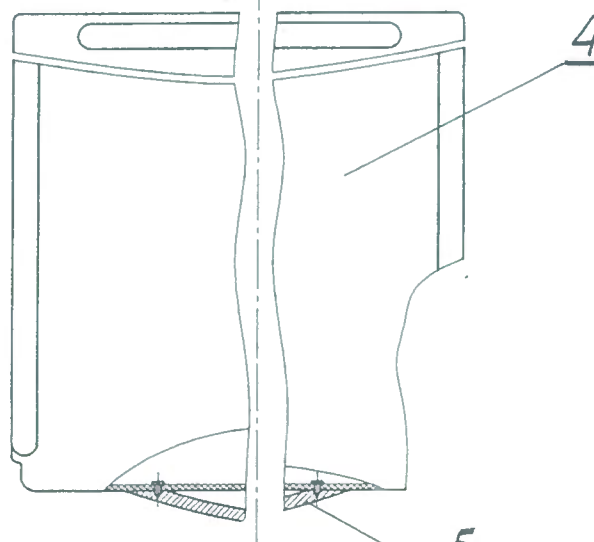


Fig. 5

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego
FAMED S.A.

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego
FAMED S.A.



Fig. 11

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel

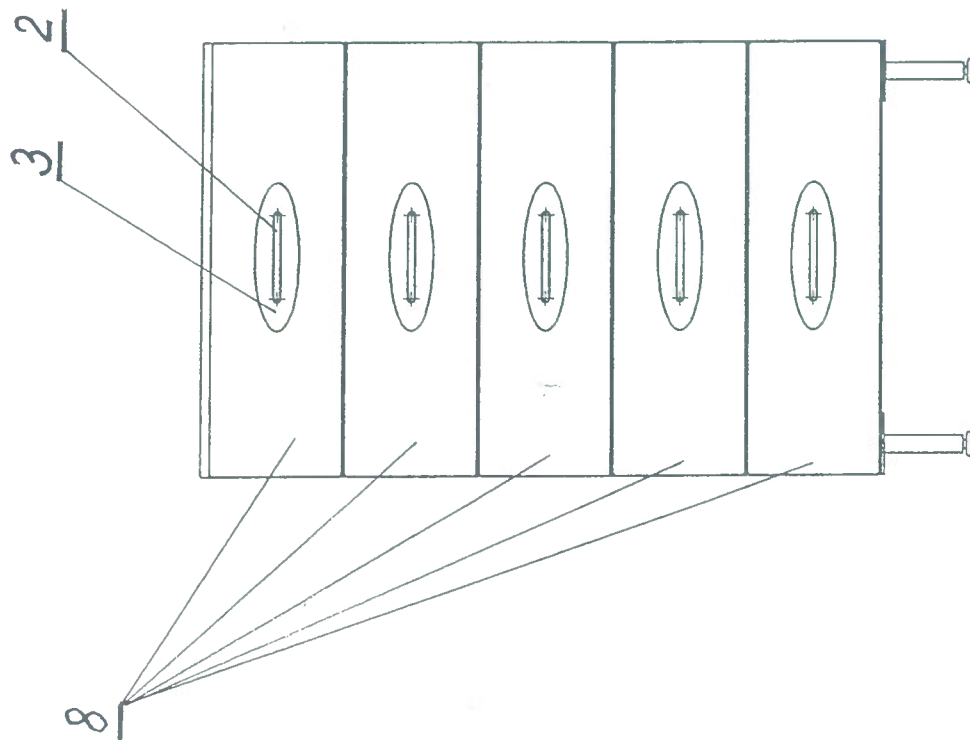


Fig. 12

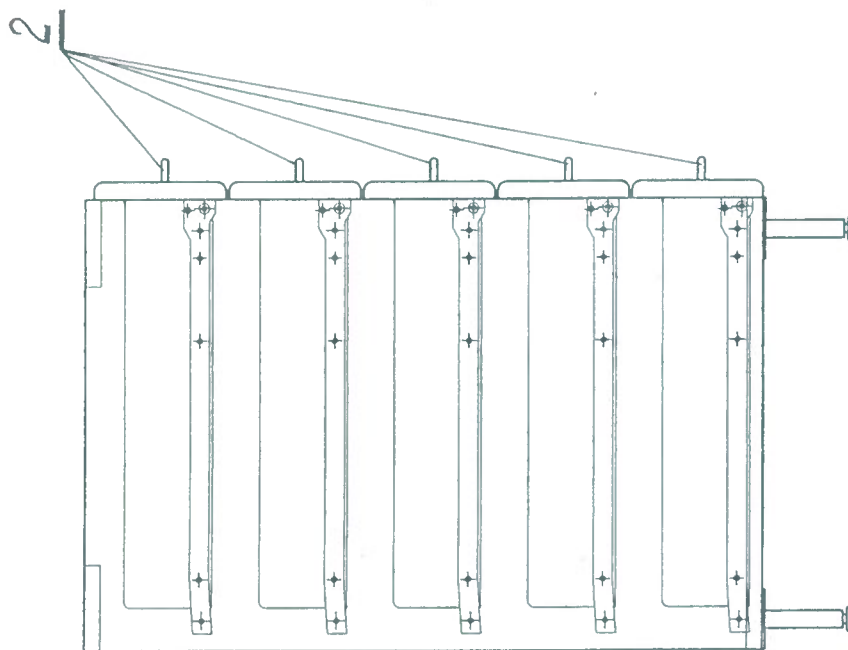


Fig. 13

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego
FAMED S.A.

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 18

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego
FAMED S.A.

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel

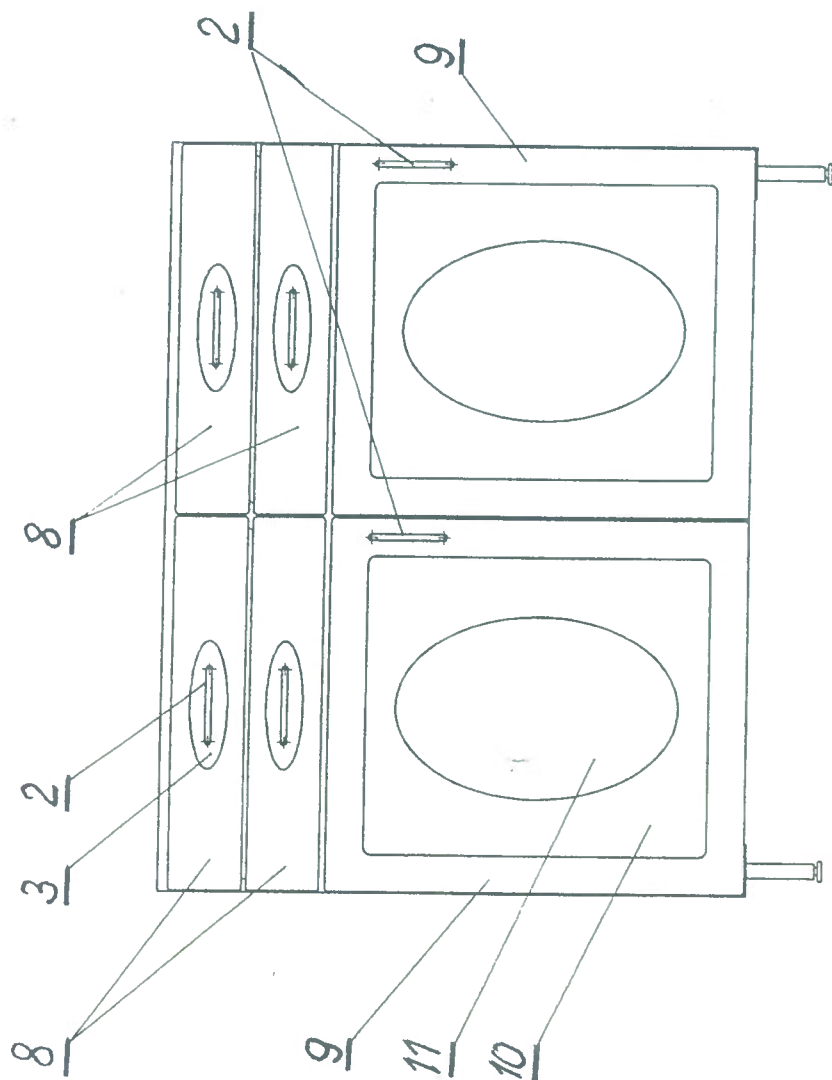


Fig. 16

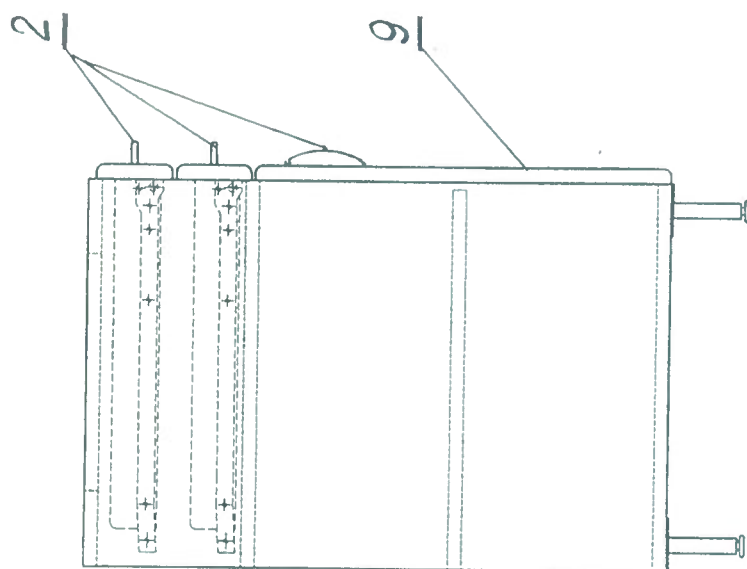


Fig. 17

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego
FAMED S.A.

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Bygier

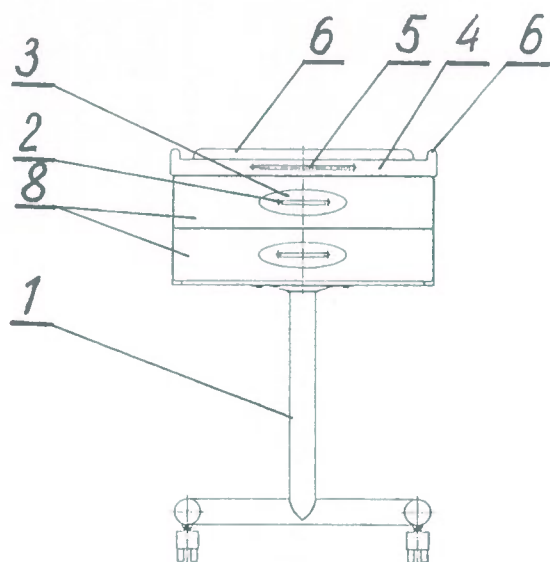


Fig. 1

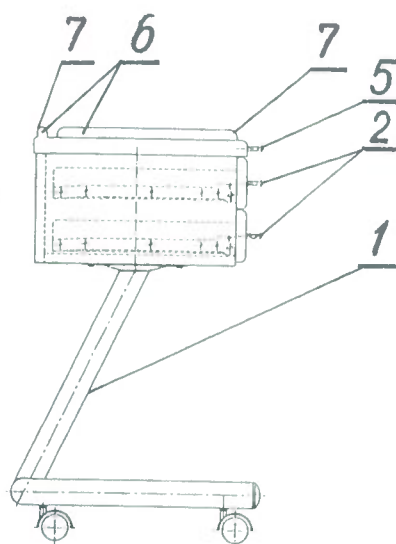


Fig. 2

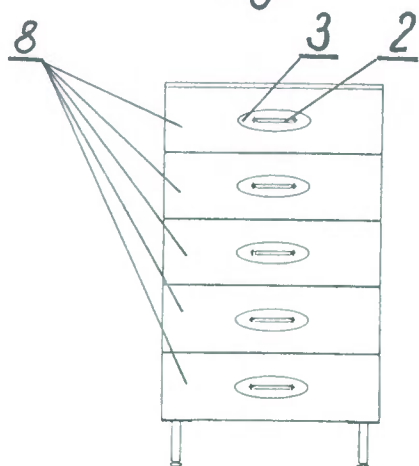


Fig. 12

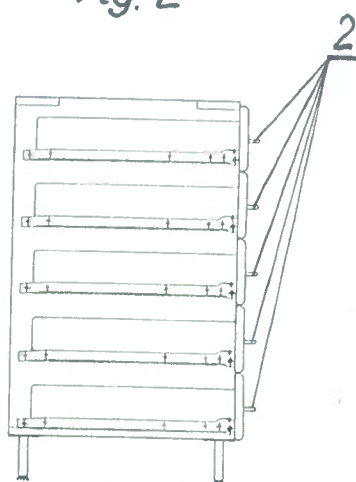


Fig. 13


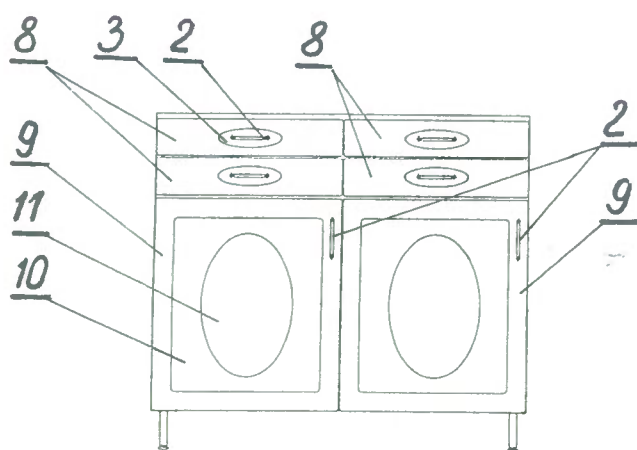


Fig. 16

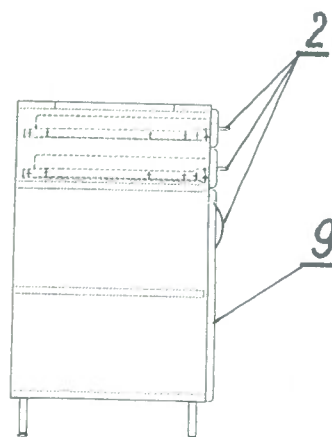

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego
FAMED S.A.

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel