



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203458560 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 05

(21) 申请号 201320299111. 8

(22) 申请日 2013. 05. 20

(73) 专利权人 李倩

地址 271400 山东省泰安市宁阳县宁阳镇金
阳大街 856 号宁阳县第一人民医院外
三科

(72) 发明人 李倩 孙秀玲 李国栋

(51) Int. Cl.

A61G 7/075(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

下肢术后护理高度可调装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种下肢术后护理高度可调装置,由立杆(1)、横杆(2)、加强板(3)、固定卡(4)、套带(5)、螺杆调节机构(6)构成,其特征在于螺杆调节机构(6),由左旋螺杆(6a)、右旋螺杆(6b)、挂钩(6c)、连接管(6d)、左旋螺母(6e)、右旋螺母(6f)、调节杆(6g)构成,左旋螺杆(6a)和右旋螺杆(6b)的一端均设挂钩(6c),另一端拧入连接管(6d)两端的左旋螺母(6e)和右旋螺母(6f)中,调节杆(6g)设在连接管(6d)上。该下肢术后护理高度可调装置,与目前的抬高方法相比,具有结构简单,容易制作,成本低,螺杆调节高度,肢体抬高后不下滑,提高治疗质量的优点。

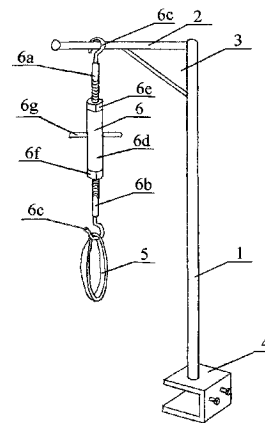

1. 一种下肢术后护理高度可调装置,由立杆(1)、横杆(2)、加强板(3)、固定卡(4)、套带(5)、螺杆调节机构(6)构成,其特征在于螺杆调节机构(6),由左旋螺杆(6a)、右旋螺杆(6b)、挂钩(6c)、连接管(6d)、左旋螺母(6e)、右旋螺母(6f)、调节杆(6g)构成,左旋螺杆(6a)和右旋螺杆(6b)的一端均设挂钩(6c),另一端拧入连接管(6d)两端的左旋螺母(6e)和右旋螺母(6f)中,调节杆(6g)设在连接管(6d)上。

下肢术后护理高度可调装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种下肢手术后休息抬高装置,具体地说是一种下技术后护理高度可调装置。

背景技术

[0002] 目前,下肢手术后卧床休息时,都需要抬高肢体,促进血液循环,减轻水肿,有利于下肢的恢复。而现在医院一般在床上放凳子将下肢抬高,上述抬高方法其不足:一是凳子放在床上不方便,也不能调整,适应性差;二是肢体放在凳子上,不牢固,易从凳子上掉下来。为解决以上不足,有的人研究了病床起重装置,公告号 CN201469568U,上述专利是通过操作充气球,向活塞筒内充气,活塞杆带动布带提升,上述技术方案,虽能解决用凳子抬高的不足,但也存有结构复杂,制造成本高,在使用过程中也易漏气,出现套带下滑的问题,影响医疗质量。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单,容易制作,成本低,螺杆调节高度,肢体抬高后不下滑,。提高治疗质量的下技术后护理高度可调装置。

[0004] 为达到以上目的,本实用新型所采取的技术方案是:该下技术后护理高度可调装置,由立杆、横杆、加强板、固定卡、套带、螺杆调节机构构成,其特征在于螺杆调节机构,由左旋螺杆、右旋螺杆、挂钩、连接管、左旋螺母、右旋螺母、调节杆构成,左旋螺杆和右旋螺杆的一端均设挂钩,另一端拧入连接管两端的左旋螺母和右旋螺母中,调节杆设在连接管上。使用本实用新型时,先将固定卡固定在床的纵梁上,让病人仰卧位躺在床上,把套带套在病人的患肢上,并挂在挂钩上,当高度低时,医护人员顺时针方向操作调节杆,使左、右旋螺杆缩短,套带携患肢上升;当高度高时,逆时针方向操作调节杆,使左、右旋螺杆加长,患肢下降。

[0005] 本实用新型的有益效果在于:与目前的抬高方法相比,具有结构简单,容易制作,成本低,螺杆调节高度,肢体抬高后不下滑,提高治疗质量的优点。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型结构主视示意图。

具体实施方式

[0007] 参照附图1制作本实用新型。该下技术后护理高度可调装置,由立杆1、横杆2、加强板3、固定卡4、套带5、螺杆调节机构6构成,其特征在于螺杆调节机构6,由左旋螺杆6a、右旋螺杆6b、挂钩6c、连接管6d、左旋螺母6e、右旋螺母6f、调节杆6g构成,左旋螺杆6a和右旋螺杆6b的一端均设挂钩6c,另一端拧入连接管6d两端的左旋螺母6e和右旋螺母6f中,调节杆6g设在连接管6d上。

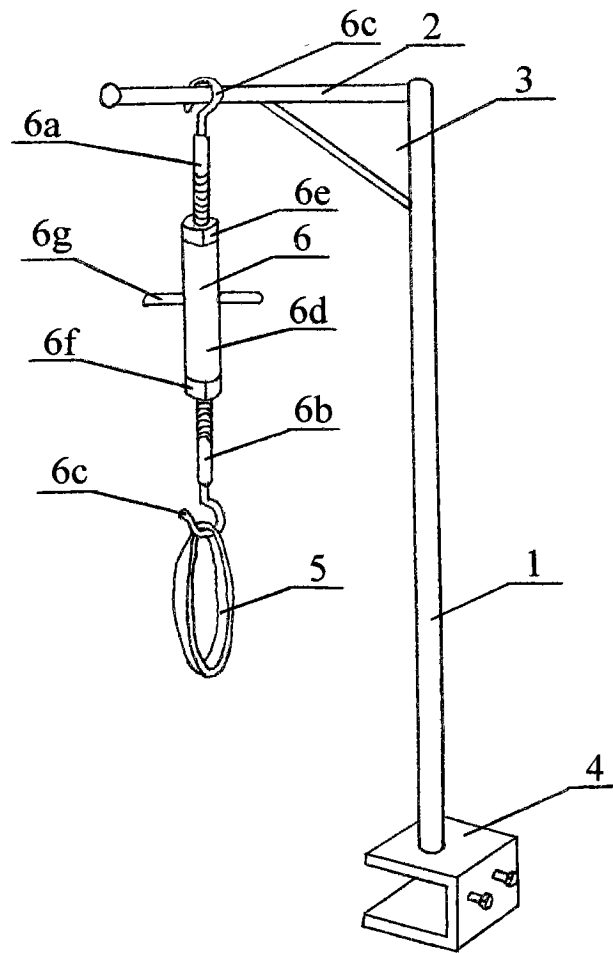


图 1