



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 211983834 U

(45) 授权公告日 2020. 11. 24

(21) 申请号 202020070213.2

(22) 申请日 2020.01.14

(73) 专利权人 彭森

地址 266000 山东省青岛市市南区栖霞路
16号

(72) 发明人 彭森 彭霏 赵伟

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 刘庆兰

(51) Int. Cl.

A41D 1/215 (2018.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/28 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种剖腹产后专用病员服

(57) 摘要

本实用新型涉及一种剖腹产后专用病员服，属于医疗康复用品技术领域。包括上衣和裤子，所述上衣和裤子前面为一体式，后部采用魔术贴连接，所述上衣前侧上部两边分别设置有6-10厘米长的开口部；上衣前侧中下部设置有椭圆形凸起部，所述凸起部中间设有拉链。本实用新型专门针对剖腹产后的产妇设计，设置有方便哺乳的开口部和方便刀口消毒查看的凸起部。凸起部内层设置有棉布和海绵，柔软保暖且透气性好，外层设置有硬质支撑板，可有效防止喂奶时，婴儿踢到刀口。

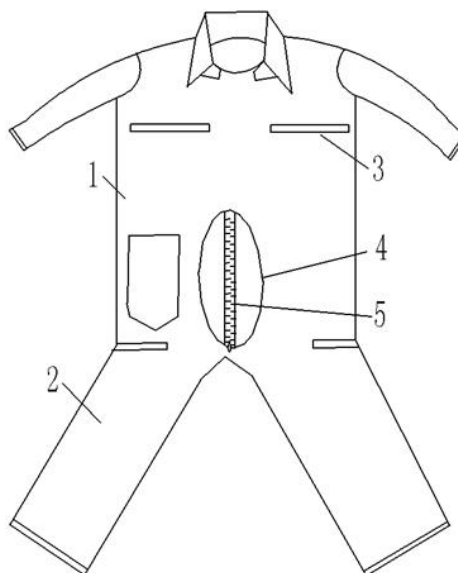

1. 一种剖腹产后专用病员服,包括上衣和裤子,其特征在于,所述上衣和裤子前面为一体式,后部采用魔术贴连接,所述上衣前侧上部两边分别设置有6-10厘米长的开口部;上衣前侧中下部设置有椭圆形凸起部,所述凸起部中间设有拉链。

2. 根据权利要求1所述的剖腹产后专用病员服,其特征在于,所述开口部包括上布片和下布片,上布片设置于下布片外侧,且上布片长于下布片。

3. 根据权利要求1所述的剖腹产后专用病员服,其特征在于,所述凸起部为四层结构,最内层为棉布,棉布外层为海绵,海绵外层为硬质支撑板,硬质支撑板外层为棉布。

4. 根据权利要求3所述的剖腹产后专用病员服,其特征在于,所述硬质支撑板上均匀开设有多个透气孔。

5. 根据权利要求3或4所述的剖腹产后专用病员服,其特征在于,所述硬质支撑板为塑料。

一种剖腹产后专用病员服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种剖腹产后专用病员服,属于医疗康复用品技术领域。

背景技术

[0002] 剖腹产妇手术前后均遭受巨大的痛苦,手术刀口较大,恢复时间长,而且产妇还要担负起照顾婴儿的责任,需要喂奶,同时需要不断对伤口进行消毒等处理。现有的病员服没有专门针对剖腹产妇女的特殊伤口位置及其特殊的喂奶需求而进行设计,在住院过程中,伤口位置容易被碰到,使得剖腹产妇疼痛加剧,痛苦加深。因此,针对剖腹产妇的特殊伤口和需求而设计一款实用性的病员服是很有必要的。

发明内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的不足,提出一种剖腹产后专用病员服。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型是采用下述的技术方案实现的:

[0005] 一种剖腹产后专用病员服,包括上衣和裤子,所述上衣和裤子前面为一体式,后部采用魔术贴连接,所述上衣前侧上部两边分别设置有6-10厘米长的开口部;上衣前侧中下部设置有椭圆形凸起部,所述凸起部中间设有拉链。

[0006] 作为优选,所述开口部包括上布片和下布片,上布片设置于下布片外侧,且上布片略长于下布片。

[0007] 作为优选,所述凸起部为四层结构,最内层为棉布,棉布外层为海绵,海绵外层为硬质支撑板,硬质支撑板外层为棉布。

[0008] 作为优选,所述硬质支撑板上均匀开设有多个透气孔。

[0009] 作为优选,所述硬质支撑板为塑料。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果在于:

[0011] 1.本实用新型专门针对剖腹产后的产妇设计,设置有方便哺乳的开口部和方便刀口消毒查看的凸起部。

[0012] 2.凸起部内层设置有棉布和海绵,柔软保暖且透气性好,外层设置有硬质支撑板,可有效防止喂奶时,婴儿踢到刀口。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型主视图,图2为本实用新型后视图,图3为凸起部各层结构示意图。

[0014] 各附图标记为:1上衣,2裤子,3开口部,4凸起部,5拉链,6棉布,7海绵,8硬质支撑板,9透气孔。

具体实施方式

[0015] 为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点,下面结合附图和实

施例对本实用新型做进一步说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0016] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是,本实用新型还可以采用不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本实用新型并不限于下面公开说明书的具体实施例的限制。

[0017] 实施例1

[0018] 附图为本实用新型的一种具体的实施例,如图1-3所示。

[0019] 本实施例中病员服专门针对剖产后的产妇而设计,包括上部的上衣1和上衣下方的裤子2。上衣1和裤子2之间前端是一体式的,后面部分采用魔术贴连接,可以方便产妇如厕。为了方便穿脱,魔术贴连接部分可以适当延长至前端两侧一部分。穿的时候较为方便的做法是先穿裤子2,然后将整个病员服提拉至最上端穿上衣1,然后将魔术贴贴合即可。魔术贴缝合在上衣1和裤子2连接处的缺口位置,缺口分为上下两部分,具体位于上缺口内侧和下缺口外侧,上缺口和下缺口分别用棉线缝合魔术贴的子母面,且缝合位置需距离最外侧2公分以上,魔术贴宽度在5厘米,或者略宽于5厘米。这样既能保证粘贴的力度,又不会粘贴力度过大,同时魔术贴的宽度适当加大还能减少魔术贴位置带来的不适感。为了方便哺乳,在上衣1的前侧靠近上方的位置设计有哺乳口,即开口部3,哺乳口的结构是长度在6-10厘米的开口。为了保护产妇的隐私,此开口的位置也进行了设计,开口部3包括上布片和下布片,平时穿着不哺乳时,上布片位于外侧,下布片位于内侧,且上布片略长,长出0.5厘米左右。上下布片可以单独缝制,也可以为一体式裁剪的结构。或者将上布片设计成两层,以增加其厚度,有效防止产妇走光。

[0020] 为了保护产妇的刀口位置,防止婴儿踢到或者不小心被其他物体碰到伤口,本实施例在上衣1前侧中下部的位置设计了椭圆形的凸起部4,并在凸起部4的中间位置设计有拉链5,方便医生对刀口位置检查和消毒。

[0021] 产妇在剖产完后会产生大量恶露,需要使用卫生纸和护理垫,为了方便产妇存拿,本实施例的防护服设计有一个(或两个)较大的口袋,位置在凸起部4的旁边。

[0022] 凸起部4为四层式结构,如图3所示,最内和最外层均是棉布6,用以包裹内层,中间两层分别是海绵层7和硬质支撑板8。其中海绵层7靠近内侧海绵,用于保暖和缓冲压力,海绵为高弹海绵,例如记忆棉。硬质支撑板8可以使用塑料或者硬质橡胶,硬质支撑板周边都由海绵包裹,然后用内外两侧的棉布缝合固定。为了增加透气性,硬质的支撑板8上均匀开设多个透气孔9,透气孔9孔径为5-10毫米。

[0023] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

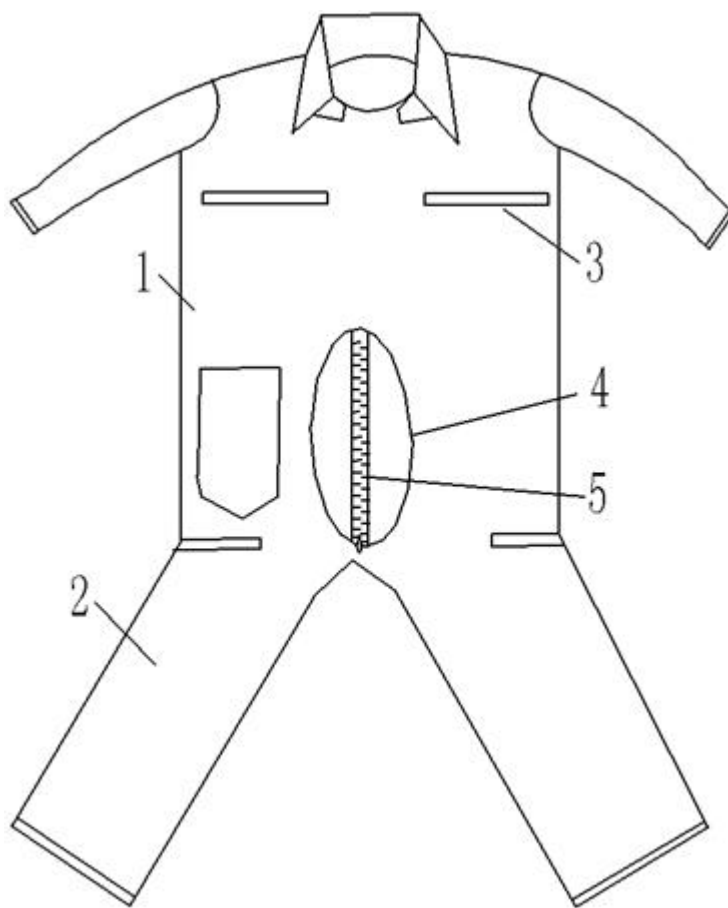


图1

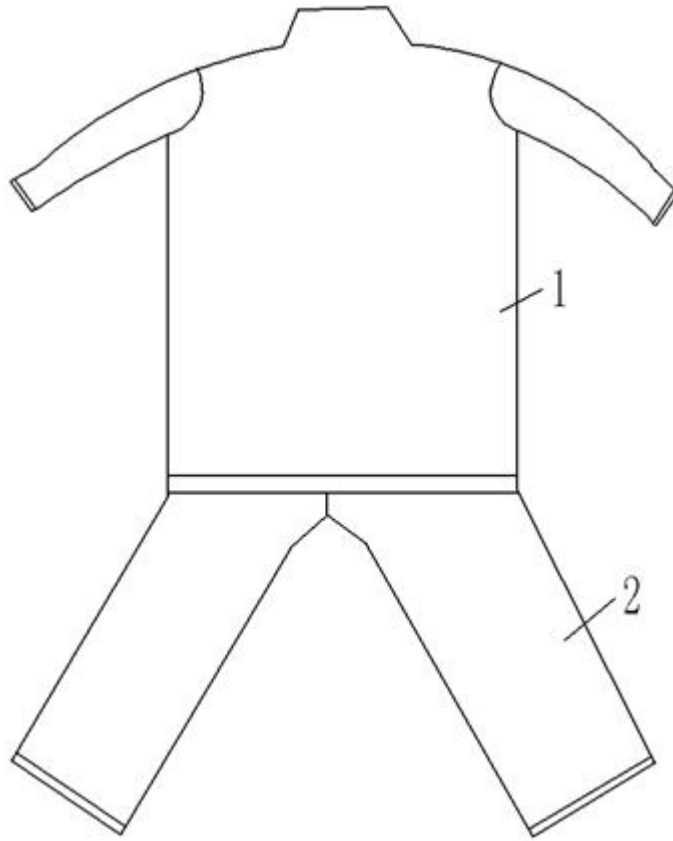


图2

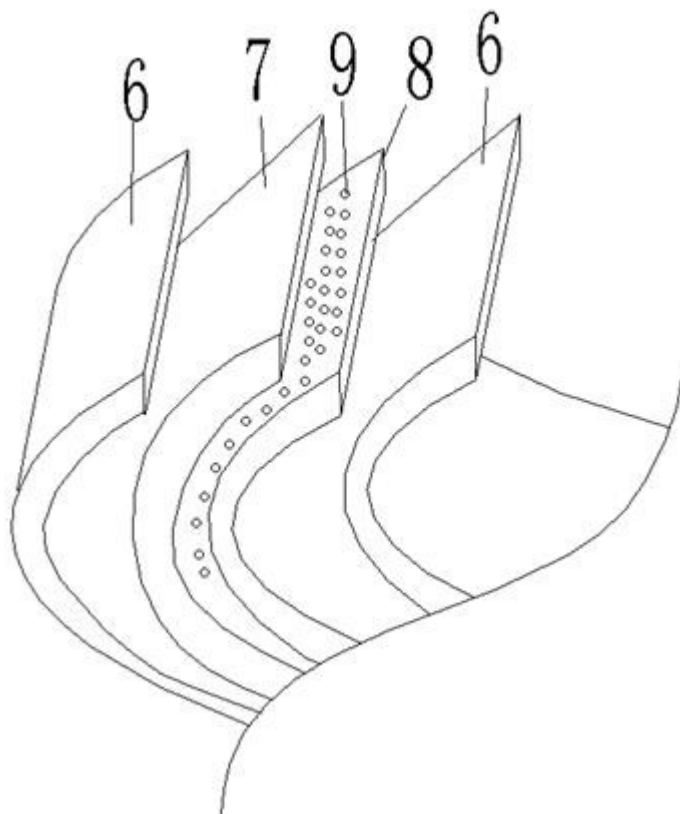


图3