



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201612625 U

(45) 授权公告日 2010. 10. 27

(21) 申请号 201020115480. 3

(22) 申请日 2010. 02. 22

(73) 专利权人 张霞

地址 264205 山东省威海市经济技术开发区
齐鲁大道 122 号威海市经区医院

(72) 发明人 张霞 朱红升

(74) 专利代理机构 威海科星专利事务所 37202

代理人 于涛

(51) Int. Cl.

A61B 8/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

滑移 B 超检查床

(57) 摘要

本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体地说是一种滑移 B 超检查床,设有床面和床腿,其特征在于床腿上端两侧设有滑道,床面下端两侧设有滑轮,滑轮设在滑道内,可沿滑道作直线滑行,床腿一侧的滑道一端设有锁紧杆,锁紧杆穿过滑道侧壁设置的孔与床面侧壁相抵触,以利于对床面定位,本实用新型由于采用上述结构,具有结构合理、使用方便、根据检查需要可自动上移或下移、减少检查时间、降低病人痛苦等优点。

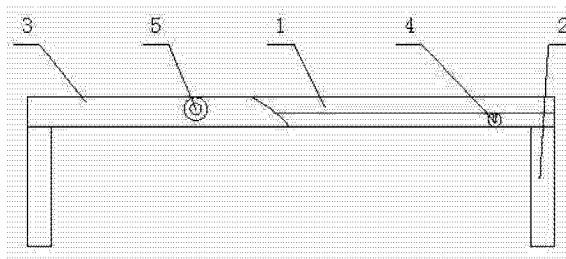

1. 一种滑移 B 超检查床, 设有床面和床腿, 其特征在于床腿上端两侧设有滑道, 床面下端两侧设有滑轮, 滑轮设在滑道内, 床腿一侧的滑道一端设有锁紧杆, 锁紧杆穿过滑道侧壁设有的孔与床面侧壁相抵触。

2. 根据权利要求 1 所述的一种滑移 B 超检查床, 其特征在于床面侧壁设有凹槽, 凹槽与滑道侧壁设有的孔高度相同。

滑移 B 超检查床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体地说是一种滑移 B 超检查床。

背景技术

[0002] 目前，医院的 B 超医生在为不能自理的病人或危重病人作 B 超检查时，由于 B 超检查床是由床面和床面下端的床腿固定而成，需要陪护人员协助向床的上方或下方移位，才能作 B 超检查，给医生和陪护人员带来很大的麻烦，增加检查时间，延长治疗时间，给病人带来的痛苦。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是解决上述现有技术的不足，提供一种结构合理、使用方便、根据检查需要可自动上移或下移、减少检查时间、降低病人痛苦的滑移 B 超检查床。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种滑移 B 超检查床，设有床面和床腿，其特征在于床腿上端两侧设有滑道，床面下端两侧设有滑轮，滑轮设在滑道内，可沿滑道作直线滑行，床腿一侧的滑道一端设有锁紧杆，锁紧杆穿过滑道侧壁设有的孔与床面侧壁相抵触，以利于对床面定位。

[0006] 本实用新型可在床面侧壁设有凹槽，凹槽与滑道侧壁设有的孔高度相同，以利于锁紧杆定位床面。

[0007] 本实用新型由于采用上述结构，具有结构合理、使用方便、根据检查需要可自动上移或下移、减少检查时间、降低病人痛苦等优点。

[0008] 附图说明

[0009] 附图是本实用新型的结构示意图。

[0010] 附图标记：床面 1、床腿 2、滑道 3、滑轮 4、锁紧杆 5

[0011] 具体实施方式：

[0012] 下面结合附图对本实用新型进一步说明：

[0013] 如附图所示，一种滑移 B 超检查床，设有床面 1 和床腿 2，其特征在于床腿 2 上端两侧设有滑道 3，床面 1 下端两侧设有滑轮 4，滑轮 4 设在滑道 3 内，可沿滑道 3 作直线滑行，床腿 2 一侧的滑道 3 一端设有锁紧杆 5，锁紧杆 5 穿过滑道 3 侧壁设有的孔与床面 1 侧壁相抵触，以利于对床面 1 定位。

[0014] 本实用新型可在床面 1 侧壁设有凹槽，凹槽与滑道 3 侧壁设有的孔高度相同，以利于锁紧杆 5 定位床面。

[0015] 本实用新型在使用时，不能自理的病人或危重病人经陪护人员抬到检查床床面 1 上，根据需要医生调整锁紧杆 5，使床面 1 经滑轮 4 沿滑道 3 作直线运动，来调整病人的检查位置，当调整到指定位置后，旋紧锁紧杆 5，使锁紧杆 5 顶端顶住床面侧壁的凹槽，达到床面 1 固定即可。

[0016] 本实用新型由于采用上述结构，具有结构合理、使用方便、根据检查需要可自动上移或下移、减少检查时间、降低病人痛苦等优点。

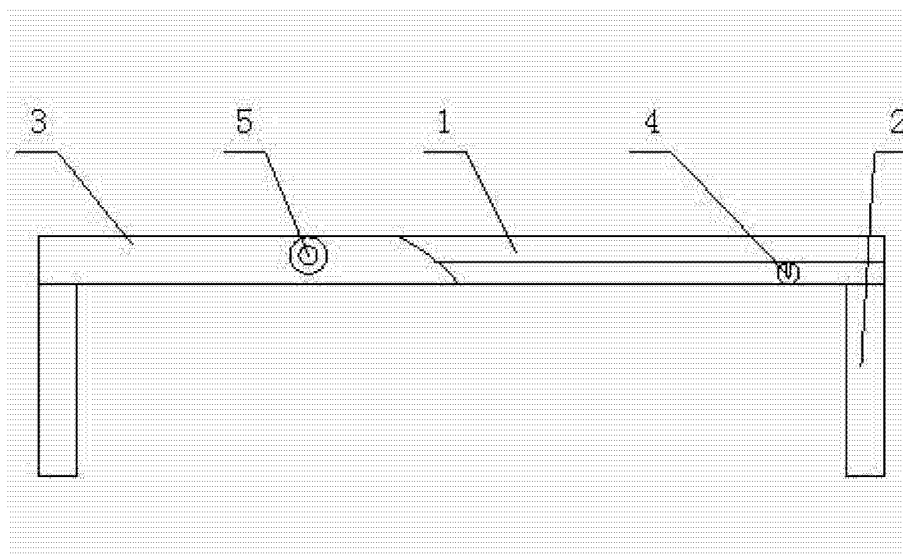


图 1