

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2009-521684

(P2009-521684A)

(43) 公表日 平成21年6月4日 (2009. 6. 4)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO 1 N 35/08 (2006.01)	GO 1 N 35/08 A	2 G 0 5 8
GO 1 N 37/00 (2006.01)	GO 1 N 37/00 1 O 1	4 C 0 3 8
A 6 1 B 5/151 (2006.01)	A 6 1 B 5/14 3 O O D	
A 6 1 B 5/1459 (2006.01)	A 6 1 B 5/14 3 2 1	
A 6 1 B 5/1468 (2006.01)	A 6 1 B 5/14 3 3 0	
審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 50 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2008-547560 (P2008-547560)	(71) 出願人	500575824
(86) (22) 出願日	平成18年12月22日 (2006. 12. 22)		ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド
(85) 翻訳文提出日	平成20年8月22日 (2008. 8. 22)		アメリカ合衆国ニュージャージー州07962-2245, モーリスタウン, コロンビア・ロード 101, ピー・オー・ボックス 2245
(86) 国際出願番号	PCT/US2006/048851	(74) 代理人	100140109
(87) 国際公開番号	W02007/075922		弁理士 小野 新次郎
(87) 国際公開日	平成19年7月5日 (2007. 7. 5)	(74) 代理人	100089705
(31) 優先権主張番号	60/753, 293		弁理士 社本 一夫
(32) 優先日	平成17年12月22日 (2005. 12. 22)	(74) 代理人	100075270
(33) 優先権主張国	米国 (US)		弁理士 小林 泰
(31) 優先権主張番号	60/755, 014	(74) 代理人	100080137
(32) 優先日	平成17年12月29日 (2005. 12. 29)		弁理士 千葉 昭男
(33) 優先権主張国	米国 (US)		
(31) 優先権主張番号	11/615, 927		
(32) 優先日	平成18年12月22日 (2006. 12. 22)		
(33) 優先権主張国	米国 (US)		


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 携帯用サンプル分析装置のカートリッジ

(57) 【要約】

サンプル分析装置に関するシステム、更に特定すれば、動作が簡単で、ユーザに誤った結果を提示する危険性を低減したサンプル分析装置。場合によっては、サンプル分析装置は、使い捨て流体カートリッジを含む携帯用サンプル分析装置とすることもできる。分析装置の操作者は、訓練を受ける必要がない。

【選択図】 図1

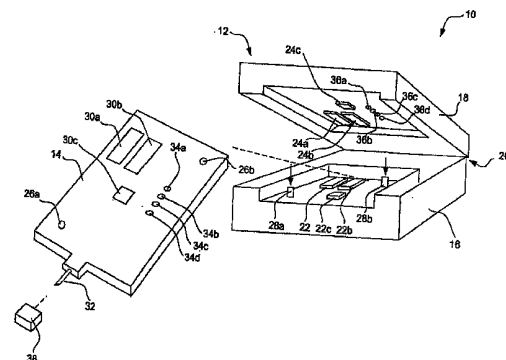

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

サンプル分析装置用カートリッジであって、
少なくとも 1 つの流動チャンネルを備えており、
前記流動チャンネルは、当該チャンネル内に 1 つ又は複数の壁と内部空間とを備えており、
前記流動チャンネルの 1 つ又は複数の壁に、2 つ又は 3 つ以上の電極が配置されており、
前記 2 つ又は 3 つ以上の電極は、信号源に接続可能である、
サンプル分析装置用カートリッジ。

【請求項 2】

請求項 1 記載のカートリッジにおいて、
前記電極間における前記信号源の電圧および電流特性は、前記内部空間の抵抗率を示し、
抵抗率が一定の範囲内にある場合、前記内部空間内にしかるべき流体があることを示し、
抵抗率が前記一定の範囲内にない場合、前記流体内における正しくない試薬、気泡の存在、および／または前記流体の容認できない特性を示し、
抵抗率が前記一定の範囲内にない場合、前記サンプル分析装置は分析結果を提示しない、またはエラーを示す、カートリッジ。

【請求項 3】

請求項 1 記載のカートリッジにおいて、
前記電極間における前記信号源の電圧および電流特性は、前記内部空間の抵抗を示し、
抵抗が一定の範囲内にある場合、前記内部空間の中に正しい流体があることを示し、
抵抗が前記一定の範囲内にない場合、前記流体内の正しくない流体、気泡の存在、および／または前記内部空間における流体の容認できない特性を示し、
抵抗が前記一定の範囲内にない場合、前記サンプル分析装置は、分析結果を呈示しないか、またはエラーを示す、カートリッジ。

【請求項 4】

請求項 1 記載のカートリッジにおいて、
前記電極間における前記信号源の電圧および電流特性は、前記内部空間の容量を示し、
容量が一定の範囲内にある場合、前記内部空間の中に正しい流体があることを示し、
容量が前記一定の範囲内にない場合、前記流体内の正しくない流体、気泡の存在、および／または前記内部空間における流体の容認できない特性を示し、
容量が前記一定の範囲内にない場合、前記サンプル分析装置は、分析結果を呈示しないか、またはエラーを示す、カートリッジ。

【請求項 5】

サンプル分析装置のカートリッジであって、
少なくとも 1 つの流動チャンネルを有し、
前記流動チャンネル内にセンサを配置してある、カートリッジ。

【請求項 6】

請求項 5 記載のカートリッジにおいて、
前記センサは、PH センサであり、
前記 PH センサからの信号は、前記流動チャンネルにおける PH の尺度を示し、
前記 PH の尺度は、前記流動チャンネル内にしかるべき流体があるか否かを示す、カートリッジ。

【請求項 7】

請求項 5 記載のカートリッジにおいて、
前記センサは、熱伝導率センサであり、
前記熱伝導率センサからの信号は、前記流動チャンネルにおける熱伝導率の尺度を示し、
前記熱伝導率の尺度は、前記流動チャンネル内にしかるべき流体があるか否かを示す、カ

ートリッジ。

【請求項 8】

請求項 5 記載のカートリッジにおいて、
前記センサは、比熱センサであり、
前記比熱センサからの信号は、前記流動チャネルにおける比熱の尺度を示し、
前記比熱の尺度は、前記流動チャネル内にしかるべき流体があるか否かを示す、カートリッジ。

【請求項 9】

カートリッジであって、
少なくとも 1 つの流動チャネルと、
前記カートリッジと連動する時間指示器と、
を備えており、イベントによって前記時間指示器に動作を実行させる、カートリッジ。

10

【請求項 10】

請求項 9 記載のカートリッジにおいて、
前記カートリッジは、初期状態において密閉パッケージの中に入っており、
前記イベントは、前記カートリッジを前記パッケージから取り出すことであり、これによって前記時間指示器を起動して、時間を計測する、カートリッジ。

【請求項 11】

請求項 10 記載のカートリッジにおいて、経過時間が容認可能よりも大きい場合、前記カートリッジを計器に挿入したときに、カードおよび計器が構成するサンプル分析装置が、分析を実行しない、結果を呈示しない、および／またはエラー指示を呈示する、カートリッジ。

20

【請求項 12】

請求項 9 記載のカートリッジにおいて、
前記時間指示器は、それを覆う帯を有し、
前記イベントは、前記時間指示器から前記帯を取り外すことであり、これにより前記時間指示器を起動して時間を計測する、カートリッジ。

【請求項 13】

請求項 12 記載のカートリッジにおいて、経過時間が容認可能よりも大きい場合、前記カートリッジを計器に挿入したときに、カードおよび計器が構成するサンプル分析装置が、分析を実行しない、結果を呈示しない、および／またはエラー指示を呈示する、カートリッジ。

30

【請求項 14】

請求項 9 記載のカートリッジにおいて、
前記時間指示器は、高精度の時間および日付を維持するクロック・チップであり、
前記イベントは、前記カートリッジを計器に挿入することであり、これによって前記クロック・チップに前記カートリッジの製造されてからの期間(age)を示させる、カートリッジ。

【請求項 15】

請求項 14 記載のカートリッジにおいて、前記カートリッジの製造されてからの期間が容認できない場合、前記カートリッジを計器に挿入したときに、サンプル分析装置が、分析を実行しない、結果を呈示しない、および／またはエラー指示を呈示する、カートリッジ。

40

【請求項 16】

請求項 9 記載のカートリッジにおいて、前記時間指示器は、時間量を示す色変化帯を有する、カートリッジ。

【請求項 17】

カートリッジであって、
流動チャネルと、
ばね作動式ランセットと、

50

を備えており、

前記バイアスは、延長方向に偏倚されており、

解放機構が、前記ランセットが解放されるまで、後退位置に固定し、

前記ランセットを経由して血液サンプルを前記カートリッジに導入する、カートリッジ

。

【請求項 18】

請求項 17 記載のカートリッジにおいて、前記ランセットは、解放されたときの前記ランセットの深さのために、ダイヤルイン調節手段を有する、カートリッジ。

【請求項 19】

カートリッジであって、

少なくとも 1 つの流動チャネルを備えており、

前記チャネルが、気泡トラップを備えている、カートリッジ。

【請求項 20】

請求項 19 記載のカートリッジにおいて、前記気泡トラップは、気泡が前記チャネルの近くを通過する際に、該チャネルから発散するために、多孔質膜を前記チャネルの壁の一部として備えている、カートリッジ。

【請求項 21】

請求項 20 記載のカートリッジにおいて、前記膜は疎水性である、カートリッジ。

【請求項 22】

請求項 19 記載のカートリッジにおいて、前記気泡トラップは、前記流動チャネルの壁における変形からなる、カートリッジ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本願は、2005 年 12 月 22 日に出願した米国仮特許出願第 60 / 753, 293 号の優先権を主張する。

本願は、2005 年 12 月 29 日に出願した米国仮特許出願第 60 / 755, 014 号の優先権を主張する。

【0002】

本願は、2004 年 5 月 14 日に出願した米国仮特許出願第 60 / 571, 235 号の優先権を主張する、2005 年 5 月 12 日に出願した米国特許出願第 10 / 908, 460 号の一部継続出願である。

【0003】

本願は、2004 年 5 月 14 日に出願した米国仮特許出願第 60 / 571, 235 号の優先権を主張する、2005 年 5 月 12 日に出願した米国特許出願第 10 / 908, 461 号の一部継続出願である。

【0004】

本願は、2004 年 9 月 27 日に出願した米国特許出願第 10 / 950, 898 号の一部継続出願である、2005 年 12 月 30 日に出願した米国特許出願第 11 / 306, 508 号の一部継続出願である。

【0005】

本願は、2004 年 9 月 9 日に出願した米国特許出願第 10 / 938, 265 号の一部継続出願である。

2005 年 12 月 22 日に出願した米国仮特許出願第 60 / 753, 293 号をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。2005 年 12 月 29 日に出願した米国仮特許出願第 60 / 755, 014 号をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。2005 年 5 月 12 日に出願した米国特許出願第 10 / 908, 460 号をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。2005 年 5 月 12 日に出願した米国特許出願第 10 / 908, 461 号をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。2005 年 12 月 30 日

10

20

30

40

50

に出願した米国特許出願第 11 / 306, 508 号をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。2004 年 9 月 27 日に米国特許出願第 10 / 950, 898 号の一部継続出願をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。2004 年 9 月 9 日に米国特許出願第 10 / 938, 265 号をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。

【0006】

本発明は、一般的には、サンプル分析装置に関し、更に特定すれば、操作が簡単で、誤った結果を提示する危険性を低減したサンプル分析装置に関する。

【背景技術】

【0007】

化学および／または生化学分析は、生命科学の研究、臨床診断、および広範囲の環境およびプロセス監視にとって重要である。場合によっては、サンプル流体の化学および／または生化学分析を行うため、および／またはそれを補助するために、サンプル分析装置が用いられる。サンプル流体は、用途に応じて、液体または気体の場合もあり得る。

【0008】

多くのサンプル分析装置は、どちらかと言うと大型のデバイスであり、訓練された要員が研究室環境において用いている。多くのサンプル分析装置を用いるためには、最初に収集したサンプルを処理しなければならない、サンプルを所望のレベルに希釈し、しかるべき試薬を添加し、サンプルを遠心分離して所望の分離を行う等の後に、準備したサンプルをサンプル分析装置に供給する。精度の高い結果を達成するために、かかるサンプル処理は、通例、訓練を受けた要員によって実行しなければならないが、そのためにサンプル分析を実行するために必要なコストおよび時間が増大する。

【0009】

また、多くのサンプル分析装置では、分析フェーズにおいて、追加の情報入力または追加のサンプル処理を必要とするというような、操作者の介入を必要とする。このために、所望のサンプル分析を実行するために必要なコストおよび時間が更に増大する可能性がある。また、多くのサンプル分析装置は、単に生の分析データを出力として供給するに過ぎず、その先の計算および／または解釈は、訓練を受けた要員によって実行して、しかるべき臨床的判断またはその他の判断を下さなければならないことが多い。

【0010】

2005 年 12 月 22 日に米国仮特許出願第 60 / 753, 293 号をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。2005 年 12 月 29 日に米国仮特許出願第 60 / 755, 014 号をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。2005 年 5 月 12 日に米国特許出願第 10 / 908, 460 号をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。2005 年 5 月 12 日に米国特許出願第 10 / 908, 461 号をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。2005 年 12 月 30 日に米国特許出願第 11 / 306, 508 号をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。2004 年 9 月 27 日に米国特許出願第 10 / 950, 898 号の一部継続出願をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。2004 年 9 月 9 日に米国特許出願第 10 / 938, 265 号をここで引用することにより、その内容が本願にも含まれるものとする。

【発明の開示】

【0011】

本発明は、一般的には、サンプル分析装置に関し、更に特定すれば、更操作が簡単で、誤った結果をユーザに提示する危険性を低減したサンプル分析装置に関する。場合によっては、サンプル分析装置は、使い捨て流体カートリッジを含む携帯用サンプル分析装置とすることもできる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0012】

本発明は、サンプル分析装置に関し、更に特定すれば、操作が簡単で、誤った結果を提示する危険性を低減したサンプル分析装置に関する。例によっては、サンプル分析装置は、例えば、流動血球計算器のような血液分析装置、血液学(hematology)分析装置、臨床化学分析装置（例えば、ブドウ糖分析装置、イオン分析装置、電解質分析装置、溶融気体分析装置等）、尿分析装置、またはその他の適した分析装置であれば、所望に応じて、いずれであってもよい。

【0013】

本発明では、当該発明またはそれによって行われる検査がある種の要件を満たすのであれば、規制監督(regulatory oversight)から特認(waive)される場合もある。本発明は、検査の準備をするおよび／または検査を実行するために実施することができる。検査は、簡単で精度が高い研究室の試験および手順とすることができ、誤った結果の公算を無視し得る程に減らし、検査を正しく行わなかった場合でも患者に危害を加える危険性が少しもない。一種の特認(waiver)は、1988年の臨床研究室改善修正条項としてもよい。

【0014】

図1は、流動血球計算器の斜視図である。流動血球計算分析装置は、例示の目的で説明するに過ぎず、望ましければ、別の種類のサンプル分析装置に適用してもよいことを想定している。図示のサンプル分析装置を全体的に10で示し、筐体12および着脱式または使い捨てカートリッジ14を含む。図示の筐体12は、底面16、カバー18、および蝶番20を含む。蝶番20は、底面をカバー18に取り付けるが、これは必須ではない。図示の例では、基板16は、第1光源22a、第2光源22b、および第3光源22cを、付随する光学素子およびサンプル分析装置の動作に必要な電子部品と共に含んでいる。光源の各々は、用途に応じて、単一光源または多重光源のいずれでもよい。場合によっては、所望に応じて、筐体全体の寸法が1立方フィート未満、1/2立方フィート未満、1/4立方フィート未満、またはそれよりも小さい場合もあり得る。同様に、筐体全体の重量は、所望に応じて、10ポンド未満、5ポンド未満、1ポンド未満、またはそれよりも小さい場合もあり得る。

【0015】

図示のカバー12は、圧力源（例えば、制御用微小弁を有する圧力チェンバ）、第1光検出器24a、第2光検出器22b、および第3光検出器22cを含み、各々には光学素子および電子部品が付随する。光検出器の各々も、用途に応じて、単一光検出器または多重光検出器のいずれでもよい。所望であれば、偏光板および／またはフィルタも、用途に応じて、設けてもよい。

【0016】

図示の着脱式カートリッジ14は、サンプル収集ポートを通じてサンプル流体を受けるように構成されており、図示の例では、ランセット(lancet)32を含む。ランセット32は、例によっては、伸縮自在および／またはばね懸架式としてもよい。キャップ38は、着脱式カートリッジ14が用いられていないときに、サンプル収集ポートおよび／またはランセット32を保護するために用いることができる。

【0017】

図示の例では、着脱式カートリッジ14が血液サンプル全体について血液分析を行う。ランセット32は、ユーザの指に突き刺して、血液サンプルを得るために用いることができる。血液は、毛細管作用によって、着脱式カートリッジ14内にある、凝固防止被膜を施された毛細管に引き込まれる。着脱自在カートリッジ14は、流体回路で構成することができ、流体回路の一部は、チャンネルを食刻した積層構造を用いて作成されている。しかしながら、着脱式カートリッジ14は、所望に応じて、射出成形あるいは適しているのであれば他のいずれの製造プロセスまたは手法によることも含む、いずれの適した様式で構成してもよいことを想定している。

【0018】

使用中、および血液サンプルを着脱式カートリッジ14内に引き込んだ後、着脱式カートリッジ14を筐体内に挿入することができる。場合によっては、着脱式カートリッジ1

10

20

30

40

50

4は、カバー18が開放位置にあるときに挿入するとよいこともある。しかしながら、他の例では、着脱式カートリッジ14は、適した方法であればいずれでも筐体内に挿入してもよい。例えば、筐体がスロットを有し、着脱式カートリッジ10筐体のスロットに挿入してもよい。

【0019】

図1の例示的な例に戻り、着脱式カートリッジ14は、底面16に位置合わせピン28aおよび28bを受容する孔26aおよび26bを含むことができ、計器の異なる部品間で整合および結合を行う際に役立てることができる。また、着脱式カートリッジ14は、第1透明流動窓(flow stream window)30c、第2透明流動窓30b、および第3透明窓30cも含むことができ、これらは、第1、第2、および第3光源22a、22bおよび22c、ならびに第1、第2、および第3光検出器24a、24bおよび24cとそれぞれ整列されている。

【0020】

カバーを閉鎖位置に移動し、システムを加圧すると、カバー18は、圧力供給ポート36a、36b、36c、および36dを通じて、それぞれ、図示の着脱式カートリッジ14の中にある圧力受入ポート34a、34b、34cおよび34cに、制御した圧力を供給する。尚、用いる圧力供給および圧力受入ポートは、用途に応じて、これらよりも多い場合も少ない場合もあり得ることを想定している。あるいは、または加えて、静電作動式メソ・ポンプ(meso pump)のような、1つ又は複数の微小ポンプを、着脱式カートリッジ14上または内部に備えて、着脱式カートリッジ14上の流体回路を動作させるのに必要な圧力を供給するようにしてもよいことも想定している。例えば、数個の例示的な静電作動式メソ・ポンプが、米国特許第5,836,750号、第6,106,245号、第6,179,486号、第6,729,856号、および第6,767,190号に記載されている。これらは全て、本発明の譲受人に譲渡されており、ここで引用したことにより、その内容は本願にも含まれるものとする。

【0021】

一旦加圧すると、図示の計器は収集した血液サンプルに対して血液分析を実行することができる。場合によっては、血液分析は、完血球計数(CBC)分析を含んでもよいが、用途に応じて、他の種類の分析を実行することもできる。

【0022】

赤血球を計数し分類するために、全血液サンプルの一部を区分し、着脱式カートリッジ14の中にある赤血球測定チャンネルに供給する。次いで、望ましければ、血液サンプルを希釈することができ、赤血球をその場で球状にすることができ、その結果得られたサンプルを流体力学的に収束して(focus)中核情報を求め、最終的に第1血球計算チャンネルに供給することができる。第1血球計算チャンネルは、着脱式カートリッジ14の第1透明流動窓30aに沿って配置することができるので、流動体(flow stream)内の血球に、第1光源22aおよび第1光検出器24aによって光学的に呼掛ける(interrogate)ことができる。場合によっては、第1流速センサを着脱式カートリッジ14上に設け、第1血球計算チャンネルを通過する際の流速の尺度を供給することもできる。

【0023】

場合によっては、測定したパラメータは、例えば、サンプル流速(FR)、測定時間(T)期間、サンプル希釈係数(DF)、計数した赤血球数(N_{RB})、計数した血小板数(N_{plt})、各血球の直径($drbc$)、および各血球のヘモグロビン濃度(CHC)を含むことができる。これらのパラメータから、多数の赤血球分析パラメータを計算することができ、例えば、赤血球計数($RBC = N_{RB} / (DF \times FR \times T)$)、血小板計数($Plt = N_{plt} / (DF \times FR \times T)$)、平均血球ヘモグロビン濃度($MCHC = \langle CHC \rangle$)、平均血球体積($MCV = (\pi/6) \times \langle drbc^3 \rangle$)、平均血球ヘモグロビン含有量($MCH = (\pi/6) \times \langle drbc^3 \times CHC \rangle$)、相対的分散幅($RDW = [(\pi/6) \times drbc^3] / MCV$ の標準偏差)、ヘマトクリット係数($Hct = RBC \times MCV$)、および/またはヘモグロビン濃度($Hb = MCHC \times Hct$)を含む。

【0024】

10

20

30

40

50

例によっては、血液サンプルの一部を吸収測定チャンネルにも送出する。吸収測定チャンネルは、着脱式カートリッジ 14 の第 3 透明窓 30 c に沿って配置することができるので、第 3 光源 22 c および第 3 光検出器 24 c によって血液サンプルに光学的に呼掛けることができる。着脱式カートリッジ 14 上に流速センサを設けて、吸収測定チャンネルに流入するまたは通過する際の流速の尺度を供給することもできる。吸収測定チャンネルは、第 3 光源 22 c が供給する入射光の吸収の尺度を規定することができる。測定した吸収度は、血液サンプルにおけるバルクまたは平均血球ヘモグロビン濃度の指示を提示することができる。

【0025】

白血球を計数し分類するために、全血液サンプルの一部を区分して、着脱式カートリッジ 14 の中にある白血球測定チャンネルに供給することができる。次いで、所望であれば、血液サンプルを希釈することができ、その場で赤血球を溶解させることができ、その結果得られたサンプルを流体力学的に収束して中核情報を求め、最終的に第 2 血球計算チャンネルに供給することができる。第 2 血球計算チャンネルは、着脱式カートリッジ 14 の第 2 透明流動窓 30 b に沿って設けることができるので、第 2 光源 22 b および第 2 光検出器 24 b b によって光学的に流動体内の血球に呼掛けることができる。着脱式カートリッジ 14 上に流速センサを設けて、第 2 血球計算チャンネルを通過する際の流速の尺度を規定することができる。場合によっては、測定した白血球パラメータは、例えば、3 または 5 部白血球分画(three or five part white cell differentiation)、総白血球計数数、および／または軸上白血球体積(on-axis white blood cell volume)を含むことができる。用途

【0026】

図 1 は、1 つの例示的なサンプル分析装置およびカートリッジ・アセンブリを示す。しかしながら、他のサンプル分析器の構成を用いてもよいことも想定している。例えば、サンプル分析装置 10 および着脱式カートリッジは、Schwichtenberg et al. の米国特許出願第 2004/0211077 号に記載されているものと同様であってもよい。この特許出願の内容は、ここで引用したことにより、本願にも含まれるものとする。

【0027】

場合によっては、サンプル分析装置 10 は、医者診察室、家庭内、または現場のどこかというような、患者の看護地点において用いられるように構成されている。研究室環境の外部で信頼性高く用いることができるサンプル分析装置 10 を提供することができ、しかも特殊な訓練は殆どまたは全く不要なので、サンプル分析プロセスを簡略化し、コストおよび医療要員の負担を軽減し、比較的頻繁に血液監視／分析を必要とする患者を含む、多くの患者に対するサンプル分析の利便性を高めるのを促進することができる。

【0028】

動作の間、サンプル分析装置 10 は、収集した全血液サンプルのような、収集したサンプルを受け取り、一旦分析装置を作動させると、サンプル分析装置 10 は自動的にサンプルを処理し、診断的判断を下すための情報をユーザに提供することができる。例によっては、サンプル分析装置 10 はユーザがそれ以上の計算や解釈をしなくても済むように、定量的な結果（例えば、既定の範囲内および／または外）を表示または指摘することもできる。

【0029】

図 2 は、図 1 の例示的なサンプル分析装置およびカートリッジの模式図である。既に詳細に説明したように、そして図示の例では、底面 16 は多数の光源 22、付随する光学素子、ならびに分析装置の動作に必要な制御および処理用電子部品 40 を含むことができる。また、基板 16 は、バッテリー 42、変圧器、またはその他の電源も含むことができる。図示のカバー 12 は圧力源／流速制御ブロック 44、および光学素子が付随する多数の光検出器 24 を有する。

【0030】

着脱式カートリッジ 14 は、サンプル収集ポートまたはランセット 32 を通してサン

ル流体を受け取ることができる。圧力源／流速制御ブロック４４によって加圧すると、着脱式カートリッジ１４は、受け取った血液サンプルに対して血液分析を実行することができる。例によっては、そして既に説明したように、着脱式カートリッジ１４は、多数の試薬４９と、試薬を血液サンプルと混合して分析用血液サンプルを調合する流体回路とを含むことができる。また、着脱式カートリッジ１４は、場合によっては、流体回路の適正な動作を制御および／または検証するのに役立てるために、多数の流速センサも含むことができる。

【００３１】

場合によっては、血液サンプルを調合し（例えば、溶解、球体化、染色、希釈、および／またはそれ以外の処理）、次いで血球計算チャンネル５０のような１つ又は複数の搭載血球計算チャンネルにおいて、流体力学的に収束して中核情報を求める。図示の例では、血球チャンネル５０は、着脱式カートリッジ１４の中にある第１透明流動ウィンドウ３０ａのような透明な流動ウィンドウを通して導出される。基板１６における光源２２のアレイおよび付随する光学素子は、流動ウィンドウ３０ａを通じて、中核流を通過する光を供給することができる。光検出器２４および付随する光学素子は、同様に流動窓３０ａを通じて、散乱光および非散乱光を中核から受光することができる。コントローラまたはプロセッサ４０は、検出器２４のアレイから出力信号を受信することができ、中核流内にある選択されたセルを分画および／または計数することができる。

【００３２】

尚、着脱式カートリッジ１４は、着脱式カートリッジ１４上において流体の少なくとも一部の速度を制御するのを補助するために、流体制御ブロック４８を含んでもよいことを想定している。図示の例では、流体制御ブロック４８は、種々の流体の速度を検知する流速センサを含み、速度をコントローラまたはプロセッサ４０に報告することができる。次いで、コントローラまたはプロセッサ４０は、１つ又は複数の制御信号を調節し、これらを圧力源／流速制御ブロック４４に供給し、分析装置の適正な動作に合わせた所望の圧力、そして所望の流体速度を達成することができる。

【００３３】

血液およびその他の生物廃棄物は、病気を広げる可能性があるので、着脱式カートリッジ１４は、図示の血球計算チャンネル５０の下流に廃棄物槽５２を含むとよい。廃棄物槽５２は、着脱式カートリッジ１４における流動の流体を受け取り蓄積することができる。検査が完了したとき、着脱式カートリッジ１４を分析装置から取り外し、例えば、生物廃棄物と相容性のあるコンテナに廃棄することができる。

【００３４】

図３は、図２のサンプル分析装置およびカートリッジの流速制御を示す、更に詳細な模式図である。図示の例では、カバー１８の中にある圧力源／流速コントローラ４４は、４種類の制御された圧力を供給し、これらには、サンプル推進（Ｐ）圧力３６ａ、溶解（Ｌ）圧力３６ｂ、球体（ＳＰ）圧力３６ｃ、シース（ＳＨ：sheath）圧力３６ｄ、および希釈（Ｄ）圧力３６ｅが含まれる。これらは単に例示であり、これらおよりも多い圧力、少ない圧力、または異なる圧力（例えば、染料槽への染色圧力）も、用途に応じて、圧力源／流速コントローラ４４によって供給することができる。また、カバー１８が圧力源／流速コントローラ４４を全く含まない場合もあり得ることも想定している。変わりに、着脱式カートリッジ１４は、圧縮空気槽のような搭載圧力源、前述した静電作動メソ・ポンプのような１つ又は複数の微小ポンプ、あるいは所望に応じて適した圧力源であればその他のいずれでも含むことができる。光源および検出器のアレイは、図３には示されていない。

【００３５】

図示の例では、圧力源３６ａは、推進流体６５を通じて血液サンプル槽６２に圧力を供給し、圧力源４６ｂは圧力を溶解槽６４に供給し、圧力源３６ｃは圧力を球体槽６６に供給し、圧力源３６ｄは圧力をシース槽６８に供給し、圧力源３６ｅは圧力を希釈剤槽７０に供給する。

10

20

30

40

50

【0036】

例示的な一例では、各圧力源は、入力圧力を受ける第1圧力チェンバと、制御した圧力を着脱式カートリッジに供給する第2圧力チェンバとを含むことができる。第1圧力チェンバと第2圧力チェンバとの間に第1弁を設けて、第1圧力チェンバ内の圧力を制御可能に第2圧力チェンバに放出することができる。第2圧力チェンバと流体連通する第2弁が、第2圧力チェンバ内の圧力を大気に制御可能に発散することができる。これによって、圧力源／流速コントローラ44は、着脱式カートリッジ14上の圧力受入ポートの各々に、制御した圧力を供給することが可能になる。各弁は、例えば、米国特許第6,240,944号に記載されているように、個別に指定可能および制御可能な静電作動式微小弁のアレイとすることができる。この特許の内容は、ここで引用したことにより、本願にも含まれるものとする。あるいは、各弁は、制御可能なデューティ・サイクルでパルス変調され、「有効」流速および漏れ率の制御を遂行する、静電作動式微小弁のアレイでもよい。また、望ましければ、その他の弁を用いてもよい。

10

【0037】

図示の着脱式カートリッジ14は、5つの圧力受入ポート34a、34b、34c、34dおよび34eを含む、各々、圧力源／流速コントローラ44から対応する制御圧力(controlled pressure)を受ける。図示の例では、圧力受入ポート34a、34b、34c、34dおよび34eは、制御圧力を血液槽62、溶解槽64、球体槽66、シース槽68、および希釈剤槽70にそれぞれ送出する。溶解槽64、球体槽66、シース槽68、および希釈剤槽70は、着脱式カートリッジ14を使用のために出荷する前に充填しておくといいが、血液槽62は現場においてサンプル収集ポートまたはランセット32を通じて充填してもよい。

20

【0038】

図示のように、流速センサには、直列に各流体または選択した流体を供給することができる。各流速センサ80a～80eは、対応する流体の速度を測定することができる。流速センサ80a～80eは、熱風速型(thermal anemometer type)流速センサ、およびマイクロブリッジ型流速センサとすることができる。マイクロブリッジ流速センサは、例えば、米国特許第4,478,076号、米国特許第4,478,077号、米国特許第4,501,144号、米国特許第4,651,564号、米国特許第4,683,159号、および米国特許第5,050,429号に記載されている。これらの全ては、ここで引用したことにより、その内容が本願にも含まれるものとする。

30

【0039】

あるいは、または加えて、センサ80a～80eは、熱伝導性、比熱、流体密度、電気抵抗率、および／または、例えば、流体チャネルを通過する流体が予期した流体または予期した種類の流体であることを識別または検証し易くするための流体のその他の特性というような、流体の1つ又は複数の特性を検出するために用いてもよい。これによって、予期した流体が実際に、個々の分析または手順の間に流体チャネルにおいて実際に用いられていることを検証し易くすることができる。コントローラは、予期した流体が実際に流体チャネルにおいて用いられているか否か検出し、場合によっては、警報を発するおよび／またはサンプル分析装置を停止するようにプログラムすることもできる。

40

【0040】

各流速センサ80a～80eからの出力信号は、コントローラまたはプロセッサ40に供給することができる。コントローラまたはプロセッサ40は、図示のように、制御信号を圧力源／コントローラ44に供給することができる。例えば、血液サンプルに供給する圧力を制御するには、コントローラまたはプロセッサ40は、血液サンプルの速度が第1所定値未満に低下したときに、圧力源／コントローラ44における第1圧力チェンバと第2圧力チェンバとの間にある第1弁を開いて、第1圧力チェンバ内の圧力を第2圧力チェンバに制御可能に放出することができる。同様に、コントローラまたはプロセッサ40は、血液サンプルの速度が第2所定値を超えて上昇したときに、第2弁を開いて、第2圧力チェンバ内の圧力を放出することができる。コントローラまたはプロセッサ40は、溶解

50

試薬、球体化試薬、シース流体(sheath fluid)、および希釈剤の速度を同様に制御することができる。

【0041】

場合によっては、コントローラまたはプロセッサは、流体チャネルを通過する流速における1つ又は複数の変化を検出できることもある。流速の変化は、例えば、流体チャネル内における1つ又は複数の気泡、例えば、血液サンプルの凝固によって生ずる流体チャネルの閉塞または部分的閉塞、流体チャネル内における望ましくないまたは異物、および／または流体チャネルのその他の望ましくない特性に対応する場合がある。場合によっては、流速の立ち上がり時間、立ち下がり時間、またはその他の特性を用いてもよい。コントローラまたはプロセッサ40は、このような特性を流速から検出し、場合によっては、警報を発するおよび／またはサンプル分析装置を停止するようにプログラムすることもできる。

10

【0042】

熱風速型流速センサは、通例、加熱エレメントを含み、加熱エレメントは、付勢すると、1つ又は複数の熱パルスを生体内に生成する。この流速センサは、更に、1つ又は複数の熱パルスを検出するために、加熱エレメントの上流および／または下流に位置する1つ又は複数の熱センサも含む。流体チャネルを通過する流体の速度は、熱パルスが加熱エレメントから、離間した熱センサの1つまで移動するのに要する時間に関係付けることができる。

【0043】

場合によっては、熱風速型流速センサは、流体の熱伝導率および／または比熱を検出するために用いることもできる。流体の熱伝導率および／または比熱の変化は、流体の状態変化（血液サンプルの凝固）、流体内の気泡、流体内の望ましくない物体または異体等のような、流体特性の変化に対応することもあり得る。あるいは、または加えて、熱風速型流速センサは、熱電導率、比熱などのような流体の1つ又は複数の特性を検出し、例えば、流動チャネルを通過する流体が予期した流体かまたは予期しない種類の流体かを識別または検証し易くするために用いることもできる。これによって、予期した流体が実際に、個々の分析または手順の間に流体チャネルにおいて実際に用いられていることを検証し易くすることができる。場合によっては、コントローラまたはプロセッサ40は、熱風速型流速センサ付近を通過する流体の熱伝導率および／または比熱を監視することによって、流体の特性を検出してもよいことも想定している。コントローラまたはプロセッサ40は、例えば、流体内における望ましくない特性（例えば、気泡）、および／または予期した流体が実際に流体チャネルにおいて用いられているか否か検出し、場合によっては、警報を発するおよび／またはサンプル分析装置を停止するようにプログラムすることもできる。

20

30

【0044】

場合によっては、流体チャネルと流体連通して、インピーダンス・センサを設けてもよい。コントローラまたはプロセッサ40をインピーダンス・センサに結合することができる。流体のインピーダンス変化は、流体の状態変化（血液サンプルの凝固）、流体内の気泡、流体内の望ましくない物体または異体、正しい流体の種類等のような、流体特性の変化に対応することもあり得る。このように、そして例によっては、コントローラまたはプロセッサ40は、インピーダンス・センサ付近を通過する流体のインピーダンスを監視することによって、流体の特性を検出してもよいことも想定している。

40

【0045】

全体的に110で示す下流弁を設けることもできる。コントローラまたはプロセッサ40は、所望に応じて、下流弁110を開放／閉鎖することができる。例えば、下流弁110は、システムを完全に加圧するまで、閉じたままにしておくことができる。これは、システムが完全に加圧される前に、血液、溶解試薬、球体化試薬、シース流体、および希釈剤が流体回路86内に流入するのを防止するのに役立つことができる。また、下流弁110を制御して、ゼロ流速検査などのような、ある種の検査を実行する際に補助することも

50

できる。別の例では、下流弁 110 は、例えば、カバーを閉じるときに、機械的作用によって開くことができる。

【0046】

図 4 は、例示的な着脱式カートリッジのある種の特徴の模式図である。図示の着脱式カートリッジを全体的に 100 で示し、図 1 から図 3 を参照して先に示し説明した着脱式カートリッジ 14 と同様でもよい。尚、着脱式カートリッジ 100 は単なる例示に過ぎず、本例は、形態、機能、または構成には関係なく、多くの微小流体カートリッジに応用できることは言うまでもない。例えば、本例は、流動血球計算、血液学、臨床化学、血液化学分析、尿分析、血液気体分析、細菌分析、バクテリア分析、電解質測定などに合わせて構成した着脱式カートリッジに応用することができる。また、着脱式カートリッジ 100 のような、本システムの着脱式カートリッジ 100 は、適した材料または材料系であればいずれでも作ることができ、例えば、ガラス、シリコン、1 つ又は複数のポリマ、あるいは他のあらゆる適した材料または材料系、あるいは材料または材料系の組み合わせを含む。

10

【0047】

図示の着脱式カートリッジ 100 は、第 1 測定チャンネル 102 および第 2 測定チャンネル 104 を含むが、これらよりも多いまたは少ない測定チャンネルも、所望に応じて、用いることができる。図示の例では、第 1 測定チャンネル 102 は、赤血球測定チャンネルであり、第 2 測定チャンネル 104 は白血球測定チャンネルである。血液サンプル全体は、血液受入ポート 106 を通じて、着脱式カートリッジ 100 によって受け取られ、毛細管作用によって、既知の量の血液が、凝固防止被覆血液サンプル蓄積毛細管 108 に引き込まれる。図 3 のサンプル推進 (P) 圧力 36a のようなサンプル推進 (P) 圧力を、図 3 のサンプル推進流体槽 65 のようなサンプル推進流体槽に供給する。圧力を与えると、サンプル推進流体がサンプル推進流体槽から血液サンプル推進チャンネル 110 内に送り込まれる。

20

【0048】

例示的な例によっては、弁 112 および流速センサ 114 を血液サンプル推進チャンネル 110 と直列に設けることもできる。弁 112 は、流体回路を通じて血液サンプルを推進するのが望ましいときに開くように制御することができる。流速センサは、血液サンプル推進流体の流速を測定することができ、したがって凝固防止被覆毛細管を通過する際の血液サンプルの流速を測定することができる。流速センサ 114 によって供給される流速は、着脱式カートリッジ 100 に供給するサンプル推進 (P) 圧力を制御し易くするために用いることができる。

30

【0049】

図示の例では、血液サンプル全体を区分し、分岐路 116 を通じて、赤血球測定チャンネル 102 および白血球測定チャンネル 104 に共有する。図示の例でえあ、弁 118 は赤血球測定チャンネル 102 に流入する血液サンプルを制御するために分岐路と直列に設けられており、白血球測定チャンネル 104 に流入する血液サンプル流を制御するために、弁 120 が設けられている。

【0050】

具体的に赤血球測定チャンネル 102 に移ると、図 3 の球体化圧力 (SP) 36c のような、赤血球球体化試薬圧力 (SP) を、図 3 の球体化槽 66 のような、球体化試薬槽に供給する。圧力を与えると、球体化槽 66 内にある球体化試薬が球体化試薬チャンネル 124 に送り込まれる。

40

【0051】

例示的な例によっては、弁 126 および流速センサ 128 も、球体化試薬チャンネル 124 と直列に設けることもできる。弁 126 は、球体化試薬を流体回路内に推進させるのが望ましいときに開くように制御することができる。流速センサ 128 は、球体化試薬の流速を測定し、球体化試薬チャンネル 124 を通過する際の球体化試薬の流速の尺度を提示することができる。流速センサ 128 が提示する流速を用いると、圧力源/コントローラ 44 によって着脱式カートリッジ 100 に供給する球体化圧力 (SP) を制御し易くすることができる。

50

【0052】

図示の着脱式カートリッジ100の正常な機能的動作の間、球体化試薬を交差領域130に球体化試薬流速で押し込み、更に血液サンプルを交差領域130に血液サンプル流速で押し込む。血液サンプル流速および球体化試薬流速は、図3の圧力源／コントローラ44によって制御することができる。

【0053】

交差領域130は、双方の流体が流れて交差領域130を通過するときに、球体化試薬が血液サンプルの周囲に沿って流れるように構成することができる。場合によっては、球体化試薬の流速は、血液サンプルの流速よりも高くするとよく、これによって、下流の現場球体化チャンネル(sphering-on-the-fly channel)132における流動特性を改善し易く
10
することができ、更に場合によっては、血液を薄いリボン状に形成し、球体化試薬が完全かつ均一にこれを包囲し易くすることができる。このようなリボン状の流動によって、血球が現場球体化チャンネル132を通過する際に、球体化試薬が均一に赤血球を球体化し易くすることができる。更に、現場球体化チャンネル132の長さは、球体化試薬および血液サンプルの流速と合わせて、血液サンプルをしかるべき時間量の間球体化試薬に露出するように設定することができる。

【0054】

図3のシース(SH)圧力36dのようなシース流体(SH)圧力は、図3のシース流体槽68のような、シース流体槽に供給することができる。圧力を加えると、シース流体がシース流体槽68からシース・チャンネル134に送り込まれる。例示的な例によっては、弁136および流速センサ138をシース・チャンネル134と直列に設けるとよい。弁136は、シース流体を流体回路内に推進させることが望ましいときに開くように制御することができる。流速センサ138は、シース流体の流速を測定することができ、シース・チャンネル134を通過する際のシースの流速の尺度を提示することができる。流速センサ138によって提示する流速を用いると、着脱式カートリッジ100に供給するシース圧力(SH)を制御し易くすることができる。
20

【0055】

図示の例では、シース流体をシース流体の流速で交差領域140に供給し、更に球体化血液サンプルを球体化血液サンプルの流速で交差領域140に供給する。球体化血液サンプルの流速、およびシースの流速は、図3の圧力源／コントローラ44のような、圧力源／コントローラによって制御することができる。
30

【0056】

交差領域140は、双方の流体が流れて交差領域140を通過するときに、シース流体が球体化血液サンプルの周囲に沿って流れるように構成することができる。場合によっては、シースの流速は球体化血液サンプルの流速よりも遥かに高く、こうすることによって、下流の流動血球計算チャンネル142において中核の形成を改善し易くすることができる。例えば、流動血球計算用途の一部では、交差領域140は、球体化血球を流体力学的に収束し、単一の縦列中核に配列し、各赤血球が着脱式カートリッジ100内の光窓領域144を通過する際に、個々に光学的に分析装置によって呼掛けできるように構成することができる。場合によっては、血球計算チャンネル142を通過する流体を搭載廃棄物槽に向けて送出する。
40

【0057】

これより白血球測定チャンネル104に移り、図3の溶解圧力(L)36bのような、白血球溶解試薬圧力(L)を、図3の溶解槽のような溶解試薬槽に供給する。圧力を与えると、溶解槽64内にある溶解試薬が溶解試薬チャンネル154に送り込まれる。

【0058】

例示的な例によっては、弁156および流速センサ158を溶解試薬チャンネル154と直列に設けることもできる。弁156は、溶解試薬を流体回路内に推進させることが望ましいときに開くように制御することができる。流速センサ158は、溶解試薬の流束を測定し、溶解試薬チャンネル154を通過する際の溶解試薬の流束の尺度を提示することがで
50

きる。流速センサ 158 が提示する流束を用いると、圧力源／コントローラ 44 によって着脱式カートリッジ 100 に供給する溶解圧力（L）を制御し易くすることができる。

【0059】

図示の着脱式カートリッジ 100 の正常な機能的動作の間、溶解試薬を溶解試薬の流速で交差領域 160 に供給し、血液サンプルを血液サンプルの流速で交差領域 160 に供給する。血液サンプルの流速および溶解試薬の流速は、図 3 の圧力源／コントローラ 44 のような、圧力源／コントローラによって制御することができる。

【0060】

交差領域 160 は、双方の流体が流れて交差領域 160 を通過するとき、溶解試薬が血液サンプルの周囲に沿って流れるように構成することができる。場合によっては、溶解試薬の流速を血液サンプルの流速よりも高くするとよく、これによって現場溶解チャンネル 162 における流動特性を改善し易くすることができ、更に場合によっては、血液を薄いリボン状に形成し、溶解試薬が完全かつ均一にこれを包囲し易くすることができる。このようなりボン状の流動によって、血球が現場溶解チャンネル 162 を通過する際に、溶解試薬が均一に赤血球を溶解し易くすることができる。更に、現場溶解チャンネル 162 の長さは、溶解試薬および血液サンプルの流速と合わせて、血液サンプルをしかるべき時間量の間溶解試薬に露出するように設定することができる。

【0061】

図 3 のシース（SH）圧力 36d のような、シース流体（SH）圧力は、図 3 のシース流体槽 68 のような、シース流体槽に供給することができる。圧力を加えると、シース流体がシース流体槽 68 からシース・チャンネル 164 に送り込まれる。例示的な例によっては、弁 166 および流速センサ 168 をシース・チャンネル 164 と直列に設けることができる。弁 166 は、シース流体を流体回路内に推進させることが望ましいときに開くように制御することができる。流速センサ 168 は、シース流体の流速を測定し、シース・チャンネル 164 を通過する際のシースの流速の尺度を提示することができる。流速センサ 168 が提示する流速を用いると、着脱式カートリッジ 100 に供給するシース圧力（SH）を制御し易くすることができる。場合によっては、シース・チャンネル 164 を通過する際のシースの流速は、シース・チャンネル 134 を通過する際のシースの流速と同一である。しかしながら、その他の場合では、シース・チャンネル 164 を通過する際のシースの流速は、シース・チャンネル 134 を通過する際のシースの流速とは異なる場合もある。

【0062】

図示の例では、シース流体をシース流体の流速で交差領域 170 に供給し、溶解血液サンプルを溶解血液サンプルの流速で交差領域 170 に供給する。溶解血液サンプルの流速、およびシースの流速は、図 3 の圧力源／コントローラ 44 のような、圧力源／コントローラによって制御することができる。

【0063】

交差領域 170 は、双方の流体が流れて交差領域 170 を通過するとき、シース流体が溶解血液サンプルの周囲に沿って流れるように構成することができる。場合によっては、シースの流速は溶解血液サンプルの流速よりも遥かに高く、こうすることによって、下流の流動血球計算チャンネル 172 における中核の形成を改善し易くすることができる。例えば、流動血球計算用途によっては、交差領域 170 は、溶解血液サンプル内の白血球を流体力学的に収束し、単一の縦列中核に配列し、各白血球が着脱式カートリッジ 100 内の光窓領域 174 を通過する際に、個々に光学的に分析装置によって呼掛けできるように構成することができる。場合によっては、血球計算チャンネル 172 を通過する流体を搭載廃棄物槽に供給する。

【0064】

場合によっては、吸収測定チャンネルも設けることができる。図示の例では、溶解血液サンプルの一部を吸収チャンネル 180 に供給する。溶解血液サンプルの一部を選択的に吸収チャンネルまたは領域 184 に通過させるために、弁 182 を設けることもできる。分析装置は、吸収チャンネルまたは領域 184 を照明する光源、および吸収チャンネルまたは領域 1

10

20

30

40

50

84内にあり溶解血液サンプルによって吸収されない光を検出する検出器を含むことができる。そして、分析装置は、吸収度を判定することができ、これから、正味の吸収(bulk absorption)に基づいたヘモグロビン測定を行うことができる。場合によっては、そして図8に示すように、所望であれば、吸収チャンネル184を血球計算チャンネル172の下流に配置してもよい。別の場合には、白血球サンプルを直接、分岐路116からというように、吸収チャンネルに供給することもできる。かかる場合、吸収チャンネルは、吸収測定を行う前に、赤血球を溶解するメカニズムを含むとよい。図示の着脱式カートリッジ100は、血液サンプル全体に対する全血球計数(CBC)分析を実行するように構成されているが、他の種類の着脱式カートリッジ構成および分析も、所望に応じて、用いてもよいことを想定している。

10

【0065】

図5は、着脱式カートリッジの中に含むことができる多数の例示的な貯蔵槽の模式図である。図示の例では、図4の着脱式カートリッジ100のような着脱式カートリッジは、例えば、溶解試薬槽64、推進流体槽65、球体化試薬槽66、シース流体槽68、希釈剤流体槽70、染料槽190、および廃棄物槽52を含むことができる。これらは一例に過ぎず、これらよりも多いまたは少ない槽、あるいは異なる槽を着脱式カートリッジ上または内部に設けてもよく、あるいは槽を設けなくてもよい。

【0066】

各槽は、着脱式カートリッジの所望の動作をサポートするような大きさとし、しかるべき量の流体および／または試薬を含むとよい。希釈剤槽70は、血液サンプル全体という

20

【0067】

図6は、着脱式カートリッジを用いて血液サンプルを分析するための例示的な手法を示す模式流れ図である。図示の手法では、最初にステップ200において血液サンプルを取り込む。次に、血液サンプルを着脱式カートリッジの中にある凝固防止被覆毛細管に供給する。次いで、血液サンプルを区分し、赤血球および血小板(RBC/P)測定チャンネル204および白血球(WBC)測定チャンネル206に供給する。

30

【0068】

RBC/P測定チャンネル204では、最初に、212に示すように、赤血球を球体化し、次いで流体力学的に収束し、着脱式カートリッジ内にあるRBC/P血球チャンネル214に向けて、単一の縦列で供給する。縦型空洞面発行レーザ(VCSSEL)のような光源216が、個々のセルがRBC/P血球計算チャンネル214の分析領域付近を通過する際に、これらに光を照らす。場合によっては、VCSSELデバイスのアレイを設け、個々の血球がRBC/P血球計算チャンネル214の分析領域付近を通過する際に個々の血球と整列するVCSSELのみを活性化させる。VCSSELが供給する入射光の一部を散乱させ、検出器218はこの散乱光を検出する。場合によっては、検出器218は前方角度散乱光(FALS: forward angle scatter light)、小角度散乱光(SALS)、および大角度散乱光(LALS)を検出することもできる。

40

【0069】

場合によっては、1つの細長い線状光源または2つの別個のスポット光源のような、レーザ(またはその他の)源をRBC/P血球計算チャンネル214に合焦させる。合焦した光を、RBC/P血球計算チャンネル214におけるRBCおよび血小板が通過する。高品質の収集光学素子を用いて、血球の鮮鋭な画像、および合焦した照明を不透明な画面上に形成する。画面には、1本、2本またはそれ以上の平行なスリットが入っており、

50

その縦軸は、R B B C / P 血球計算チャンネル 2 1 4 における流動方向に対して直交するように配置されている。スリット間の距離は、例えば、R B C / P 血球計算チャンネル 2 1 4 において予期される平均血球分離程度とすればよい。スリットが入っている不透明な画面は、1 つ又は複数の検出器 2 1 8 の前方に置くとよい。血球の画像がスリット上を通過すると、スリットに入射する光を遮り、検出器 2 1 8 上の信号を減少させ、血球の直径に比例する幅を有するパルス波形を生成する。2 本の離間したスリットを設ける場合、2 つの波形によって、血球の流動速度、そして血球のサイズを計算することが可能になる。この技法を用いると、高い信号対ノイズ比を得ることができ、これによってイベントの容易な計数、および多重血球イベントの識別が可能になる。パルス幅および振幅によって、更に、一部の血球の種類を判別することも可能になる。

10

【0070】

場合によっては、血球および光源双方の画像を、検出器 2 1 8 の前方に置かれた二重スリット・アパーチャ上に撮像する。二重スリット・アパーチャは、セルを計数するために、厳密に定義した幾何学的アパーチャおよび高い信号対ノイズ比を備えている。先に論じたように、スリットからの信号によって、血球の流動速度を精度高い測定が可能となり、このために血球の直径を計算することが可能になる。

【0071】

場合によっては、そして 2 2 0 に示すように、この分析の間に多数のパラメータを測定することができ、例えば、サンプル流速 (F R)、測定時間 (T) 期間、およびサンプル希釈係数 (D F) を含む。検出器の出力、および／または対応する散乱シグネーチャ (signature) を監視することにより、赤血球数 ($N_{R B}$)、血小板数 ($N_{p l t}$)、各血球の直径 ($d_{r b c}$)、および各血球のヘモグロビン濃度を測定することができる。

20

【0072】

これらのパラメータから、そして 2 8 2 に示すように、多数の赤血球分析パラメータを計算することができ、例えば、赤血球計数 ($RBC = N_{R B} / (D F \times F R \times T)$)、血小板計数 ($Plt = N_{p l t} / (D F \times F R \times T)$)、平均血球ヘモグロビン濃度 ($MCHC = \langle CHC \rangle$)、平均血球体積 ($MCV = (\pi / 6) \times \langle drbc^3 \rangle$)、平均血球ヘモグロビン含有量 ($MCH = (\pi / 6) \times \langle drbc^3 \times CHC \rangle$)、相対的分散幅 ($RDW = [(\pi / 6) \times \langle drbc^3 \rangle / MCV]$ の標準偏差)、ヘマトクリット係数 ($Het = RBC \times MCV$)、および／またはヘモグロビン濃度 ($Hb = MCHC \times Hct$) を含む。

【0073】

図示の W B C 測定チャンネル 2 0 6 では、2 3 2 に示すように、最初に赤血球を溶解し、次いで流体力学的に収束し、着脱式カートリッジの中にある W B C 血球計算チャンネル 2 3 4 に向けて、単一の縦列で供給する。縦型空洞面発行レーザ (V C S E L) のような光源 2 3 6 が、個々のセルが W B C 血球計算チャンネル 2 3 4 の分析領域付近を通過する際に、これらに光を照らす。場合によっては、V C S E L デバイスのアレイを設け、個々の血球が W B C 血球計算チャンネル 2 3 4 の分析領域付近を通過する際に個々の血球と整列する V C S E L のみを活性化させる。V C S E L が供給する入射光の一部を散乱させ、検出器 2 3 8 はこの散乱光を検出する。場合によっては、検出器 2 3 8 は前方角度散乱光 (F A L S : forward angle scatter light)、小角度散乱光 (S A L S)、および大角度散乱光 (L A L S) を検出することもできる。場合によっては、そして 2 4 0 に示すように、分析の間に多数のパラメータを測定することができ、例えば、軸状血球体積、総 W B C 計数数、および W B C 5 部分画 (five part differentiation) が含まれる。

30

40

【0074】

図 7 は、多数の赤血球パラメータを得るための例示的な手法を示す流れ図である。図示の手法では、ステップ 2 6 0 において血液サンプルを取り込む。次に、2 6 4 に示すように、血液サンプルを所望の希釈係数 (D F) まで希釈し、球体化する。次に、希釈し球体化した血球を流体力学的に収束し、着脱式カートリッジの中にある R B C / P 血球計算チャンネルに向けて、単一の縦列で供給する。縦型空洞面発行レーザ (V C S E L) のような光源 2 1 6 が、個々のセルが R B C / P 血球計算チャンネルの分析領域付近を通過する際に、これらを光で照らす。V C S E L が供給する入射光の一部を散乱させ、検出器によって

50

この散乱光を検出する。場合によっては、検出器は、セル毎に前方角度散乱光 (FALS) および小角度散乱光 (SALS) を検出することもできる。次いで、以下のように、プロセッサ等が2つの独立した散乱パラメータ、即ち、SALSおよびFALSを、セル毎に、セル直径パラメータおよびセル・ヘモグロビン濃度パラメータにマッピングすることができる。

$\{S_{SALS_i}, S_{FALS_i}\} \rightarrow \{drbc_i, CHC_i\}$

270に示すように、散乱 S_{SALS_i} および S_{FALS_i} の強度が所定の検出閾値以下である場合、制御をステップ268に戻す。しかしながら、散乱 S_{SALS_i} および S_{FALS_i} の強度が所定の検出閾値よりも大きい場合、制御をステップ272に移す。ステップ272では、 S_{SALS_i} および S_{FALS_i} の合計が所定の血小板閾値よりも大きい
10
か否か判定を行う。 S_{SALS_i} および S_{FALS_i} の合計が所定の血小板閾値よりも大きくない場合、粒子「i」が血小板であると判定し、制御をステップ274に移す。ステップ274では、計数した血小板の数 (N_{plt}) を1だけ増分し、制御を再度ステップ268に移す。

【0075】

S_{SALS_i} および S_{FALS_i} の合計が所定の血小板閾値よりも大きい場合、血球は赤血球であり、制御をステップ276に移す。ステップ276では、計数した赤血球数 (N_{RBC}) を1だけ増分し、制御をステップ278に移す。ステップ278では、所定の測定時間に達したか否か判定を行う。達していない場合、制御を再度268に移す。

【0076】

一旦ステップ278において測定時間に達した場合、制御をステップ280に移す。ステップ280は、多数の測定したパラメータを示し、例えば、サンプル流速 (FR)、測定時間 (T) 期間、およびサンプル希釈係数 (DF) を含む。検出器の出力、および／または対応する散乱シグネチャ(signature)を監視することにより、赤血球数 (N_{RBC})、血小板数 (N_{plt})、各血球の直径 ($drbc_i$)、および各血球のヘモグロビン濃度 (CHC_i) を測定することができる。これらのパラメータから、そして282に示すように、多数の赤血球分析パラメータを計算することができ、例えば、赤血球計数 ($RBC = N_{RBC} / (DF \times FR \times T)$)、血小板計数 ($Plt = N_{plt} / (DF \times FR \times T)$)、平均血球ヘモグロビン濃度 ($MCHC = CHC_i$)、平均血球体積 ($MCV = (\pi/6) \times drbc_i^3$)、平均血球ヘモグロビン含有量 ($MCH = (\pi/6) \times drbc_i^3 \times CHC_i$)、相対的分散幅 ($RDW = [(\pi/6) \times drbc_i^3] / MCV$ の標準偏差)、ヘマト
20
30
クリット係数 ($Hct = RBC \times MCV$)、および／またはヘモグロビン濃度 ($Hb = MCHC \times Hct$) を含む。ここで、表記 $\langle X_i \rangle$ は全ての血球 X_i についての平均血球パラメータを意味する。

【0077】

図8は、血液サンプルを分析するための別の例示的な手法を示す模式流れ図である。この図示の手法では、ステップ300に示すように、血液サンプルを取り込み、血液サンプル・槽に供給する。次に、着脱式カートリッジの中にある凝固防止被覆毛細管に血液サンプルを供給し、希釈する。次いで、血液サンプルを区分して、赤血球および血小板 (RBC/P) 測定チャネル304および白血球 (WBC) 測定チャネル340に供給する。

【0078】

RBC/P測定チャネル304では、最初に、306に示すように、赤血球を球体化し、次いで流体力学的に収束し、着脱式カートリッジ内にあるRBC/P血球チャネル308に向けて、単一の縦列で供給する。縦型空洞面発行レーザ (VCSEL) および付随する光学素子のような第1光源310が、個々のセルがRBC/P血球計算チャネル308の分析領域付近を通過する際に、これらに光を照らす。場合によっては、VCSELデバイスのアレイを設け、個々の血球がRBC/P血球計算チャネル308の分析領域付近を通過する際に個々の血球と整列するVCSELのみを活性化させる。

【0079】

個々の球体／粒子が、合焦した入射光ビームを通過する際、光の一部が遮断、散乱、またはそれ以外の妨害を受け、検出器 (図示せず) によって検出することができる。2つ又は3つ以上の光源を、RBC/P血球計算チャネル308に沿って離間した異なるスポッ
40
50

トに合焦すると、各結晶の先端および／または後端を検出することができる。結晶が1つの合焦スポットから次の合焦スポットまでの距離を横断する際に要する時間を測定することによって、流速、したがって血球の速度を判定することができる。血球の速度を判定したなら、血球が遮断、散乱、またはそれ以外の妨害を行う時間長を、血球のサイズおよび／または血球の体積に相関付けることができる。

【0080】

例によっては、別の光源314および付随する光学素子を分析装置によって設けることもできる。光源314の付随する光学素子は、光を平行化して、SALSおよびFALS散乱のような、軸はずれ散乱を測定することができる。先に注記したように、SALSおよびFALS散乱は、例えば、赤血球数(N_{RBC})316、血小板数(N_{Plt})322、各血球の直径(d_{rbc_i})、および各血球のヘモグロビン濃度(CHC_i)を測定することができる。これらのパラメータから、そして先に論じたように、多数の赤血球分析パラメータを計算することができ、例えば、赤血球計数($RBC=N_{RBC}/(DF \times FR \times T)$)、血小板計数($Plt=N_{Plt}/(DF \times FR \times T)$)、平均血球ヘモグロビン濃度($MCHC=<CHC_i>$)、平均血球体積($MCV=(\pi/6) \times <d_{rbc_i}^3>$)、平均血球ヘモグロビン含有量($MCH=(\pi/6) \times <d_{rbc_i}^3 \times CHC_i>$)、相対的分散幅($RDW=[(\pi/6) \times <d_{rbc_i}^3>]/MCV$)の標準偏差)、ヘマトクリット係数($Hct=RBC \times MCV$)、および／またはヘモグロビン濃度($Hb=MCH \times Hct$)を含む。ここで、表記 $<X_i>$ は全ての血球 X_i についての平均血球パラメータを意味する。

【0081】

図示のWBC測定チャンネル340では、342に示すように、赤血球を溶解し、適宜染料を注入する。次いで、血球を流体力学的に収束し、次いで流体力学的に収束し、着脱式カートリッジ内にあるWBBC血球チャンネル344に向けて、単一の縦列で供給する。縦型空洞面発行レーザ(VCSSEL)のような光源346が、個々のセルがWBC血球計算チャンネル308の分析領域付近を通過する際に、これらに光を照らす。場合によっては、VCSSELデバイスのアレイを設け、個々の血球がWBC血球計算チャンネル344の分析領域付近を通過する際に個々の血球と整列するVCSSELのみを活性化させる。

【0082】

個々の球体／粒子が、合焦した入射光ビームを通過する際、光の一部が遮断、散乱、またはそれ以外の妨害を受け、検出器(図示せず)によって検出することができる。2つ又は3つ以上の光源を、RBC/P血球計算チャンネル344に沿って離間した異なるスポットに合焦すると、各結晶の先端および／または後端を検出することができる。結晶が1つの合焦スポットから次の合焦スポットまでの距離を横断する際に要する時間を測定することによって、流速、したがって血球の速度を判定することができる。血球の速度を判定したなら、血球が遮断、散乱、またはそれ以外の妨害を行う時間長を、血球のサイズおよび／または血球の体積に相関付けることができる。

【0083】

例によっては、別の光源350および付随する光学素子を分析装置によって設けることもできる。354に示すように、光源350の付随する光学素子は、光を平行化して、SALSおよびFALS散乱のような、軸はずれ散乱を測定することができる。先と同様、356に示すように、SALS、FALS、およびLAFS散乱を用いると、例えば、計数した白血球数(N_{WBC})352を測定し、更に白血球の分画に役立てることができる。場合によっては、1つ又は複数の偏光板を設けて、光源が供給する光を偏光させ、検出した偏光の消失／回転のレベルを用いると、白血球の分画を行い易くすることができるが、これは全ての例において必要な訳ではない。

【0084】

図示の例では、WBC血球計算チャンネル344から出た血球は、バルク吸収チャンネル360に供給することができる。光源362が、吸収チャンネル360内にある血球に光を当てることができ、検出器364が、残留する血球によって吸収されない光を検出することができる。このように、吸収チャンネル360は、残留する血球の全部の吸収レベルを測定するために用いることができる。吸収レベルは、例えば、血液サンプルにおけるバルクま

たは平均血球ヘモグロビン濃度の尺度を提示することができる。ヘモグロビン・チャンネルは、照準決め直し(re-zeroing)光学素子ならびに自動合焦および／または位置合わせを有することができる。光源 3 6 2 は、吸収ピークの中心付近に出力を有する L E D とするとよく、こうするとフィルタを不要にすることができる。ヘモグロビンに関して評価すべきサンプルを受け取り、保持するために、クヴェット(curvette)があってもよい。カード上に湿度センサおよび温度センサを設け、これらのパラメータに関するカードの現在および過去の状態を示すことができる。カードの暖機および冷却の時間は、動作の初期化以前におけるその温度を示すことができる。このような状態の監視は、カード上の物質および溶液と関連がある場合がある。これらの状態の知識は、構造的剥離(de-lamination)を有するカードまたはカートリッジの可能性をなくすまたは大幅に低下させるセーフガードに関して実装するとよい。

10

【0085】

図 9 a から図 9 f に示すインターフェースによって、汚染のない流体の転送および移動を達成することができる。一旦計器上にある着脱式カートリッジに試薬を納めたなら、試薬槽から有来界面までの各供給ラインにおける流体の圧縮率が問題となる場合がある。忠実性が高い流体の流速制御を得るためには、この問題を最小限に抑えなければならない。圧縮率は、温度変化の間に溶液から出てくる溶融気体、または供給ラインの気体浸透性壁を通して内部に拡散する空気のいずれかによって発生する気泡による場合がある。この問題を解消する 1 つの手法は、試薬のような気泡を含む溶液を、計器の流体界面から、例えば、試薬カートリッジ上にある廃棄物タンクに導くことができる弁に引き込み、これを新鮮な流体と置換することが考えられる。一旦気泡を再度吸収し、廃棄物に一気に流し去れば、弁を再度切り換えて、流体／空気メニスカスを流体界面に戻すことができる。メニスカスを流体界面近くまで戻した後、解決すべき別の問題は、血液サンプルによる計器汚染の潜在的可能性であろう。サンプル血液および試薬に接触せずに、接触を制御しながら、その流動を制御するために、様々な解決策を提供することができる。

20

【0086】

図 9 a および図 9 b に示すニードル-隔膜界面では、ニードル 1 2 0 1 が隔膜 1 2 0 2 を突き刺し、計器上に貯蔵されている液体をチャンネル 1 2 0 3 カード 1 2 0 4 に配給することができる。計器上に流速センサおよびコントローラを配置するとよい。ニードル 1 2 0 1 を引っ込めたときの分析(assay)の終了時に、隔膜 1 2 0 2 は自己密閉し(self-seal)、カードには漏れがなく廃棄する準備が整う。この手法は、計器上に貯蔵されている試薬をカード 1 2 0 4 に導入するにはうまく行くと考えられるが、サンプル血液は既にカード上にあり、ニードルが一旦隔膜 1 2 0 2 を突き刺すと、血液に接触することになる。除芯なく隔膜を突き刺すために、特別に先端を折り曲げたニードル 1 2 0 1 をするとよい。

30

【0087】

実際には、ニードル 1 2 0 1 の汚染は、様々な理由により、最少で済み、克服することができる。分析の間、推進流体がニードルの内側に一気に流れ込む。分析の終了時には、ニードルが引っ込められると、ニードル 1 2 0 1 の外側を隔膜 1 2 0 2 によって拭うことができる。ニードル 1 2 0 1 の規模が小さいので、その先端の表面積に保持することができる血液の量を制限することができる。計器によるニードル先端の加熱除菌は、は、ニードルの小さなサイズ、および熱転送ピンに対する幾何学的類似性のために、非常に素早い加熱／冷却サイクルとすることができる。除菌手順は、実験で証明することができる。また、通常時にオフとなっている弁を用いれば、電力停止の間いずれの流体の計器への逆流も防止することができる。

40

【0088】

図 9 c および図 9 d のシャフト-膜界面について注記しておくとうよいであろう。この手法では、長く薄いサンプル・ループを、エラストマ膜 1 2 0 6 で一旦を密閉した、円筒形サンプル貯蔵空洞と交換することができる。膜 1 2 0 6 は、成形したケース 1 2 0 7 およびサンプル槽 1 2 0 8 上に配置することができる。サンプルを分与するために、微小ステッパ・モータによって回転するリード・スクリューを、膜に対抗して前進させる。これは

50

、本質的に、シリンジ・ポンプとすればよく、プランジャをシリンジ・バレルの中に前進させる代わりに、シャフト 12055 を膜 1206 に対抗して前進させる。この手法の利点は、膜 1206 が汚染の問題を解消することができる物理的障壁にある。

【0089】

この手法は、カードを計器に実装した後に、シャフト 1205 のゼロ変位を求めなければならない場合がある（即ち、丁度膜 1206 に接触する）。サンプル貯蔵空洞の容積変化応答があるとする、恐らく非線形であり、シャフトの変位および較正が必要となる。シャフト 1205 の先端は、変位の効率性を求めて設計することができる。シャフトの最大ストロークで、貯蔵空洞内にあるサンプルを 80 パーセント配給することが現実的であると考えられる。膜 1206 には、指が偶然にも膜を圧迫／作動させてサンプルを分与できない程度の十分な凹陷を設ける必要がある。

10

【0090】

膜－膜界面を図 9 e および図 9 f に示すことができる。この手法でも、再度、エラストマ膜で一端を閉じた円筒形の槽に、サンプルを貯蔵することができる。膜 1206 の変位は、アクチュエータ 1211 によって発生させることができる。アクチュエータ 1211 は、その先端を閉鎖する膜 1212 を有する。2 枚の膜 1206 および 1212 が既に接触している場合、作動流体 1213 をアクチュエータ 1211 の先端に圧送すると、膜 1212 および 1206 双方が変形し、サンプル槽 1208 において等しい体積の流体を変位させることができる。

20

【0091】

この手法のいくつかの利点は、明白であると思われる。流速センサ技術を用いると、作動流体 1213 の流速を制御することができ、究極的にサンプルの流速を制御することになる。作動は流体主導のため、膜 1206 および 1212 は自然に高い変位効率を得られるように変形し易くなる。また、この手法は、血液サンプルを物理的な膜の背後に隠すことによって、汚染を排除することもできる。

【0092】

この手法では、カードを計器に実装した後、血液サンプルを全く変位させなくても膜 1212 および 1206 が正しく接触しているように、ゼロ変位を求める必要がある場合がある。サンプル貯蔵空洞 1208 における体積変化応答は、恐らく多少非線形であり、アクチュエータ膜 1212 の体積変化および較正が必要となる。カード上の膜 1206 は、指が偶然にも膜を圧迫／作動させてサンプルを分与できない程度の十分な凹陷を設ける必要がある。

30

【0093】

図 9 e および図 9 f のサンプル・ループは、長く狭いチャネルではなく、浅い円筒形の空洞である。最初に膜 1212 および 1206 間で正しい接触がなされれば（即ち、空気をこれらの間に取り込まない）、展開する作動流体 1213 の体積が、較正することができる反復可能な量だけ、膜を歪曲させることができる。

【0094】

膜界面間には動力学があると考えられる。エラストマ膜によって導入されるコンプライアンスは小さくすべきである。何故なら、シリコン・ラバーや Neoprene のような、典型的なエラストマのポアソン率は、0.45 から 0.50 の範囲に納まる傾向があり、これはほぼ圧縮不可能である。本質的に、エラストマは変形可能であるが、圧縮可能ではなく、これらの形状は用意に変化するが、その体積は変化しない。つまり、膜－膜界面では、成形したケースおよびアクチュエータの硬質材料がエラストマの形状変化を制限し、エラストマの低コンプライアンスからの大きな動的硬化は生じないはずである。

40

【0095】

膜 1206 の歪曲では、貯蔵空洞内に収納されているサンプルまたは試薬の全てを分与することはできない。分与する割合は、変位効率によって特徴付けることができる。 $\varepsilon = 80$ パーセントの効率が正当であろう。膜歪曲の空洞直径に対する比率も想定すると（例えば、 $\delta = 1/3$ ）、変位体積は、近似的に次のようになる。

50

$$V_{\text{disp}} = \varepsilon \delta (\pi/4)d^3$$

貯蔵空洞の直径は、次の式から推定することができる。

$$d = ((4V_{\text{disp}}/(\varepsilon \delta \pi))^{1/3}$$

図 9 g の表は、分析を 4 分間行い、その半分を R B C の測定、半分を W B C の測定に費やすと仮定した場合に、サンプル推進流体および試薬の各々に適当と思われる、貯蔵空洞の直径を纏めた。球体化溶液およびシース溶液用のカード上試薬貯蔵空洞のサイズは、十分な大きさのカードについて考慮するとよい。

【0096】

計器内に収納されている試薬貯蔵カートリッジからニードルー隔膜界面によって試薬を供給することに対して、大きな利点があると考えられる。計器上に小型の滅菌メカニズムを設けることができれば、血液サンプルは、膜型界面またはニードルー隔膜界面のいずれかによって制御することができる。

【0097】

図 10 は、サンプル分析装置を設定し動作させるための例示的な手法を示す模式流れ図である。図示の例では、351 に示すように、血液分析カートリッジを用いて分析することができ、370 に示すように、制御カートリッジを用いて分析し、分析装置の性能を検証するのに役立てることができる。および／または 380 に示すように、較正カートリッジを用いて分析し、分析装置を較正し易くすることができる。血液分析カートリッジは、血液分析を行う毎に、装填するとよい。372 において制御カートリッジを装填し、374 において、1 日 1 回というように、周期的に動作させて、分析装置が精度高い結果を出していることを検証するとよい。376 において、計器は、測定値が範囲内に納まるか否かの指示を表示することができる。指示は、測定値が正常、低、または高範囲のいずれであるかによって異なるとよい。380 では、382 において較正カートリッジにキャリブレーションを装填し、384 において動作させることができる。計器は、386 において、較正と一致するように、較正係数を調節することができる。較正カードは、分析装置を再較正するために、3 カ月に 1 回というように、制御カードよりも低い頻度で分析装置に装填すればよい。較正は、流動チャンネルにおいて暫定的または後処理精密ビードを流して、チャンネルを通過する粒子のサイズの情報を提供するパルス幅のスケーリングのようなことを提示することができる。

【0098】

各カートリッジは、対応する機能を実行するために必要な流体および／または較正部品の全てを含むことができる。したがって、分析器を動作させるおよび／または保守するためには殆ど訓練を必要としないと考えられるが、それでもなお精度の高い結果が得られる。サンプル分析器に、着脱式および／または使い捨てカートリッジを設けることができ、特別な訓練を受けていない要員でも、実験室環境の外側でも信頼性高く用いることができるので、コストおよび医療要員の負担が減少し、比較的頻繁な血液監視／分析を必要とする患者を含む、多くの患者にとってサンプル分析装置の利便性が高まる。本システムは、試薬および／またはサンプル流体が役に立たない、新鮮でない、汚染されている、正しくない、あるいはそれ以外で不適切または容認できないか否かについて注視することができる。本システムによって結果的に行われる作用は、分析を実行しないこと、結果を提示しないこと、誤りの指示を提示すること等を含むことができる。

【0099】

351 に示すように血液分析カートリッジを用いると、353 および 355 に示すように、血液サンプルを収集し、血液分析カートリッジに装填することができる。血液サンプルは、所望に応じて、毛細管作用または手作業による圧送によって、血液分析カートリッジに引き込むことができる。次いで、血液分析カートリッジを分析計器に装填することができる。図示の例では、次に、357 に示すように、分析装置は血液分析カートリッジおよび分析装置の対応する構成部品（例えば、光源／光検出器など）を自己整合することができる。次に、1 つ又は複数のボタンを押下して、血液分析プロセスを開始することができる。ボタン等を押下する代わりに、そして場合によっては、単純にカートリッジを分析

装置に装填するステップが、分析装置に整合および血液分析プロセスを開始させるようにしてもよい。

【0100】

358において、カードを動作させることができる。一旦分析装置を活性化したなら、分析装置は多数の検査を実行することができる。例えば、分析装置は血液分析カード上にある弁を全て閉鎖し、カード上にある種々の流体ポートに圧力を加えることができる。次いで、分析装置は、カード上において1つ又は複数の流速センサを通過する際の流速を測定することができる。弁が全て閉じているので、流速は0のはずである。しかしながら、流速センサが0でない流速を示す場合、分析装置は、流速センサを0流速に再較正することができる。これは、流速センサの測定値の精度を高めるのに役立つことができる。分析装置は、必要に応じて、気泡除去手法をチェックし、実行に移すことができる。あるいは、または加えて、分析装置は、例えば、血液サンプルの流速を、加えられた圧力と共に測定することによって（例えば、流速センサを用いて）、着脱式カートリッジにおける血液の凝固をチェックすることができ、加えられた圧力に対して、流速が低すぎる場合、血液サンプルが凝固していると判定する。血液の凝固が検出された場合、分析装置は、測定に失敗したことをしめすメッセージを表示することができる。

10

【0101】

次に、分析装置は、血液分析カートリッジ・タイミング・プロトコルを実装することができる。この血液分析カートリッジ・タイミング・プロトコルは、2004年9月2日出願された米国特許出願第10/932,662号に示され記載されているものと同様とすることができる。この特許出願は、本願の譲受人に譲渡され、ここで引用したことにより、その内容は本願にも含まれるものとする。個々の血液分析カートリッジ・タイミング・プロトコルは、血液分析カートリッジの特定の設計によって異なる場合もある。また、分析装置は、血液分析カートリッジ上のいずれの血球計算チャンネルにも安定した中核流があることを検証し、存在する場合には、中核流の場所を特定することもできる。

20

【0102】

次いで、血液分析カートリッジは、血液サンプルの内白血球測定に用いる一部における赤血球を溶解し、血液サンプルの内白血球測定に用いる一部における赤血球を球体化し、血液分析カートリッジ上のいずれの血球計算チャンネルにおいても中核流を形成し、および／またはその他のいずれの望ましい機能も実行することができる。分析装置は、いずれかの血球計算チャンネルのような、血液分析カートリッジの選択領域に光を供給し、この選択領域を通過した光を検出することができる。

30

【0103】

これから、分析装置は、白血球、赤血球、血小板のような、サンプル内にある粒子を計数し分類し、次いで血液分析の結果を表示、印刷、発音、またはそれ以外でユーザに指示することができる。例によっては、分析装置は定量的結果（例えば、既定の範囲の内側および／または外側）を表示または印刷し、ユーザがそれ以上計算や解釈をせずに済むようにする。測定は、完了したと見なされ、361において結果を表示する。最後に、363において、血液分析カートリッジを分析装置から取り外し、処理する。

【0104】

370に示すように制御行程(control run)を実行する場合、制御カートリッジを用いることができる。場合によっては、1日1回または1週間に1回というように、制御行程を周期的に実行するとよい。制御カートリッジは、特性が分かっている制御サンプルを含むことができる。つまり、制御サンプルに対して分析装置によって分析を行う場合、既知の結果が得られるはずである。図示の手法では、372に示すように、分析装置に制御カートリッジを装填する。次に、374に示すように、分析装置を活性化し、376に示すように、分析装置は分析を実行し結果を表示する。例によっては、分析装置は、定量的結果（例えば、既定の範囲の内側および／または外側）を表示または印刷し、ユーザがそれ以上計算や解釈をせずに済むようにする。最後に、制御カートリッジを分析装置から取り外し、処理することができる。制御行程の結果が既定の範囲から外れる場合、較正行程3

40

50

80のような、較正行程を実行することが望ましい場合がある。

【0105】

380に示すように較正行程を実行する場合、較正カートリッジを用いることができる。場合によっては、1日1回または1週間に1回というように、較正行程を周期的に実行するとよい。較正カートリッジは、特性が分かっている較正サンプルを含むことができる。つまり、較正サンプルに対して分析装置によって分析を行う場合、既知の結果が得られるはずである。図示の手法では、382に示すように、分析装置に較正カートリッジを装填する。次に、384において、分析装置を活性化し、多数の結果を得る。較正行程中に得られた結果を期待結果と比較することによって、分析装置は目盛内にある1つ又は複数の較正係数を自動的に調節して分析装置を較正し直し、後続の行程中に、386に示すように、分析装置が期待結果または所望の結果を生成するようにする。

10

【0106】

図11aは、サンプル分析装置を動作させるための例示的な手法を示す流れ図である。図示の手法を全体的に400で示し、402において開始する。制御をステップ404に移し、血液サンプルを使い捨て流体カートリッジに供給する。次いで、制御をステップ406に移し、使い捨て流体カートリッジを血液サンプル分析装置に挿入する。次いで、制御をステップ408に移す。ステップ408では、血液サンプル分析装置を活性化し、ステップ410において、これ以上血液サンプル分析装置のユーザからの相互作用は全くなき、血液サンプル分析装置から血液分析結果を入手する。次いで、制御をステップ412に移し、本手法を終了する。

20

【0107】

図11bは、サンプル分析装置を動作させるために別の例示的な手法を示す流れ図である。図示の手法を全体的に500で示し、ステップ502にて開始する。制御をステップ504に移し、血液サンプルを使い捨て流体カートリッジに供給する。次いで、制御をステップ506に移し、使い捨て流体カートリッジを血液サンプル分析装置に挿入する。次いで、制御をステップ508に移す。ステップ508では、血液サンプル分析装置を活性化し、ステップ510において、これ以上血液サンプル分析装置のユーザからの相互作用は全くなき、血液サンプル分析装置から血液分析結果を入手する。次いで、制御をステップ512に移す。ステップ512では、血液分析結果が既定の範囲内に納まっているか否か判定を行う。先に示したように、そして例によっては、分析装置は、定量的結果（例えば、既定の範囲の内側および／または外側）を表示または印刷し、ユーザがそれ以上計算や解釈をせずに済むようにする。次いで、制御をステップ514に移し、本手法を終了する。

30

【0108】

図12は、サンプル分析装置を動作させるための別の例示的な手法を示す流れ図である。この手法を全体的に600で示し、ステップ602にて開始する。図示の手法では、604に示すように血液分析カートリッジを用いて分析することができ、620に示すように、制御カートリッジを用いて分析し、分析装置の製法を検証する際に役立てることができる。血液分析を実行する度に、血液分析カートリッジを装填すればよい。制御カートリッジは、分析装置が精度高い結果を出していることを検証するために、1日1回というように、周期的に分析装置に装填することができる。較正カートリッジは、分析装置を較正し直すために、3カ月に1回というように、それよりは少ない頻度で、またはそうでなければ必要に応じて、分析装置に装填すればよい。

40

【0109】

各種類のカートリッジは、対応する機能を実行するために必要な流体および／または構成部品の全てを含むことができる。したがって、分析器を動作させるおよび／または保守するためには殆ど訓練を必要としないと考えられるが、それでもなお精度の高い結果が得られる。サンプル分析器に、着脱式および／または使い捨てカートリッジを設けることができ、特別な訓練を受けていない要員でも、実験室環境の外側でも信頼性高く用いること

50

ができるので、コストおよび医療要員の負担が減少し、比較的頻繁な血液監視／分析を必要とする患者を含む、多くの患者にとってサンプル分析装置の利便性が高まる。

【0110】

図12の例示的な手法では、血液分析サンプルを用いる場合、制御をステップ604に移す。ステップ606において、血液サンプルを使い捨て流体カートリッジに供給する。次いで、制御をステップ608に移し、使い捨て流体カートリッジを血液サンプル分析装置に挿入する。次いで、制御をステップ610に移す。ステップ610では、血液サンプル分析装置を活性化し、ステップ612において、血液サンプル分析装置から血液分析結果を入手する。

【0111】

制御カートリッジを用いる場合、制御をステップ620に移す。ステップ620では、制御をステップ622に移し、制御カートリッジを血液サンプル分析装置に挿入する。次いで、制御をステップ624に移す。ステップ624では、血液サンプル分析装置を活性化し、ステップ626において、制御流体カートリッジを用いて、制御分析結果を入手する。次いで、制御をステップ628に移す。ステップ628では、制御分析結果が期待制御範囲内に納まっているか否か判定を行う。制御分析結果が期待範囲内に納まっていない場合、血液分析カートリッジについて得られた結果を信頼してはいけない。場合によっては、校正カートリッジを用いてサンプル分析装置を校正し直し、次いで別の制御カートリッジを用いて、サンプル分析装置の動作／校正を検証するとよい。

【0112】

校正カートリッジを用いる場合、制御をステップ640に移す。ステップ640では、制御をステップ642に移す。ステップ642では、校正カートリッジを血液サンプル分析装置に挿入する。次いで、制御をステップ644に移す。ステップ644では、血液サンプル分析装置を活性化し、ステップ646では、校正流体カートリッジを用いて、校正分析結果を入手する。次いで、制御をステップ648に移す。校正分析結果に基づいて、ステップ648では分析装置を必要に応じて調節する。

【0113】

場合によっては、サンプル分析装置は、完全自動計器、および／または自己充足的検査計器であってもよい。サンプル分析装置は、例えば、毛細血管（指先）、静脈全血液(venous whole blood)、鼻綿棒(nasal swab)、または尿等のような直接未処理の被検物を受け入れて分析することもできる。あるいは、または加えて、サンプル分析装置は、基本的な、技法に依存しない被検物の操作だけを必要としてもよい。同様に、サンプル分析装置は、「試薬Aおよび試薬Bを混合する」というような、基本的な、技法に依存しない試薬の操作だけを必要としてもよく、分析ステップ中操作者の介入を不要とすることができる。場合によっては、サンプル分析装置は、確認検査が臨床的に得策である場合、このような検査のために被検物を入手し出荷するための命令（および場合によっては素材）を含む、または供給することもできる。

【0114】

サンプル分析装置には、即答命令便覧を備えることよい。即答便覧は、サンプル分析装置の動作に対して素早く参考を提示することができる。使用中、ユーザがサンプル分析装置をどのように操作するのかについていかなる疑問が生じた場合でも、ユーザは即答便覧を参照すればよい。

【0115】

場合によっては、種々の動作ステップを、場合によってはサンプル収集から分析までの図式的に示す、即答便覧は自己説明的な写真または図を含むことよい。例示的な一例では、即答便覧は、写真または図だけを含み、ことばを含まないか、または最少量のことばを含む。これは、特定の言語（例えば、英語）が読めないユーザが、サンプル分析装置を有効に動作させるのに役立つことができる。例示的な一例では、即答便覧は、使い捨てカートリッジをそのパッケージから取り出し、血液充填キャップをカートリッジのランセットから取り外し、および／またはマーカを空気に露出して所定の時間期間後に色が変わるマー

10

20

30

40

50

カからカバー（例えば、テープ）を除去し、患者から血液を引き出し、引き出した血液をカートリッジに供給し、カートリッジを計器に装填し、計器を動作させ、結果を受け取り、カートリッジを計器から取り外してカートリッジを廃棄するステップについて示し、および／または説明すればよい。これは、単なる一例である。

【0116】

尚、計器の筐体が、即答便覧を受容するためのポケットなどを含むとよいことも想定している。使用中、ユーザは、ポケットから即答便覧を取り出して参照することができる。あるいは、即答便覧を、螺旋状バイнда等によってサンプル分析装置の筐体に固着してもよく、ユーザが使用中に即答便覧の種々のページをめくることができるようになる。別の例示的な例では、即答便覧を着脱式カートリッジに固着してもよく、または着脱式カートリッジを収容するパッケージ上に印刷してもよい。更に別の例示的な例では、即答便覧をポスタ上に印刷してもよく、これをサンプル分析装置の近くの壁等に吊しておくこともできる。

10

【0117】

場合によっては、そして誤った結果を生ずる危険性を低減するために、1つ又は複数の障害警告および／またはフェール・セーフ・メカニズムを設けるとよい。例えば、そして例示的な一例では、サンプル分析装置は、正しくない種類の被検物がユーザによって提供された場合、これを検出し易くすることができる。例えば、サンプル分析装置を、全血液サンプルの内赤血球計数を実行するように設定する場合、サンプル分析装置は、ユーザが提供する被検物が血液以外の何かであることがときとしてあるが、これを検出し易くすることができる。

20

【0118】

例示的な一例では、サンプル分析装置は分析を実行することができ、1つ又は複数の出力パラメータが所定の範囲を外れる場合、サンプル分析装置は結果を提示しない、および／またはエラー・メッセージまたはエラー・コードを発行することができる。例えば、サンプル分析装置が、全血液サンプルにおける白血球を計数するように較正された流動血球計算器であり、サンプル分析装置が白血球を全く計数しない（または少数の白血球を計数する）場合、サンプル分析装置は結果を提示せず、場合によってはエラー・メッセージまたはエラー・コードを提示することができる。

【0119】

例によっては、1つ又は複数の光学的測定を用いて、正しくない被検物がユーザによって提供されたとき、または流体カートリッジの正しい流動チャンネルに試薬が供給されていないときというような、正しくない流体が流動チャンネル内にあるときを特定し易くすることができる。図13は、このような1つの光学測定を示す。図13において、サンプル流体700が、例えば、流体カートリッジのチャンネル壁704によって規定されたチャンネル702の中にある。図示の例では、チャンネル壁704の屈折率は「 n_w 」であり、サンプル流体の屈折率は「 n_s 」である。光源706が、チャンネル壁704の1つに対してある角度をなして、入来光ビーム（場合によっては、平行化光ビーム）を供給する。検出器708が、光710を検出するように位置付けられており、光710は、チャンネル壁／サンプル界面から反射される。チャンネル／サンプル界面から検出器708に反射する光の量は、チャンネル壁の屈折率「 n_w 」およびサンプル流体の屈折率「 n_s 」によって異なる。反射シグネチャ(reflected signature)の所望の反射量は、所望のサンプル流体700がチャンネル702内にあるときに決定することができる。正しくない種類の被検物または正しくない試薬またはその他の正しくないサンプル流体が流動チャンネル700に供給されると、正しくない流体の屈折率「 n_{ic} 」のために、光710の異なる反射シグネチャが検出器708によって測定される。かかる変化は、正しくないサンプル流体が流動チャンネル702内にあることを示すことができる。あるいは、または加えて、かかる変化は、気泡、凝固、またはその他の望ましくない粒子、あるいはサンプル流体のその他の特性の存在を示す場合もある。これらが検出された場合、サンプル分析装置は結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードをユーザに提示することができ

30

40

50

る。

【0120】

図14は、正しくないまたは望ましくない流体が流動チャネル内にあるときに、それを特定し易くするために用いることができる別の光学測定を示す。図14において、サンプル流体720が、例えば、流体カートリッジのチャネル壁724によって規定されたチャネル722の中にある。図示の例では、チャネル壁724の屈折率は「 n_w 」であり、サンプル流体の屈折率は「 n_s 」である。光源726が、チャネル壁724の1つに対してある角度をなして、入来光ビーム（場合によっては、平行化光ビーム）を供給する。検出器728が、チャネル722およびサンプル流体720を通過する光730を検出するように位置付けられている。

10

【0121】

この図示例では、チャネル722は十分薄く作られているので、サンプル流体の屈折率「 n_s 」が所望の範囲内にあれば、チャネル722およびサンプル流体720を通過する光トンネリングが得られる。サンプル流体の屈折率「 n_s 」が所望の範囲未満である場合、光はチャネル722を通り抜けず、逆に反射される。サンプル流体の屈折率「 n_s 」が所望の範囲を超える場合、光はチャネル722およびサンプル流体720を通過する傾向があるので、この例は所望のサンプル（例えば、血液）の屈折率未満の屈折率「 n_s 」を有する正しくないサンプル流体を検出するには最も適していると考えられる。あるいは、または加えて、この図示例は、気泡、凝固、またはその他の望ましくない粒子、あるいはサンプル流体のその他の特性の存在を、所望に応じて、検出するために用いることができる。これらが検出された場合、サンプル分析装置は結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードをユーザに提示することができる。

20

【0122】

図15は、正しくないまたは望ましくない流体が、例えば、流体カートリッジの流動チャネル内にあるときに、これを特定するために用いることができる別の例示的な例を示す。この例示的な例では、サンプル流体750を、チャネル壁754によって規定された流動チャネル752に供給する。図示例では、2つ又は3つ以上の電極が、チャネル壁754の1つ又は複数に設けられている。例によっては、2つ又は3つ以上の電極を、1枚以上のプラスチック・シート上に形成し、後にこれらを積層するか、またはそれ以外の方法で互いに固着して流体カートリッジの流体回路を形成することができる。2つ又は3つ以上の電極は、流体カートリッジ上の流動チャネル752内にまたはこれを横断して延び、所望の駆動回路に接続するようにパターンニングすることができる。

30

【0123】

電源758が電極760間に信号を供給することができ、サンプル流体750を貫通する電極間の抵抗を測定することができる。これは、チャネル752におけるサンプル流体750の抵抗率の尺度を提供することができる。正しくないサンプル流体が流動チャネル752の中にあるとき、この正しくないサンプル流体の抵抗率は、期待範囲を外れると考えられる。抵抗率が期待範囲を外れることは、気泡、凝固、またはその他の望ましくない粒子、あるいはサンプル流体のその他の特性の存在の存在も示すことができる。これらが検出された場合、サンプル分析装置は結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードをユーザに提示することができる。

40

【0124】

場合によっては、電源758は低電位AC信号（例えば、10Vピーク・ピーク未満、5Vピーク・ピーク未満、3Vピーク・ピーク未満、1Vピーク・ピーク未満、0.5Vピーク・ピーク未満、0.1Vピーク・ピーク未満）を供給し、伝今日k760によって生ずるサンプル流体750内における電気化学的反応を抑えることもできる。電気化学的反応は、例えば、気泡等をサンプル流体750内に混入させる可能性があり、用途によっては望ましくない場合もある。

【0125】

前述のような抵抗率の測定を用いることに加えて、またはその代わりに、容量測定を用

50

いてもよいことも想定している。この例示的な例では、2つ又は3つ以上の電極間の容量を、サンプル750を通じて測定することができる。正しくないサンプル流体が流動チャンネル752に供給されると、正しくないサンプル流体から生ずる容量は期待範囲を外れると考えられる。容量が期待範囲を外れることは、気泡、凝固、またはその他の望ましくない粒子、あるいはサンプル流体のその他の特性の存在の存在も示すことができる。これらが検出された場合、サンプル分析装置は結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードをユーザに提示することができる。

【0126】

図16は、正しくないまたは望ましくない流体が、例えば、流体カートリッジの流動チャンネル内にあるときに、これを特定するために用いることができる別の例示的な例を示す。この例示的な例では、サンプル流体770を、チャンネル壁774によって規定された流動チャンネル772に供給する。図示例では、PHセンサ776を、サンプル流体770と流体連通状に設ける。PHセンサ776は、サンプル流体770のPHの尺度を検出し、信号をコントローラ780に報告することができる。正しくないサンプル流体が流動チャンネル772に供給されると、正しくないサンプル流体のPHは、予期される範囲を外れると考えられる。PHレベルが期待範囲を外れることは、気泡、凝固、またはその他の望ましくない粒子、あるいはサンプル流体のその他の特性の存在の存在も示すことができる。これらが検出された場合、サンプル分析装置は結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードをユーザに提示することができる。

【0127】

図17は、流動チャンネル内にあるサンプル流体に1つ又は複数の気泡またはその他の望ましくない粒子があるときに、これを特定するために用いることができる例示的な例を示す。この例示的な例では、サンプル流体800が、例えば、流体カートリッジのチャンネル壁804によって規定された流動チャンネル802の中にある。光源806がチャンネル壁804の1つに対してある角度をなして、入来光ビーム（場合によっては、平行化光ビーム）を供給する。検出器808が、流動チャンネル802内においてサンプル流体800の中にある気泡またはその他の望ましくない粒子によって散乱した光730を検出するように位置付けられている。例えば、サンプル流体800が気泡を全く有していない場合、光は散乱せずにサンプル流体を通過する傾向があり、検出器は信号を検出しない（または弱い信号を検出する）。ある閾値よりも上の光散乱信号が検出器808によって検出されると、流動チャンネル802の中にあるサンプル流体800は1つ又は複数の気泡またはその他の望ましくない粒子を有することを示し、サンプル分析装置は結果を提示せず、場合によってはエラー・メッセージまたはエラー・コードをユーザに提示することができる。

【0128】

図18は、流動チャンネルの中にあるサンプル流体に1つ又は複数の気泡またはその他の望ましくない粒子があるときに、それを特定するために用いることができる例示的な方法を示す。この例示的な例では、サンプル流体820が、例えば、流体カートリッジのチャンネル壁824によって規定された流動チャンネル822の中にある。超音波変換器826および超音波受信機828が、流動チャンネル822に隣接して設けられている。場合によっては、超音波変換器826を流動チャンネルの一方側に設け、超音波受信機828を反対側に設ける。別の場合には、超音波変換器826および超音波受信機828を流動チャンネル822の同じ側に設ける。いずれの場合でも、超音波受信機828は、超音波変換器826が発信した超音波信号において、流体サンプル820の中にある気泡またはその他の望ましくない粒子によって生ずる散乱を検出するために用いることができる。これらが検出された場合、サンプル分析装置は結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードをユーザに提示することができる。

【0129】

図19は、流動チャンネルの中にあるサンプル流体に1つ又は複数の気泡またはその他の望ましくない粒子があるときに、それを特定するために用いることができる例示的な方法を示す。この例示的な例では、サンプル流体850が、例えば、流体カートリッジのチャ

ネル壁 854 によって規定された流動チャネル 852 の中にある。流速センサ 856 が、流動チャネル 852 と流体連通状に設けられており、サンプル流体 850 の流速を検出する。流速センサは、例えば、熱風速型流速センサ、およびマイクロブリッジ型流速センサとすることができる。マイクロブリッジ流速センサは、例えば、米国特許第 4, 478, 076 号、米国特許第 4, 478, 077 号、米国特許第 4, 501, 144 号、米国特許第 4, 651, 564 号、米国特許第 4, 683, 159 号、および米国特許第 5, 050 429 号に記載されている。これらの全ては、ここで引用したことにより、その内容が本願にも含まれるものとする。

【0130】

圧力源 860 が、流動チャネル 852 内にあるサンプル流体 850 に可変圧力を供給することができる。コントローラ 862 が、流速センサ 856 からの流速信号を受け取ることができ、場合によっては、圧力源 860 を制御することができる。例示的な一例では、そしてサンプル流体における気泡を検出するために、コントローラ 862 は、圧力源 860 に、サンプル流体 850 に加える圧力を突然変化させることもできる。その結果サンプル流体 850 に生ずる流速の変化を、流速センサ 856 によって監視することができる。

【0131】

図 20 は、図 19 の流動チャネル 852 においてサンプル流体 850 に圧力源 860 によって供給することができる例示的な圧力パルス 900 を示すグラフである。サンプル流体 850 内に気泡がほとんどないまたは全くない場合、902 に示す流速が得られると考えられる。流速 902 は、圧力パルス 900 が突然増大すると、低い方の流速値 904 から高い方の流速値 906 に、更に急激に上昇し、次いで、圧力パルス 900 が突然減少すると、高い方の流速値 906 から低い方の流速値 904 に突然邸かする。しかしながら、サンプル流体 850 の中に気泡があると、その結果生ずる流速 908 (破線で示す) は、圧力パルス 900 が突然増大すると、低い方の流速値 904 から高い方の流速値 906 への上昇がゆっくりとなり、圧力パルス 900 が突然減少すると、高い方の流速値 906 から低い方の流速値 904 への低下もゆっくりとなると考えられる。気泡の中にある空気は、例えば、サンプル流体 850 の圧縮率を高め、これによって流速の上昇および低下の変化がゆっくりとなると考えられる。加えた圧力を変化させる間流速の変化を監視することによって、サンプル流体 850 における気泡の存在を検出することができる。流速変化に十分な減少が検出された場合、サンプル分析装置は結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードをユーザに提示することができる。

【0132】

尚、圧力源 860 は、適した圧力源であればいずれでもよく、所望に応じて、従来からのポンプ、圧縮空気源、またはその他の適した圧力源であればいずれでも含まれる。場合によっては、高周波圧力源を、従来からのポンプまたはその他の圧力源と共に用いてもよく、あるいは並列に動作してもよい。即ち、従来からのポンプまたはその他の圧力源 860 を用いて、サンプル流体の分析中に、流体カートリッジの流動チャネル 852 を通過するサンプル流体を実際に移動させることができる。高周波圧力源は、サンプル流体を流動チャネルに沿って大きく移動させるために用いるのではなく、例えば、気泡の存在、サンプル流体の圧縮率等を含む、サンプル流体のある種のパラメータを検出するために、サンプル流体の中に高周波の圧力パルスを発生するために用いるとよい。サンプル流体の圧縮率は、流動チャネル 852 の中にあるサンプル流体が、予期した種類のサンプル流体であるか否か検出し易くするために用いることができ、そうでない場合、サンプル分析装置は結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードをユーザに提示することができる。

【0133】

いずれにしても、そして場合によっては、高周波圧力源が従来からのポンプまたはその他の圧力源と同時にまたは並列に動作する場合、流体回路によるサンプル処理の間に、現場でのサンプル流体の監視を行うことができる。

【0134】

10

20

30

40

50

場合によっては、圧力パルスを用いて、流体回路の流動チャンネルの中にあるサンプル流体の末端即ち遠端の場所を判定または推定することができる。図 2 1 において、2つの流動チャンネル 1 0 0 0 および 1 0 0 2 が示されている。サンプル流体 1 0 0 4 が流動チャンネル 1 0 0 0 の中にあり、サンプル流体 1 0 0 6 が流動チャンネル 1 0 0 2 の中にある。圧力変換器（例えば、圧力源）1 0 0 8 および受圧器（例えば、圧力センサ）1 0 1 0 が示されており、流動チャンネル 1 0 0 0 に対して既知の場所においてサンプル流体 1 0 0 4 に流体的に結合されている。圧力変換器 1 0 0 8 は、サンプル流体 1 0 0 4 の中に圧力パルスを生成することができる。圧力パルスは、サンプル流体 1 0 0 4 を下って、末端 1 0 1 2 まで移動する。圧力パルスからのエネルギーの一部は、サンプル流体 1 0 0 4 の末端 1 0 1 2 によって反射され、受圧器 1 0 1 0 に戻ってくる。圧力変換器 1 0 0 8 および／または受圧器 1 0 1 0 から末端 1 0 1 2 が現在位置しているところまでの距離は、圧力パルスがサンプル流体 1 0 0 4 を下って末端 1 0 1 2 に達し受圧器 1 0 1 0 に戻ってくるまでに要する時間と関係がある。したがって、圧力パルスが末端 1 0 1 2 まで移動して受圧器 1 0 1 0 に戻ってくるまでに要する時間を測定することによって、流動チャンネル 1 0 0 0 に沿った末端 1 0 1 2 の場所を判定することができる。

10

【0 1 3 5】

流動チャンネル 1 0 0 2 は流動チャンネル 1 0 0 0 と同様であるが、末端が流動チャンネルよりも更に離れた距離に位置することを除く。したがって、サンプル流体 1 0 0 6 がサンプル流体 1 0 0 4 と同一であると仮定すると、圧力パルスが末端 1 0 1 4 まで行って受圧器 1 0 1 8 まで戻ってくるまでに要する時間は、流動チャンネル 1 0 0 0 よりも長くなるはずである。また、受圧器 1 0 1 8 が受け取る反射圧力パルスの振幅は、受圧器 1 0 1 0 が受ける圧力パルスの振幅と比較すると、減少していると考えられる。つまり、振幅を監視すると、チャンネル 1 0 0 0 および 1 0 0 2 それぞれに沿った末端 1 0 1 2 および 1 0 1 4 の場所を推定または判定する別の方法を得ることができる。

20

【0 1 3 6】

図 2 2 および図 2 3 は、2つの流体が流体回路において合流するときを判定するための例示的な手法を示す。多くのサンプル分析装置では、初期状態において異なる流体が異なる流動チャンネルに供給される。しかしながら、流体回路内では、種々の流体が相互に混ざることが多い。例えば、血液サンプルおよび球体化試薬は、初期状態では、各々別個の流動チャンネルに供給する、後に流体回路の下流のいずれかの場所で互いに混じり合う可能性がある。種々の流体がいつそしてどのように合流するかタイミングは、例えば、米国特許出願第 1 0 / 9 3 2 , 6 6 2 号に開示されているように、サンプル分析装置の機能全体にとっては重要となる可能性がある。この特許出願は、本願の譲受人に譲渡されており、その内容はここで引用したことにより本願にも含まれるものとする。

30

【0 1 3 7】

2つ又は3つ以上の流体が流体回路の下流において混合するときを判定し易くするために、圧力変換器を用いて、流体サンプルの少なくとも1つにおいて圧力パルスを形成するとよい。例えば、そして図 2 2 を参照すると、圧力変換器 1 0 3 0（例えば、ポンプ、圧電発振器、超音波変換器、または他のあらゆる形式の圧力変換器）が、第1流動チャンネル 1 0 3 4 の中にあるサンプル流体 1 0 3 2 において圧力パルスを生成することができる。受圧器 1 0 3 6（例えば、圧力センサ、超音波受信機等）が、第2流動チャンネル 1 0 4 2 の中にあるサンプル流体 1 0 4 0 と流体連通することができる。第1流動チャンネル 1 0 3 4 および第2流動チャンネル 1 0 4 2 は、流動チャンネル 1 0 4 4 において合流する。これは、図 2 3 において最も良く示されている。

40

【0 1 3 8】

再度図 2 2 を参照すると、圧力変換器 1 0 3 0 が第1サンプル流体 1 0 3 2 において生成した圧力パルスは、第1サンプル流体 1 0 3 2 内を下流に向かって進行することができるが、第1サンプル流体 1 0 3 2 の端部即ち遠端 1 0 4 6 を超えて遥か先まで達することはできない。図示の例では、図 2 2 に示す流動チャンネル 1 0 4 4 には、初期状態では空気またはその他の気体が充填されており、後にサンプル流体 1 0 3 2 および 1 0 4 0 がそれ

50

ぞれの流動チャネル 1034 および 1042 に沿って押し流されると、空気またはその他の気体はサンプル流体 1032 および 1040 によって変位させられる。サンプル流体 1032 および 1040 が合流する前に、受圧器 1036 は圧力変換器 1030 から大きな圧力パルスではなく、あかり減衰した圧力パルスを受信すると考えられる。

【0139】

ポンプ等のような、1つ又は複数の圧力源（図示せず）を活性化させて、図 23 においてより良く示されるように、サンプル流体 1032 および 1040 が合流するまで、サンプル流体 1032 および 1040 をそれぞれの流動チャネル 1034 および 1042 に沿って移動させることができる。これが発生すると、圧力変換器 1030 によって生成する圧力パルスは、この状態では、一層自由に受圧器 1036 まで進行することができるようになる。したがって、サンプル流体 1032 および 1040 が合流するときは、受圧器 1036 が圧力変換器 1030 から、減衰が少ない圧力パルスを受信し始めるとき、または受信するときに監視することによって判定することができる。

10

【0140】

場合によっては、圧力変換器 1030 はサンプル流体の中に（ときには比較的高い周波数の）圧力パルス列を生成してもよく、更にサンプル流体 1032 および 1040 を流体回路の流動チャネル 1034、1042 および 1044 に沿って実際に移動させるポンプまたはその他の圧力源と同時にまたは並列に動作してもよい。つまり、圧力変換器は、流体回路におけるサンプル流体の、更に具体的には、サンプル流体 1032 および 1040 が下流で合流するときの現場監視を行うために用いることができる。

20

【0141】

場合によっては、サンプル分析装置が分析の間水平面に置かれていないと、サンプル分析装置の動作が影響を受ける場合がある。この場合を検出するために、サンプル分析装置がレベル・センサを含むとよいことを想定している。例示的な一例では、レベル・センサは、Omron Corporation から入手可能な、微小傾斜センサ（D6B）とするとよい。他のレベル・センサには、電気出力を有するボール・センサを含むことができる。レベル・センサを用いると、サンプル分析装置は、サンプル分析装置が、分析を行うのに十分水平であるか否か判定を行うことができる。サンプル分析装置が十分に水平でない場合、サンプル分析装置は分析を実行しない、および／または結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードを出してもよい。

30

【0142】

サンプル分析装置が十分に水平になっているか否か確認するためにチェックする別の手法では、流体を含む 1つ又は複数の流動チャネルを減圧し、これら 1つ又は複数の流動チャネルにおける流体の流速を測定することを含む。サンプル分析装置が十分に水平になっていない場合、重力によって、1つ又は複数の流動チャネルにおける流速が、予期される範囲を外れると考えられる。流速が予期される範囲を外れた場合、分析装置は十分に水平になっていないと見なすことができ、サンプル分析装置は分析を実行しない、および／または結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードを提示してもよい。

【0143】

場合によっては、サンプル分析装置が分析中に衝突したり、またはそれ以外で移動した場合、分析装置の動作が影響を受ける場合がある。この場合を検出するために、サンプル分析装置が衝撃および／または振動センサを含むとよいことを想定している。例示的な一例では、衝撃および／または振動センサは、Omron Corporation から入手可能な衝撃／振動センサ（D7E-2）とすることができる。衝撃および／または振動センサを用いると、サンプル分析装置は、当該サンプル分析装置が衝突したかまたはそれ以外で移動したか否か判定することができる。サンプル分析装置が十分に衝突した場合、サンプル分析装置は、ユーザが制御カードまたは校正カードを実行して、処理を先に進める前にサンプル分析装置の適正な動作を検証する必要がある場合もある。場合によっては、サンプル分析装置は、分析の間にサンプル分析装置が衝突したかまたはそれ以外で移動したか否か判定を

40

50

行うとよい。サンプル分析装置が分析中に十分に衝突した場合、サンプル分析装置は分析を実行しない、および／または結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードを出してもよい。

【0144】

場合によっては、サンプル分析装置は、計器ならびに着脱式および／または使い捨てカートリッジを含むこともできる。ユーザの挙動はときとして予測不可能なので、分析を進める前に、カートリッジが計器に適正に挿入されていることを検証することが望ましい場合がある。これを遂行する1つの方法は、カートリッジが正しい向きでないと計器に挿入できないように、カートリッジおよび計器を設計することである。例えば、図24は、矢印1104で示すように、計器1102内にあるスロットに受容されているカートリッジ1100を示す。図示のカートリッジ1100は、当該カートリッジ1100の上面に溝1106を含む。計器は対応する雄部材1108を含み、カートリッジ1100を計器1102に対して適正な向きで挿入すると、雄部材1108が溝1106の中に進入するように構成されている。カートリッジを天地逆に挿入すると、溝1106および雄部材1108が整列せず、カートリッジ1100は、計器1102のスロットに完全に挿入することが妨げられる。同様に、カートリッジ1100の端部1112を計器1102のスロットに挿入すると、溝1106および雄部材1108が整列せず、カートリッジ1100は、計器1102のスロットに完全に挿入することが妨げられる。これは、カートリッジ1100は適正な向きでないと計器1102に挿入することができないように、カートリッジ1100を計器1102に合わせる一例に過ぎない。

【0145】

カートリッジの計器に対する向きは、特に、カートリッジを計器に対して合わせない場合には、あらゆる数の方法でも検証することができる。例えば、例によっては、カートリッジが適正に計器に挿入されたときに、1つ又は複数の圧力ポートが計器とカートリッジの間に介在してもよい。計器は、圧力ポートの1つ又は複数の圧力を加えて、所望の流動が観察できるか否か確認するためにチェックすることができる。計器の圧力ポートがカートリッジの圧力ポートと整列していない場合、所望の流動を見ることはできない。所望の流速が見られない場合、サンプル分析装置は分析を実行しない、および／または結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードを出してもよい。

【0146】

別の例では、カートリッジは1つ又は複数の光窓またはその他の光学構造を含むこともできる。カートリッジが計器内に適正に導入された場合、計器は、光学的に、1つ又は複数の光窓またはその他の光学構造を含む場所に呼掛けることができる。予期した光応答が検出されない場合、カートリッジは適正な向きで導入されていない可能性があり、サンプル分析装置は分析を実行しない、および／または結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードを提示してもよい。

【0147】

場合によっては、サンプル分析装置は、所望のサンプル分析を実行するために1つ又は複数の試薬を必要とする場合がある。適正な試薬があるか否か、そして試薬が良い状態にあるか否か判定することが望ましい場合がある。例示的な一例では、試薬はコンテナに入れて配給することができ、コンテナは、試薬の種々のパラメータを識別するバー・コードまたはその他のコードを含むことができる。種々のパラメータは、例えば、試薬の種類、製造日、試薬の有効期限、およびその他のパラメータを識別することができる。サンプル分析装置は、バー・コードまたはその他のコードのリーダを含むことができ、種々のパラメータを読み取ることができる。次いで、サンプル分析装置は、例えば、試薬が所望のサンプル分析に対して適正な試薬か否か、試薬が指定の有効期限を過ぎていないか否か等を判定することができる。試薬が所望の分析に対して正しい試薬でない場合、または良い状態にない場合、サンプル分析装置は分析を実行しない、および／または結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードを出してもよい。

【0148】

場合によっては、試薬を着脱自在および／または使い捨てカートリッジに貯蔵することができる。図 25 は、3つのチェンバ 1 1 2 2 a、1 1 2 2 b および 1 1 2 2 c を含む使い捨てカートリッジ 1 1 2 0 を示し、各チェンバは、カートリッジ 1 1 2 0 を用いて実行する分析に特定した試薬を貯蔵する。カートリッジ 1 1 2 0 に貼り付いているバー・コード 1 1 2 4 が示されている。一旦カートリッジを対応する計器に適正に挿入したなら、計器はバー・コードを読み取り、試薬が所望のサンプル分析に対して適正な試薬であるか否か、試薬がその指定有効期限を過ぎていないか等を判定することができる。

【0149】

また、バー・コード 1 1 2 4 は、カートリッジ 1 1 2 0 に関する多数のパラメータも識別することができる。例えば、バー・コード 1 1 2 4 は、カートリッジ、カートリッジがサポートする分析の種類、カートリッジ特定の校正パラメータ（使用する場合のみ）、分析についてのタイミング・パラメータ、分析についての入力圧力および／または流速等を識別することができる。場合によっては、バー・コード 1 1 2 4 は、カートリッジを用いて分析を実行するときに、計器が用いるためのソフトウェアを設けることもできる。バー・コード 1 1 2 4 を設ける代わりに、またはバー・コード 1 1 2 4 を設けることに加えて、RFID タグを設けてもよく、計器は、RFID タグを読み取るメカニズムを含んでもよい。RFID タグは、バー・コード 1 1 2 4 に関して先に説明したのと同様の情報を含むことができる。

【0150】

また、温度もある試薬の性能に影響を及ぼすことがあり得る。場合によっては、最高温度インディケータ 1 1 2 6 および／または最低温度インディケータ 1 1 2 8 を設けるとよい。最低温度インディケータ 1 1 2 8 は、JP Labs から入手可能な冷凍インディケータと同様とすればよい。JP Labs から提供されている冷凍インディケータは、ラベルの形態をなし、カートリッジまたはその他のコンテナに容易に貼り付けることができる。冷凍インディケータの温度が水の氷点未満に低下すると、非可逆的な色の変化、例えば、青から赤を生ずる。計器は、光学呼掛け器を含むことができ、これが冷凍インディケータ 1 1 2 8 の色を検出し、最低温度未満の温度に試薬が晒されていた場合、サンプル分析装置は分析を実行しない、および／または結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードを提示してもよい。

【0151】

同様に、最高温度インディケータ 1 1 2 6 も、JP Labs から入手可能な温度インディケータと同様とすればよい。これらのインディケータは、通常常温よりも高いある所定の温度（または温度範囲）に達すると、色変化を生ずる。加熱すると、無色から赤、無色から緑、青から赤等の変化を生ずる。これらのインディケータは、市販のインク・ビヒクル、例えば、フレクソおよびグラビアに容易に組み込むことができる。計器は、光学呼掛け器を含むことができ、これが温度インディケータ 1 1 2 6 の色を検出し、最高温度未満の温度に試薬が晒されていた場合、サンプル分析装置は分析を実行しない、および／または結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードを提示してもよい。

【0152】

湿度および／または水分インディケータも設けてもよい。湿度および／または水分インディケータは、JP Labs から入手可能なものと同様とすればよい。湿度および／または水分インディケータは、完全に水分に露出すると、色変化を生ずることができる。色変化に必要な時間は、通常的环境湿度の下において、数分から数週間まで様々である可能性がある。

【0153】

図示のカートリッジ 1 1 2 0 は、時間インディケータ 1 1 3 0 も含むことができる。例によっては、密閉パッケージでカートリッジ 1 1 2 0 をユーザに出荷する場合もある。密閉パッケージは、カートリッジ 1 1 2 0 周囲に、制御した環境を提供することができる。使用前に、ユーザはパッケージからカートリッジ 1 1 2 0 を取り出さなければならず、こ

10

20

30

40

50

れによってカートリッジ 1 1 2 0 を外部環境に露出させる。時間インディケータ 1 1 3 0 は、パッケージを開いたときに活性化することができ、所定の時間期間が過ぎた後に、色に変化するか、それ以外では検出可能な状態を提示することができる。時間インディケータ 1 1 3 0 は、JP Labs から入手可能な時間インディケータと同様とすればよい。

【0 1 5 4】

計器は、時間インディケータ 1 1 3 0 の色を検出する光学呼掛け器を含むことができ、時間期間が過ぎると、サンプル分析装置は分析を実行しない、および／または結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードを提示してもよい。これは、ユーザに、カートリッジのパッケージを開き、血液またはその他のサンプルをカートリッジ 1 1 2 0 に装填し、計器を用いて分析を実行するための所定の時間量を与えることができる。これによって、ユーザがサンプルをカートリッジ 1 1 2 0 に装填し、分析を実行する前に長く待ちすぎ、これによってサンプルを凝固させたり、乾燥させたり、それ以外の特性変化が生ずる可能性を低下するのに役立てることができる。

10

【0 1 5 5】

カートリッジ 1 1 2 0 をパッケージから取り出すときに時間インディケータを始動させる代わりに、カートリッジ 1 1 2 0 のサンプル入力ポート上に、帯状のテープ 1 1 3 2 またはその他の物質を設けてもよい。帯状のテープ 1 1 3 2 またはその他の物質は、時間インディケータ 1 1 3 6 を包み込むことができる。サンプルをカートリッジに装填する前に、ユーザは帯状のテープ 1 1 3 2 またはその他の物質を除去しなければならず、これによって時間インディケータを環境に露出させ、時間インディケータを活性化する。所定の時間期間の後、時間インディケータ 1 1 3 6 は色の変化を生ずるか、それ以外の検出可能な状態を提示することができる。

20

【0 1 5 6】

計器は、時間インディケータ 1 1 3 6 の色を検出する光学呼掛け器を含むことができ、時間期間が過ぎた場合、サンプル分析装置は分析を実行しない、および／または結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードを出してもよい。これは、ユーザに、サンプルの入力ポートから帯状のテープ 1 1 3 2 またはその他の物質を除去し、血液またはその他のサンプルをカートリッジ 1 1 2 0 に装填し、計器を用いて分析を実行するための所定の時間量を与えることができる。これによって、ユーザがサンプルをカートリッジ 1 1 2 0 に装填し、分析を実行する前に長く待ちすぎ、これによってサンプルを凝固させたり、乾燥させたり、それ以外の特性変化が生ずる可能性を低下するのに役立てることができる。

30

【0 1 5 7】

場合によっては、カートリッジがばね作動式ランセットを含み、血液サンプルをカートリッジに収集する際に補助するようにしてもよい。例えば、図 2 6 は、ばね作動式ランセット 1 1 5 2 を含む例示的なカートリッジ 1 1 5 0 を示す。ばね作動式ランセット 1 1 5 2 は、ばねまたはその他の偏倚エレメント 1 1 5 3 を含むことができ、ランセットを突出位置 1 1 5 4 に偏倚させる。解放メカニズム 1 1 5 3 をばね偏倚ランセット 1 1 5 2 に結合し、ランセットを退却位置に固定することができる。解放ボタンまたはレバー 1 1 6 0 をユーザが作動させると、解放機構 1 1 5 6 はばね偏倚ランセット 1 1 5 2 を解放することができ、ランセットは突然退却位置 1 1 5 8 から突出位置 1 1 5 4 に移動することができる。解放ボタンまたはレバー 1 1 6 0 を作動させたときに、ユーザの指がカートリッジ 1 1 5 0 に押し付けられていると、ばね偏倚ランセット 1 1 5 2 がユーザの皮膚に突き刺さり、しかるべき量の血液を引き出すことができる。ばね偏倚ランセット 1 1 5 2 は、カートリッジ 1 1 5 0 の中にあるサンプル収集毛細管（図示せず）と流体連通することができる。したがって、例によっては、血液サンプルを直接カートリッジ 1 1 5 0 のサンプル収集毛細管に配給することができる。ばね偏倚ランセット 1 1 5 2、解放メカニズム 1 1 5 6、および解放ボタンまたはレバー 1 1 6 0 は、Becton, Dickinson and Company から入手可能な BD（商標）ランセット・デバイスと同様とすればよい。

40

【0 1 5 8】

50

あるいは、サンプルは、例えば、突き刺した指からピペット（恐らくは凝固防止剤を被覆した）を通じてカートリッジのサンプル入力または毛細管に転送することもできる。サンプルの転送およびカートリッジへの導入に、シリンジを用いることもできる。指を突き刺す、切開する、または切る前に指を消毒するために、アルコール・スワブを用いることもできる。図 26 におけるカートリッジ 1150 のランセット 1152 のように、ダイヤルイン深さ設定機能を有するランセットを用いてもよい。

【0159】

場合によっては、そして図 27 を参照すると、着脱式および／または使い捨てカートリッジ 120 は、気泡を流動体(flow stream)から除去するメカニズムを含むこともできる。場合によっては、気泡が、チャンネルの壁の一部をなす多孔質膜の下を通過する際に、流動チャンネルにおける液体流から気泡を除去することができる。図 27 では、気泡を含む液体が流動チャンネル 1170 を流れていく様子が示されている。膜 1172 は、流動チャンネル 1170 を開孔チェンバ 1174 から分離する。開孔チェンバ 1174 は、流動チャンネル 1170 における圧力よりも低い圧力に保持されている。場合によっては、膜は、マサチューセッツ州BillericaにあるMillipore Corporationから入手可能なFluoropore（商標）、Mitex（商標）、またはDurapore（商標）膜のような、疎水性膜である。Mitex（商標）膜は、PTFEで作られ、小孔のサイズは5または10ミクロンである。Fluoropore（商標）膜は、支持剤HDP Eを含有するPTFEで作られ、小孔のサイズは1または3ミクロンである。Durapore（商標）膜は、フッ化ポリビニリデンで作られ、小孔のサイズは0.1、0.22、および0.45ミクロンである。疎水性膜は、多くの場合、高い圧力差を維持することができ、それを通じた流体の漏れは生じない。

【0160】

流動チャンネル 1170 と開孔チェンバ 1174 との間の圧力差によって、気泡 1180 内の気体を、膜 1172 を通して発散し、膜 1172 の下流において流体内の気泡を大幅に減少させる（望ましくは、気泡がなくなる）。次いで、気泡のない液体は、1184 に示すように、下流に流れ、着脱式および／または使い捨てカートリッジ上の流体回路によって更に処理する。

【0161】

小孔のサイズが大きくなる程、小さな小孔のサイズよりも、取り込まれた気泡 1180 から気体の同じ流速を得るには少ない圧力差で済むが、液体の一部を通過させなければ、大きな圧力差を維持することができない。1つの微小孔を有する膜は、液体および膜の表面エネルギーならびに小孔の幾何学的形状にもよるが、1PSI程度の圧力差を維持できるべきことが推定される。

【0162】

図 28 は、流動チャンネル 1185 内部の側壁上における気泡トラップ 1191 の例示的な例の模式図である。気泡 1187 は、流れ 1193 と共に1つ又は複数のトラップ 1191 の中に流入し、凝固し、既にトラップの中にある気泡 1189 と合体することができる。あるいは、気泡 1191 はトラップの中における初期気泡 1189 となる場合もあり得る。トラップは、流動チャンネルの壁における、三角形状フックのような、変形としてもよく、その場合、気泡が付近を通過する際に取り込まれ、トラップから流出して再度流動体に戻ることはできない。図示のような三角形状の他にも、トラップの形状は、矩形、半円形等としてもよい。

【0163】

場合によっては、サンプル分析装置は、サンプル分析装置の種々の構成部品を制御するために、電子部品および／またはソフトウェアを有してもよい。場合によっては、サンプル分析装置をライン電圧で給電してもよいが、停電の場合に備えて、バッテリー・バックアップを有するとよい。電子部品は、ときによってはバッテリー・バックアップと共に、クロック・チップを含み、精度高い時刻および日付を維持することができる。精度高い時刻および日付を有することは、例えば、試薬パッケージまたはカートリッジ上のバー・コード等から読み取ることができる、試薬の有効期限を比較して、試薬が未だ使用可能か否か判

定する際に、有効に用いることができる。

【0164】

分析中に停電が発生し、しかもバッテリー・バックアップが設けられていない場合、電子部品および／またはソフトウェアは、分析を終了し、結果を発行せず、そして場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードをユーザに発行することができる。

【0165】

電子部品および／またはソフトウェアは、サンプル分析装置の種々の光源および検出器に結合することができる。例によっては、電子部品および／またはソフトウェアは、サンプル分析の前、後、および／または周期的に、あるいは分析の間中、光源および光検出器の動作をチェックすることができる。例えば、電子部品および／またはソフトウェアは、サンプル分析の前、後、および／または周期的に、あるいは分析の間中、1つ又は複数の検出器が、対応する光源によって供給される光を検出していることを検証することができる。

10

【0166】

あるいは、または加えて、光窓における亀裂、あるいは光窓上の汚れやごみのような、カートリッジ内の異常は、カートリッジを計器に挿入した後で、分析手順を開始する前に、識別するとよい。これは、例えば、1つ異常の光源を作動させて光窓を通じて光を供給し、1つ異常の検出器を用いて、光学的特徴（反射率、散乱、F A L S、S A L S、L A L S等）を検出することによって遂行することができる。光窓が切れ部、汚れまたはごみを光窓上に、またはその他の不規則を含む場合、これらの不規則が原因で、検出器において予期しない光学的特徴が生ずる場合がある。電子部品および／またはソフトウェアがこのような異常を検出した場合、サンプル分析装置は分析を実行しない、および／または結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードを出してもよい。

20

【0167】

流速センサがサンプル分析装置の中にある場合、ある種の電子部品および／またはソフトウェアは、分析の前、後、または最中に流速センサの出力を監視して、指示された流速が所望の範囲内に納まっている、または所望の特徴に沿っていることを確認することができる。電子部品および／またはソフトウェアが、指示された流速が所望の範囲に納まらず、所望の特徴に沿ってもいない場合、サンプル分析装置は分析を実行しない、および／または結果を提示せず、場合によっては、エラー・メッセージまたはエラー・コードを出してもよい。

30

【0168】

場合によっては、サンプル分析装置は、あるレベルの内蔵自己検査（B I S T）を含むとよい。例えば、検査モードでは、電子部品における記憶エレメント（例えば、レジスタ）の一部または全部を、直列走査連鎖的に、選択的に一緒に接続することができ、検査ベクトルを、連鎖結合したレジスタ内に直列に走査することができる。場合によっては、電子部品の入力および出力は検査レジスタを含むことができ、これを検査モードにおいてのみ論理的に挿入する。機能的クロック・サイクルを監視開始し、検査ベクトル・ビットを、レジスタ間のロジックを通じて放出し、結果をレジスタによって捕獲する。次いで、結果を直列的にレジスタから読み出し、期待結果と比較する。これによって、サンプル分析器における電子部品のロバストな検査を行うことができる。

40

【0169】

かかる検査ベクトルの多くは、所望の障害保護範囲(fault coverage)を達成するために実行することができる。場合によっては、障害保護範囲は、所望に応じて、ロジックの50パーセントよりも大きい、ロジックの60パーセントよりも大きい、ロジックの80パーセントよりも大きい、ロジックの90パーセントよりも大きい、ロジックの95パーセントよりも大きい、またはロジックの99パーセントよりも大きいこともあり得る。一旦検査したなら、電子部品を再度機能モードに切り換えることができ、サンプル分析装置の通常の機能的動作を再開することができる。サンプル分析装置は、1時間に1回、1日に

50

1回、1週間に1回、1月に1回、またはその他のいずれの所望の間隔というような、周期的な間隔で検査モードに自動的に入ることができる。

【0170】

場合によっては、電子部品および／またはソフトウェアは、用途に応じて、5,000時間より長い、8,000時間より長い、10,000より長い、50,000時間より長い、100,000時間より長い、またはそれよりも長い平均故障間隔が得られるように、設計および／または検査する。

【0171】

例によっては、サンプル分析装置は、インターネットを通じて、1箇所以上の遠隔地に接続することもできる。そのように設ける場合、検査結果は、所望であれば、長期間の格納および／または更なる分析のために、遠隔地に配信することができる。加えて、遠隔地は、診断ソフトウェアを含むことができ、サンプル分析装置の遠隔診断および／または保守も実行できることも想定している。場合によっては、遠隔地は自動的にサンプル分析装置のファームウェアまたはソフトウェアをアップグレードすることもできる。

【0172】

本分析装置は、ワイヤレス通信接続を通じて、他の現場または場所に接続することもできる。ワイヤレス接続は、インターネットまたはその他のネットワークと同様の機能および特徴を設けることができる。ワイヤレス通信接続は、関連する通信委員会または業界のプロトコル標準に適合することができる。

【0173】

本分析装置は、血球学分析装置および免疫学的測定メカニズムとすることができる。

カード拒否およびその他のエラーを遠隔地に送ることができる。遠隔地は、特定のサンプル分析装置に普通でなく高いエラーが発生しているか否か判定することができる。普通でなく高いエラーとは、サンプル分析装置の中で故障したハードウェア・コンポーネントまたは十分とは言えないハードウェア・コンポーネントを示すことができ、サービス担当者を遠隔地から派遣して、ユーザが問題を検出する前に、このコンポーネントを修理／交換することができる。また、特定の場所において普通でなく高いエラーは、その場所にいるユーザが付加的な訓練を必要としていることを示す場合もある。かかる訓練は、研究所所員のために遠隔地から急送することができる。カートリッジおよび計器は、訓練を受けていない要員でも動作可能であるように設計することができる。

【0174】

また、遠隔地は、多数のサンプル分析装置からのエラーおよび／またはBIST結果を統計的に分析し、サンプル分析装置の後続バージョンにおいて強化することができる、サンプル分析装置のコンポーネント、ソフトウェア、またはその他のエリアを特定することができる。

【0175】

サンプル分析装置内または周囲の温度、湿度、およびその他の環境パラメータを周期的に検知し、遠隔地に送るとよく、所望に応じて、衝撃、傾き、およびその他のセンサ・データも周期的に検知し、遠隔地に送るとよい。

【0176】

本明細書では、内容の一部は、性質上仮説的または予言的であっても他の文体または時世で述べられていることもある。

以上、少なくとも1つの例示的な例に関して、本発明について説明したが、本明細書を読めば、多くの変形や修正が当業者には明白となろう。したがって、添付した請求項は、従来技術に鑑み、かかる変形および修正を全て含むようにできるだけ広く解釈するものとすることを表明する。

【図面の簡単な説明】

【0177】

【図1】図1は、例示的なサンプル分析装置およびカートリッジの斜視図である。

【図2】図2は、図1の例示的なサンプル分析装置およびカートリッジの模式図である。

【図 3】図 3 は、図 2 のサンプル分析装置およびカートリッジの流速制御を示す、更に詳細な模式図である。

【図 4】図 4 は、例示的なカートリッジのある種の機構の模式図である。

【図 5】図 5 は、カートリッジに含むことができる多数の例示的な貯蔵槽の模式図である。

【図 6】図 6 は、血液サンプルを分析するための例示的手法を示す模式流れ図である。

【図 7】図 7 は、多数の赤血球パラメータを得るための例示的手法を示す模式流れ図である。

【図 8】図 8 は、血液サンプルを分析するための別の例示的手法を示す模式流れ図である。

10

【図 9 a】図 9 a は、ニードル－隔膜界面を示す。

【図 9 b】図 9 b は、ニードル－隔膜界面を示す。

【図 9 c】図 9 c は、シャフト－膜界面を示す。

【図 9 d】図 9 d は、シャフト－膜界面を示す。

【図 9 e】図 9 e は、膜－膜界面を示す。

【図 9 f】図 9 f は、膜－膜界面を示す。

【図 9 g】図 9 g は、推進流体、溶解(lysing)溶液、球体化溶液(sphering solution)、およびシース流体(sheath fluid)の空洞に提案する直径を示す表である。

【図 10】図 10 は、サンプル分析装置を設定し動作させるための例示的手法を示す模式流れ図である。

20

【図 11】図 11 は、サンプル分析装置を動作させるための別の例示的手法を示す流れ図である。

【図 12】図 12 は、サンプル分析装置を動作させるための別の例示的手法を示す流れ図である。

【図 13】図 13 は、正しくないまたは望ましくない流体が流体回路の流動チャネル内にあるときに、これを特定し易くするために用いることができる例示的な光学測定の模式図である。

【図 14】図 14 は、正しくないまたは望ましくない流体が流体回路の流動チャネル内にあるときに、これを特定し易くするために用いることができる別の例示的な光学測定の模式図である。

30

【図 15】図 15 は、正しくないまたは望ましくない流体が流体回路の流動チャネル内にあるときに、これを特定し易くするために用いることができる例示的な電子測定の模式図である。

【図 16】図 16 は、正しくないまたは望ましくない流体が流体回路の流動チャネル内にあるときに、これを特定し易くするために用いることができる別の例示的な測定の模式図である。

【図 17】図 17 は、流動チャネル内にあるサンプル流体が 1 つ又は複数の気泡またはその他の望ましくない粒子を有するときに、それを特定する際に用いることができる例示的な例の模式図である。

【図 18】図 18 は、流動チャネル内にあるサンプル流体が 1 つ又は複数の気泡またはその他の望ましくない粒子を有するときに、それを特定する際に用いることができる別の例示的な例の模式図である。

40

【図 19】図 19 は、流動チャネル内にあるサンプル流体が 1 つ又は複数の気泡またはその他の望ましくない粒子を有するときに、それを特定する際に用いることができる例示的な例の模式図である。

【図 20】図 20 は、図 19 の流動チャネル内にあるサンプル流体に、圧力源によって供給することができる例示的な圧力パルス 900 を示すグラフである。

【図 21】図 21 は、流体回路の流動チャネルにおけるサンプル流体の末端または遠端の場所を判定または推定する際に用いることができる例示的な例の模式図である。

【図 22】図 22 は、2 つ又は 3 つ以上の流体が流体回路の下流において合流するときを

50

判定する際に用いることができる例示的な例の模式図である。

【図 2 3】図 2 3 は、2 つ又は 3 つ以上の流体が流体回路の下流において合流するときを判定する際に用いることができる例示的な例の模式図である。

【図 2 4】図 2 4 は、例示的な計器およびカートリッジの模式図であり、カートリッジを適正な向きでなければ計器内に挿入できないように、カートリッジおよび計器に位置を指示している。

【図 2 5】図 2 5 は、例示的なカートリッジの模式図である。

【図 2 6】図 2 6 は、ばね作動式ランセットを含む例示的なカートリッジの模式図である。

【図 2 7】図 2 7 は、流動チャネルからの気泡を除去するための膜を有する例示的なカートリッジの模式図である。

【図 2 8】図 2 8 は、流動チャネルにおける気泡の捕獲の例示的な例の模式図である。

10

【図 1】



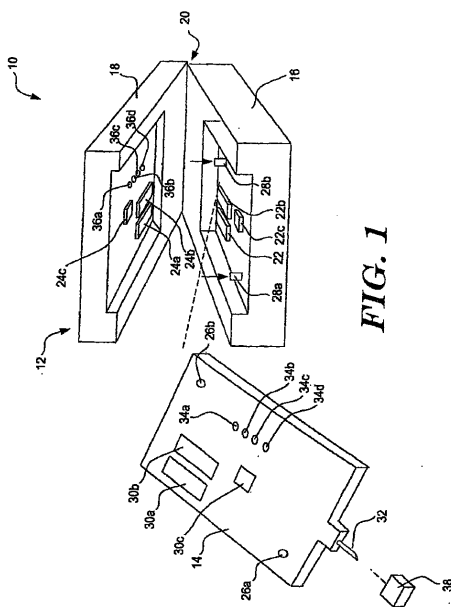


FIG. 1


【図 2】

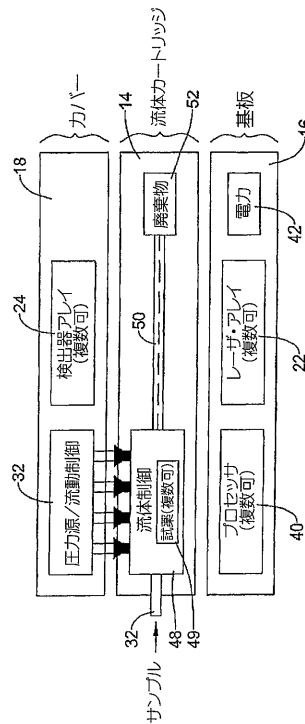


【図 3】

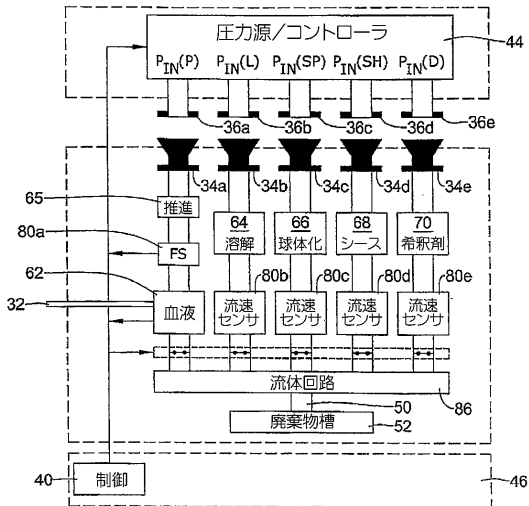


【図 4】

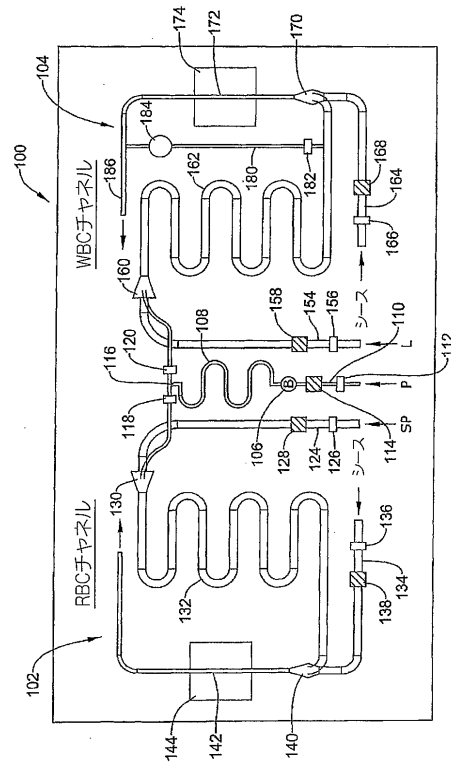


【図 5】

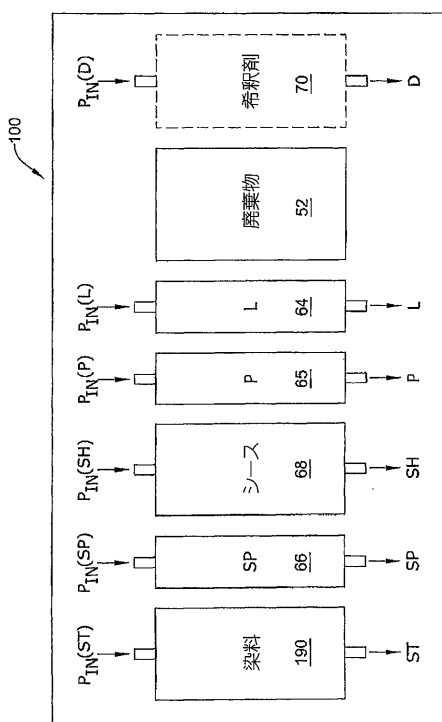


【図 6】

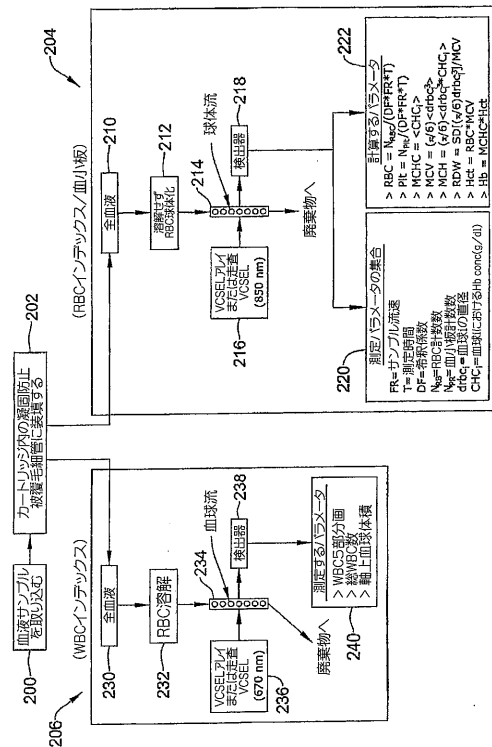


【図 7】

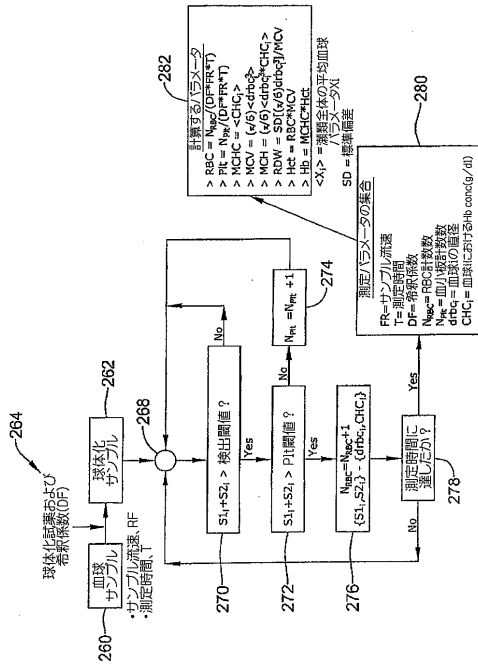

【図 8】

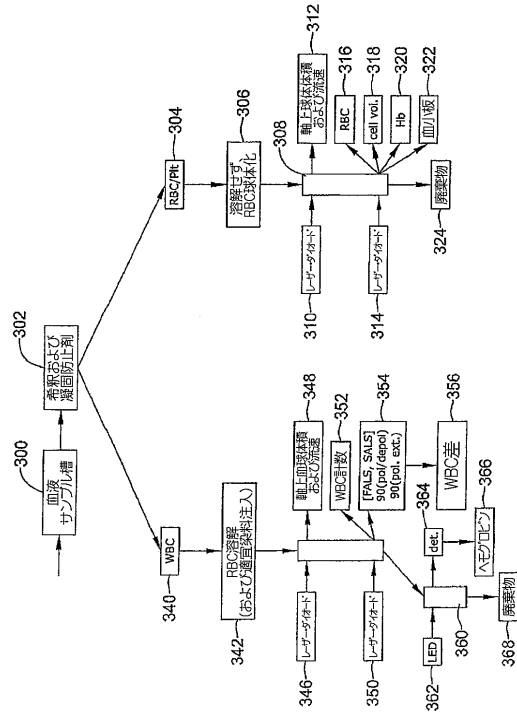

【図 9 a】

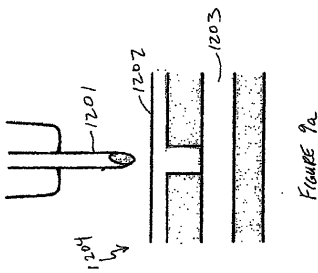

【図 9 b】

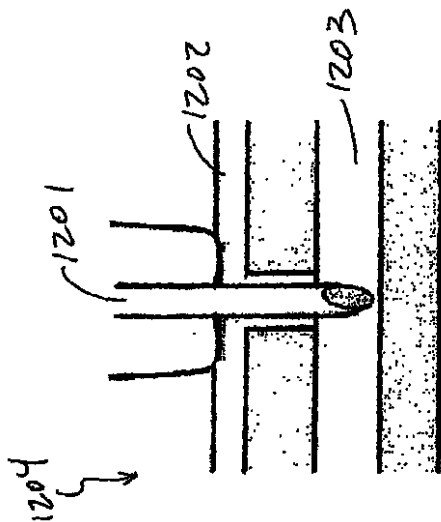


Figure 9b

【図 9 c】



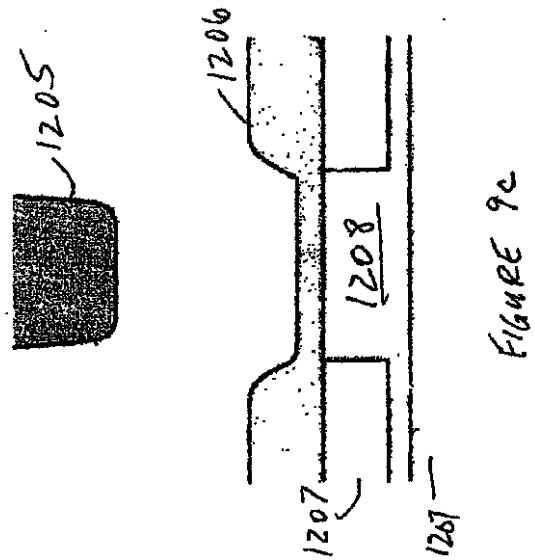


Figure 9c


【图 9 d】

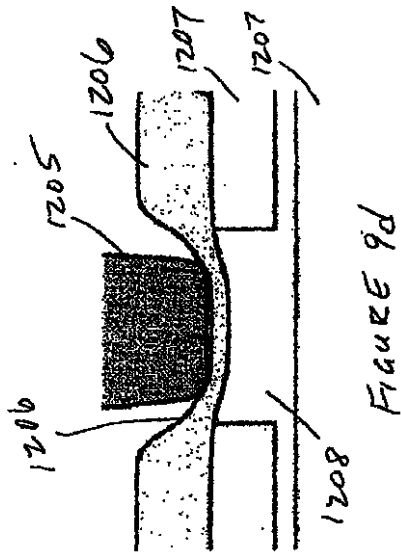


【 図 9 e 】

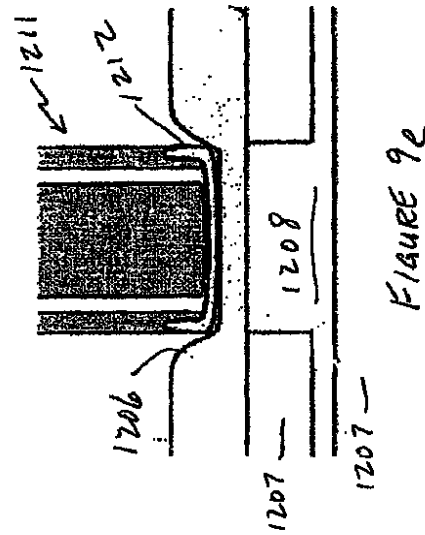

【图 9 f】

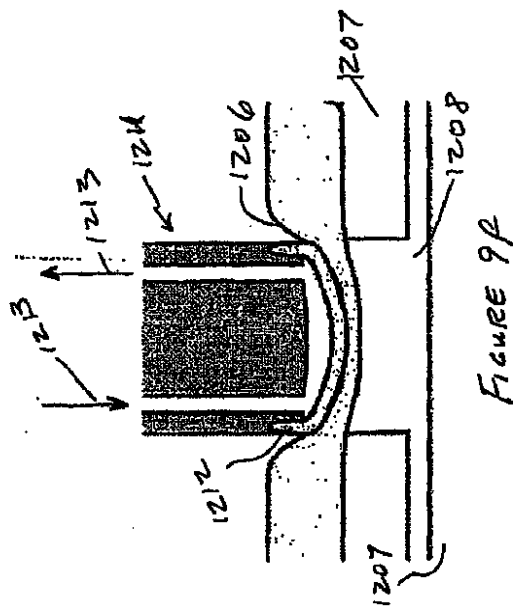



【 図 1 0 】

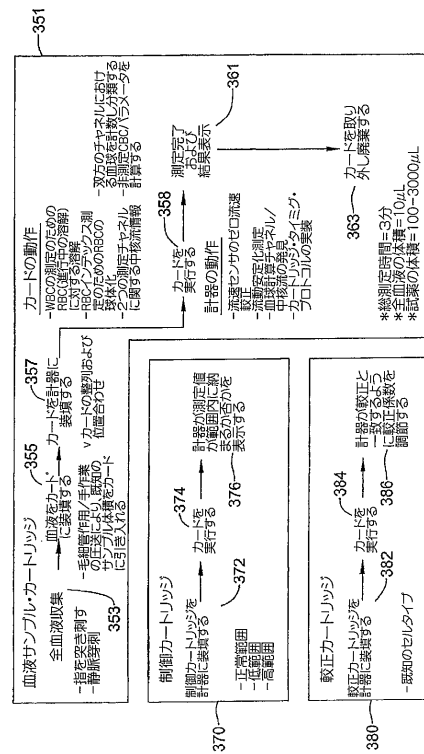

【図 9 g】

流 体	変位体積 { μ l}	ディスプレイサーストローク {mm}	貯蔵空洞の直径 {mm}
サンプル推進流体	8	1.1	3.4
溶解溶液	120	2.8	8.3
球体化溶液	300	3.8	11.3
ミース流体	1800	6.9	20

【図 1 1】

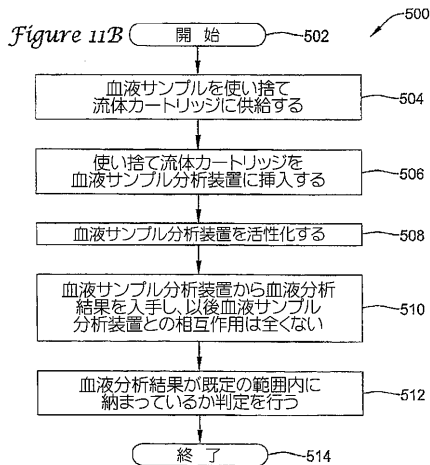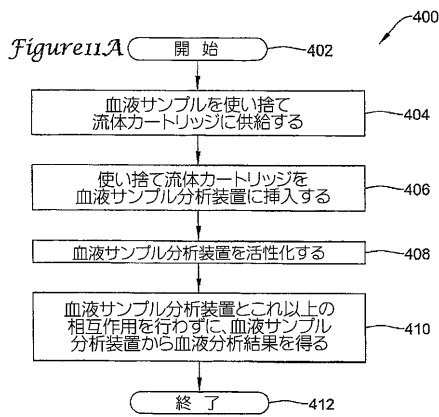

【図 1 3】




FIG. 13

【図 1 4】

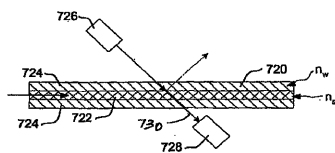


FIG. 14

【図 1 5】



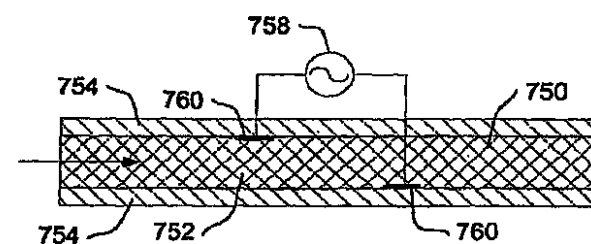


FIG. 15

【図 1 2】

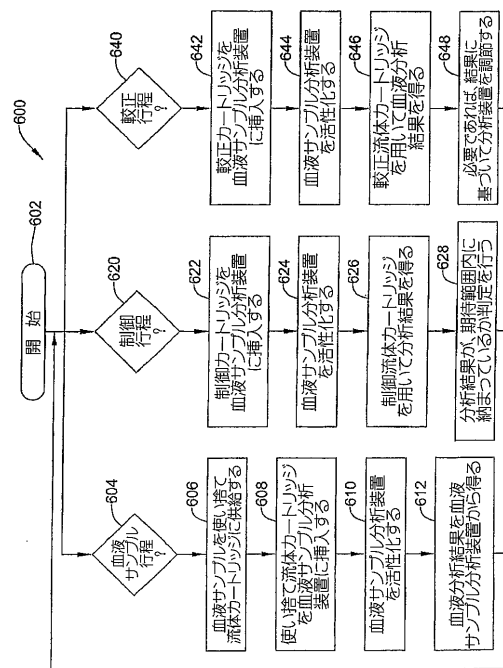

【図 1 6】

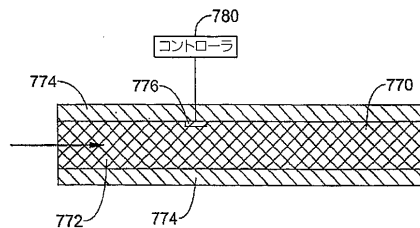

【図 1 7】

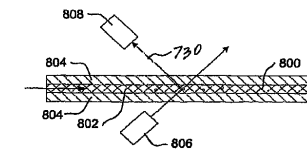


FIG. 17

【図 1 8】






FIG. 18


【図 19】

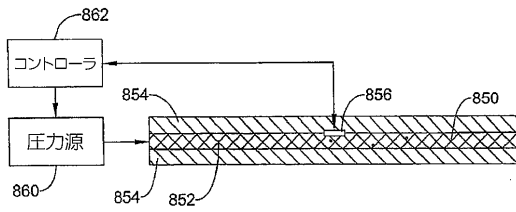


【図 20】

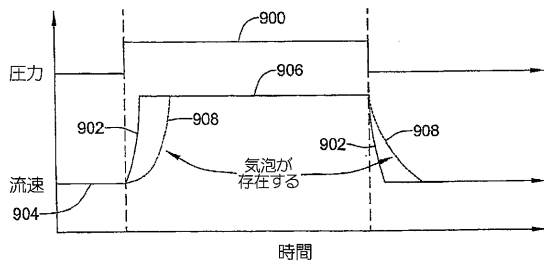


【図 21】

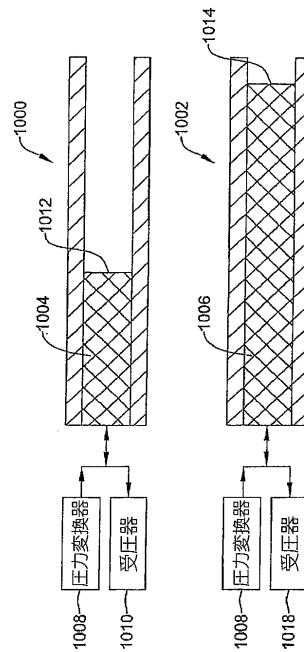

【図 22】

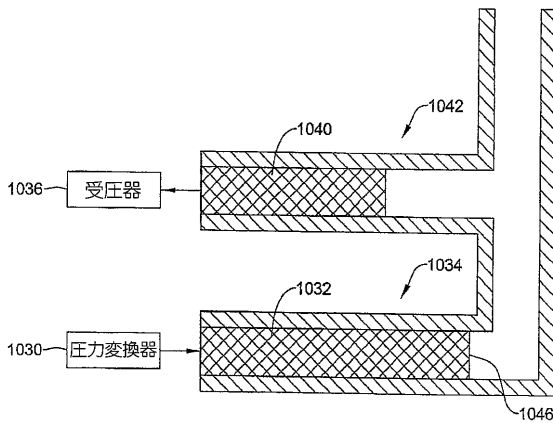

【図 23】

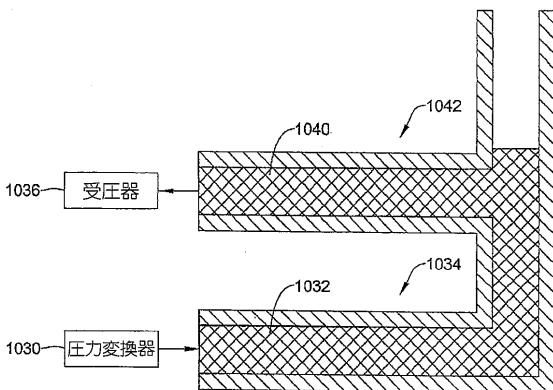

【図 24】

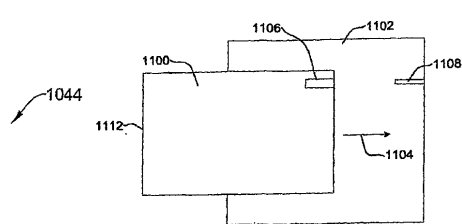


FIG. 24

【図 25】


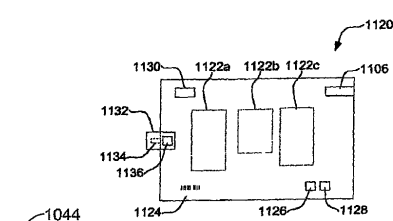


FIG. 25

【図 26】

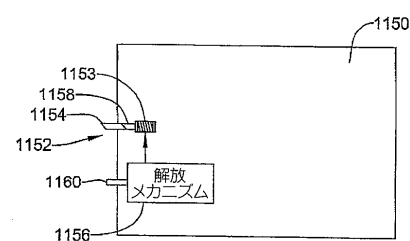

【図 27】

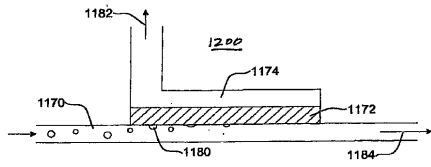


FIG. 27

【図 28】

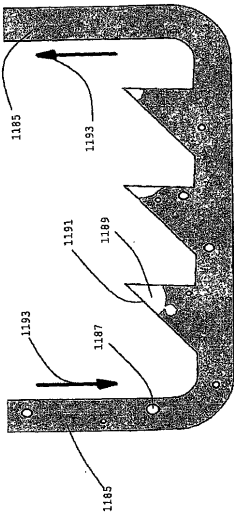


FIGURE 28

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/US2006/048851

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
INV. G01N35/08 G01N15/14 G01N33/49		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G01N B01L		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EP0-Internal		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2004/233424 A1 (LEE GWO-BIN [TW] ET AL) 25 November 2004 (2004-11-25) paragraphs [0009], [0012], [0015]; figure 1	1
X	US 2004/109386 A1 (GOLD KENNETH S [US] ET AL) 10 June 2004 (2004-06-10)	1
Y	paragraph [0023] paragraphs [0043] - [0047]; figures 1-4	2-4
Y	EP 0 694 784 A1 (HITACHI LTD [JP]) 31 January 1996 (1996-01-31) the whole document	2-4
X	US 2004/154933 A1 (COSOFRET VASILE V [US]) 12 August 2004 (2004-08-12) the whole document	1
----- -/--		
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 8 May 2007		Date of mailing of the international search report 20. 07. 2007
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3018		Authorized officer Cantalapiedra, Igor

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/US2006/048851

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2004/059316 A (UNIV MICHIGAN [US]; MARTIN STEVEN M [US]; OLSSON ROY H III [US]; BROWN) 15 July 2004 (2004-07-15) page 9, line 18 - page 12, line 2 -----	1
A	US 2003/057968 A1 (WANG DA YU [US] ET AL) 27 March 2003 (2003-03-27) paragraphs [0033] - [0037] -----	2-4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/US2006/048851

Box II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of Item 2 of first sheet)

This International Search Report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the International Application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful International Search can be carried out, specifically:

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of Item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see additional sheet

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this International Search Report covers all searchable claims.

2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.

3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this International Search Report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☒ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this International Search Report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

1-4

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

International Application No. PCT/ US2006/ 048851

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 210

This International Searching Authority found multiple (groups of) inventions in this international application, as follows:

1. claims: 1-4

cartridge comprising a flow channel with two electrodes designed to indicate a resistivity, a resistance or a capacity linked to a property of the fluid

2. claims: 5-8

cartridge comprising a flow channel with a sensor into the flow channel (being Ph, Thermal conductivity or specific heat sensor).

3. claims: 9-16

cartridge comprising a life time detector to indicate the age of cartridge

4. claims: 17, 18

cartridge with a spring activated lancet with a dial-in adjustment

5. claims: 19-22

cartridge comprising a flow channel with a porous membrane being a bubble trap.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/US2006/048851

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2004233424 A1	25-11-2004	TW 577855 B	01-03-2004
US 2004109386 A1	10-06-2004	US 2006186899 A1	24-08-2006
EP 0694784 A1	31-01-1996	DE 69525570 D1	04-04-2002
		DE 69525570 T2	22-08-2002
US 2004154933 A1	12-08-2004	CA 2515425 A1	26-08-2004
		EP 1592802 A2	09-11-2005
		JP 2006514307 T	27-04-2006
		US 2004256227 A1	23-12-2004
		WO 2004072606 A2	26-08-2004
WO 2004059316 A	15-07-2004	AU 2003299682 A1	22-07-2004
US 2003057968 A1	27-03-2003	NONE	

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I テーマコード (参考)
A 6 1 B 5/157 (2006.01) A 6 1 B 5/14 3 0 0 L

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
 EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
 BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
 CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,L
 A,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE
 ,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(74)代理人 100096013
 弁理士 富田 博行

(74)代理人 100153028
 弁理士 上田 忠

(72)発明者 ルーティマン, ピーター・エル
 アメリカ合衆国ミネソタ州 5 5 4 2 2, クリスタル, ズィーニア・アベニュー・ノース 3 4 5 4

(72)発明者 バドマナバン, アラヴィンド
 アメリカ合衆国ミネソタ州 5 5 4 4 6, プリマス, フォーティフィフス・アベニュー・ノース 1
 7 6 2 5

(72)発明者 コックス, ジェームズ・エイ
 アメリカ合衆国ミネソタ州 5 5 1 1 2, ニュー・ブライトン, トゥエンティシックス・アベニ
 ュー・ノースウエスト 1 8 4 2

(72)発明者 バーデル, ロン・エル
 アメリカ合衆国ミネソタ州 5 5 4 1 6, セント・ルイス・パーク, アラバマ・アベニュー・サウス
 4 1 5 0

(72)発明者 レザチェック, トム・エム
 アメリカ合衆国ミネソタ州 5 5 0 1 6, カティッジ・グローヴ, エイティセカンド・ストリート・
 サウス 6 3 3 7

(72)発明者 キャブズ, クレオパトラ
 アメリカ合衆国ミネソタ州 5 5 3 4 7, エデン・プレイリー, バックス・ウェイ 1 0 3 0 0

(72)発明者 フリッツ, バーナード・エス
 アメリカ合衆国ミネソタ州 5 5 1 2 3, イーガン, ディーアウッド・ドライブ 1 2 8 0

F ターム(参考) 2G058 DA00 GB06
 4C038 KL01 KL07 KX01 TA02 UE02 UE09