



(21) 申请号 202420128707.X

(22) 申请日 2024.01.18

(73) 专利权人 中国航天科工集团七三一医院
地址 100074 北京市丰台区云岗镇岗南里3号

(72) 发明人 田丽敏

(74) 专利代理机构 北京北汇律师事务所 11711
专利代理师 周志忠

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种PICC、中心静脉导管专用病号服

(57) 摘要

本实用新型公开了一种PICC、中心静脉导管专用病号服,属于病号服技术领域,其包括衣服主体,所述衣服主体的两侧设置有衣袖,至少一个所述衣袖的前端面形成有由衣袖上端延伸至衣袖口处的开口,所述开口处设置有拉链,所述拉链上设置有第一拉锁和第二拉锁,所述第一拉锁位于所述拉链的顶部且所述第二拉锁位于所述拉链的底部时,所述拉链呈闭合状态;所述第一拉锁朝向所述第二拉锁移动或者所述第二拉锁朝向所述第一拉锁移动时,所述拉链呈打开状态。本实用新型提供的PICC、中心静脉导管专用病号服可有效提高护士工作效率,提高患者就医体验,还可对输液管路起到固定作用,防止管路滑落。

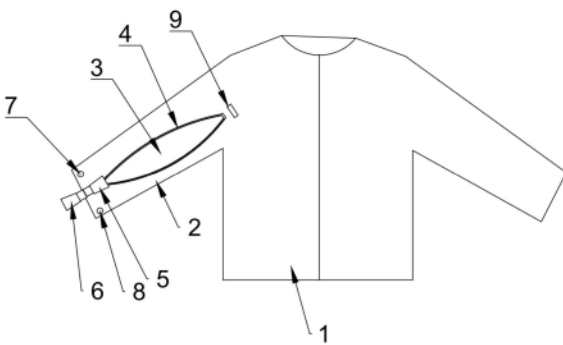

1. 一种PICC、中心静脉导管专用病号服,其特征在于,包括衣服主体(1),所述衣服主体(1)的两侧设置有衣袖(2),至少一个所述衣袖(2)的前端面形成有由衣袖上端延伸至衣袖口处的开口(3),所述开口(3)处设置有拉链(4),所述拉链(4)上设置有第一拉锁(5)和第二拉锁(6),所述第一拉锁(5)位于所述拉链(4)的顶部且所述第二拉锁(6)位于所述拉链(4)的底部时,所述拉链(4)呈闭合状态;所述第一拉锁(5)朝向所述第二拉锁(6)移动或者所述第二拉锁(6)朝向所述第一拉锁(5)移动时,所述拉链(4)呈打开状态。

2. 根据权利要求1所述的PICC、中心静脉导管专用病号服,其特征在于,所述拉链(4)、所述第一拉锁(5)和所述第二拉锁(6)均为塑料材质。

3. 根据权利要求1所述的PICC、中心静脉导管专用病号服,其特征在于,所述衣袖口处于所述开口(3)的一侧设置有固定扣(7),所述开口(3)的另一侧设置有与所述固定扣(7)相适应的固定环(8)。

4. 根据权利要求3所述的PICC、中心静脉导管专用病号服,其特征在于,所述固定扣(7)和所述固定环(8)的材质均为塑料材质。

5. 根据权利要求1所述的PICC、中心静脉导管专用病号服,其特征在于,所述开口(3)设置在位于衣服主体(1)左侧的所述衣袖(2)上。

6. 根据权利要求1所述的PICC、中心静脉导管专用病号服,其特征在于,所述衣袖(2)上端设置有弹性带(9),所述弹性带(9)靠近所述拉链(4)的上侧设置。

一种PICC、中心静脉导管专用病号服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及病号服技术领域,更具体地,涉及一种PICC、中心静脉导管专用病号服。

背景技术

[0002] 现有技术中,普通的病号服和平常上衣一样,不方便PICC、中心静脉导管患者的临床使用及日常维护,临床使用中患者需要把衣服扣子解开(长期卧床生活不能自理者需要第二个人帮助),或者一侧袖子全部脱掉,这样患者存在受凉、感染的风险,护士需要等待患者准备,从而降低了患者就医体验,降低了护士工作效率。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种PICC、中心静脉导管专用病号服,本实用新型提供的PICC、中心静脉导管专用病号服可有效提高护士工作效率,提高患者就医体验。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型的技术方案为:

[0005] 一种PICC、中心静脉导管专用病号服,包括衣服主体,所述衣服主体的两侧设置有衣袖,至少一个所述衣袖的前端面形成有由衣袖上端延伸至衣袖口处的开口,所述开口处设置有拉链,所述拉链上设置有第一拉锁和第二拉锁,所述第一拉锁位于所述拉链的顶部且所述第二拉锁位于所述拉链的底部时,所述拉链呈闭合状态;所述第一拉锁朝向所述第二拉锁移动或者所述第二拉锁朝向所述第一拉锁移动时,所述拉链呈打开状态。

[0006] 进一步地,所述拉链、所述第一拉锁和所述第二拉锁均为塑料材质。

[0007] 进一步地,所述衣袖口处于所述开口的一侧设置有固定扣,所述开口的另一侧设置有与所述固定扣相适应的固定环。

[0008] 进一步地,所述固定扣和所述固定环的材质均为塑料材质。

[0009] 进一步地,所述开口设置在位于衣服主体左侧的所述衣袖上。

[0010] 进一步地,所述衣袖上端设置有弹性带,所述弹性带靠近所述拉链的上侧设置。

[0011] 本实用新型的有益效果在于:

[0012] 本实用新型提供的PICC、中心静脉导管专用病号服,使用时,第一拉锁向下打开,可方便静脉输液无需患者解开衣服扣子,方便每班交接班时护士对管路观察是否在位,无需等待患者脱衣服的时间,既体现了人文关怀又节约了时间,方便患者的同时也有效提高了护士的工作效率;第二拉锁向上拉开,可方便置管和后期对管路的维护,保证患者保暖的情况下,实现无菌操作;此外,在患者静脉输液设置多组通路,需要使用三通时,可将三通放置在第一拉锁内部,通过第一拉锁对输液管路起到固定作用,防止管路滑脱。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的实施例。

[0014] 图1是本实用新型中拉链呈闭合状态的结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型中拉链呈打开状态的结构示意图。

[0016] 图3是本实用新型中拉链呈打开状态的另一结构示意图。

[0017] 附图标记说明:

[0018] 1、衣服主体;2、衣袖;3、开口;4、拉链;5、第一拉锁;6、第二拉锁;7、固定扣;8、固定环;9、弹性带。

具体实施方式

[0019] 下面结合说明书附图对本实用新型提供的结构进行详细的解释和说明。

[0020] 参考图1至图3所示,本实施例具体公开了一种PICC、中心静脉导管专用病号服,其包括衣服主体1,衣服主体1的两侧设置有衣袖2,至少一个衣袖2的前端面形成有由衣袖上端延伸至衣袖口处的开口3,开口3处设置有拉链4,拉链4上设置有第一拉锁5和第二拉锁6,第一拉锁5位于拉链4的顶部且第二拉锁6位于拉链4的底部时,拉链4呈闭合状态;第一拉锁5朝向第二拉锁6移动或者第二拉锁6朝向第一拉锁5移动时,拉链4呈打开状态。

[0021] 本实施例中,考虑到加工成本以及常规患者静脉输液时的习惯,优选仅在衣服主体1的左侧设置开口3和拉链4。当然,在一些其他实施例中,也可针对习惯右侧静脉输液的患者在衣服主体1的右侧设置开口3和拉链4,或者两侧同时设置均可。

[0022] 本实施例提供的PICC、中心静脉导管专用病号服,使用时,将第一拉锁5向下打开,可方便静脉输液无需患者解开衣服扣子,方便每班交接班时护士对管路观察是否在位,无需等待患者脱衣服的时间,既体现了人文关怀又节约了时间,方便患者的同时也有效提高了护士的工作效率;第二拉锁6向上拉开,可方便置管和后期对管路的维护,保证患者保暖的情况下,实现无菌操作;此外,在患者静脉输液设置多组通路,需要使用三通时,可将三通放置在第一拉锁5内部,即放置在开口3内,然后将第一拉锁5拉动到开口的上端,将管路固定在第一拉锁5与开口3上端内侧之间,从而可实现对输液管路固定的作用,防止管路滑落。

[0023] 继续结合图2所示,在衣袖口处于开口3的一侧设置有固定扣7,开口3的另一侧设置有与固定扣7相适应的固定环8。当第二拉锁6向上全部拉开时,将固定扣7扣在固定环8中,换药和维护时上肢可全部暴露,既可达到置管条件,也可避免患者受凉,提高患者舒适度。

[0024] 在一些实施例中,为方便患者进行核磁检测或CT检测,拉链4、第一拉锁5和第二拉锁6均为塑料材质;当然,固定扣7和固定环8的材质同样均为塑料材质。

[0025] 继续结合图3所示,衣袖2上端设置有弹性带9,弹性带9靠近拉链4的上侧设置,在拉链4上端的衣袖2上设置一弹性带9,可对管路进行初步固定,进一步保证管路的稳定性。进一步地,弹性带9的一端与衣袖2固定连接,另一端的连接可设置为可拆卸的方式,如在弹性带9的一端设置纽扣开口,在衣袖2的对应位置设置一纽扣,通过纽扣与纽扣开口实现可拆卸连接,方便将管路放入在弹性带9与衣袖2之间;在一些其他实施例中,也可在弹性带9的一端设置魔术贴毛面,在衣袖2的对应位置魔术贴勾面,通过魔术贴毛面与魔术贴勾面实

现该端的可拆卸连接,当然,术贴毛面与魔术贴勾面设置位置可互换,在此不做具体限制。

[0026] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0027] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0028] 在本说明书的描述中,参考术语“本实施例”、“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任至少一个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0029] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

[0030] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型实质内容上所作的任何修改、等同替换和简单改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

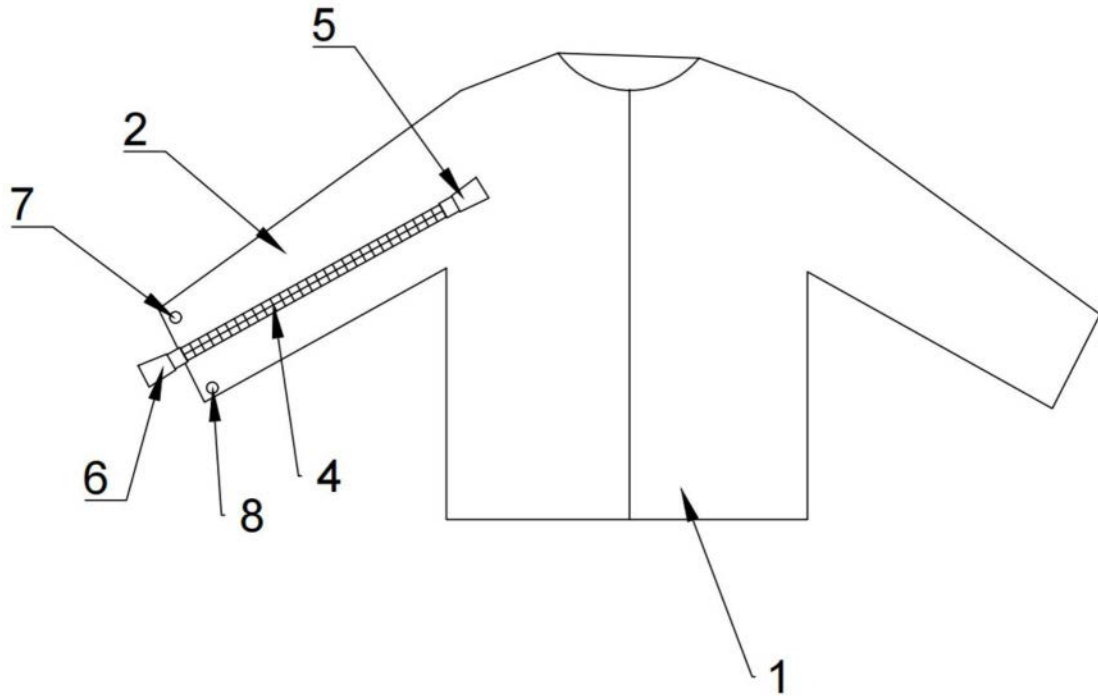


图1

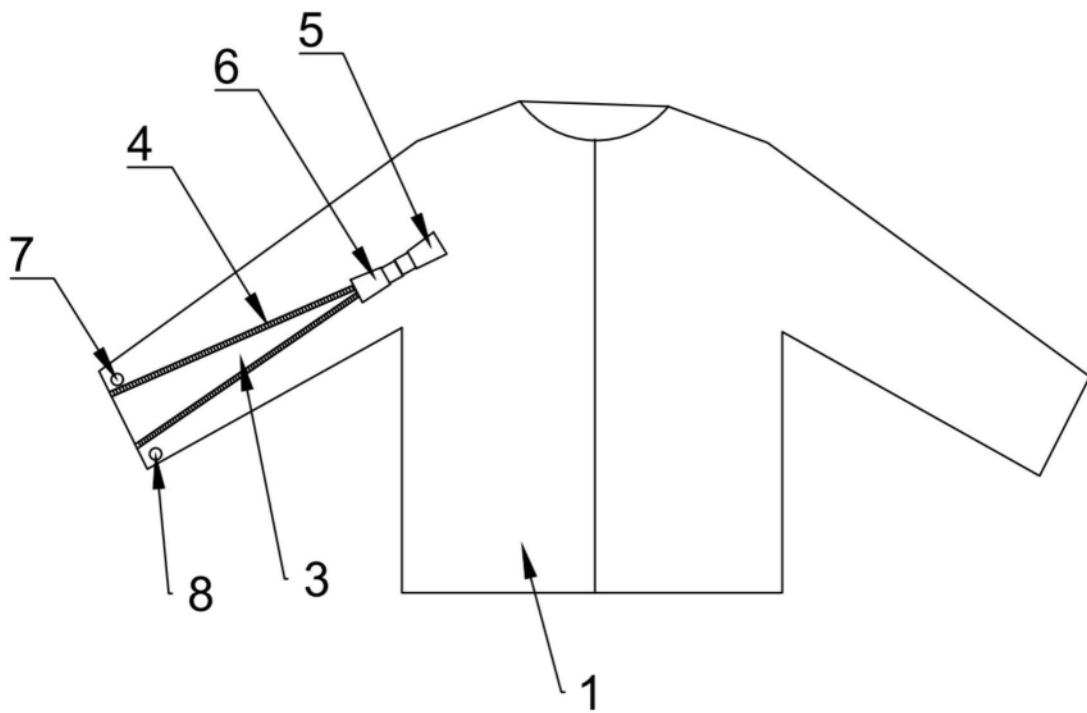


图2

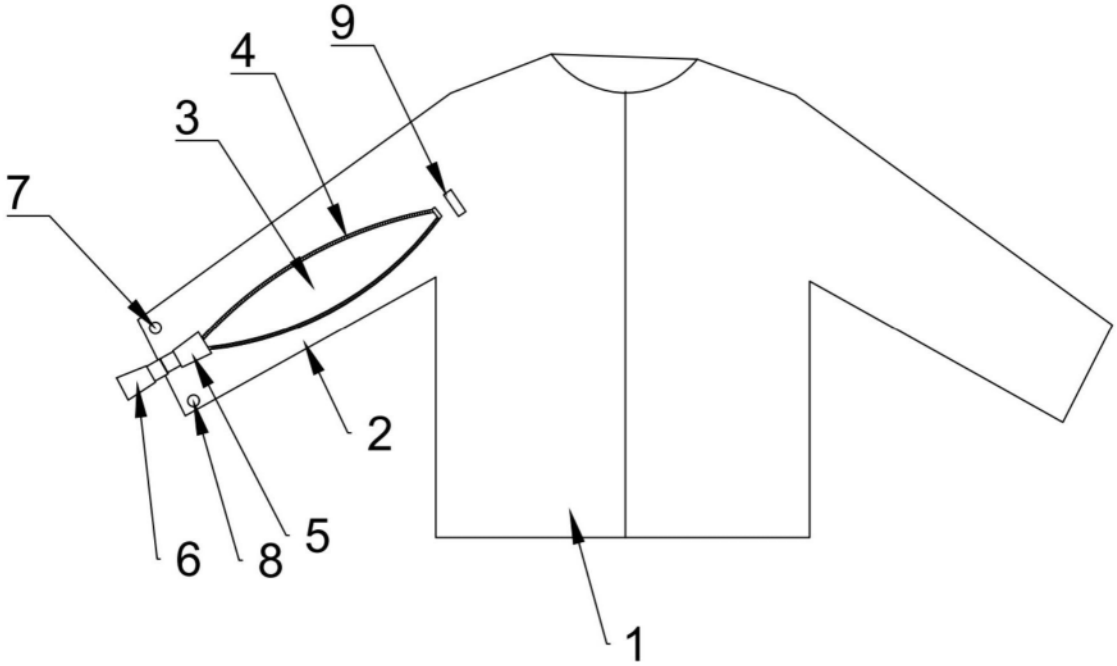


图3