

(11) 공개번호 10-2019-0136731
(43) 공개일자 2019년12월10일

(71) 출원인
인하대학교 산학협력단
인천광역시 미추홀구 인하로 100(용현동, 인하대
학교)

(72) 발명자
이우기
경기도 군포시 산본로432번길 25, 1222동 1302호
(산본동, 한양목련아파트)

권현도
경상북도 안동시 강남1길 98-23, 305동 506호 (정
하동, 현진에버빌3차)

(74) 대리인
네이트특허법인

전체 청구항 수 : 총 37 항


(54) 발명의 명칭 청음 향상을 위한 두경부 물리 특성 기반 복합시스템

(57) 요약

본 발명은 화자의 발화 의도에 따른 화자의 두경부 조음기관의 물리특성을 구강설 센서를 포함한 두경부의 센서를 통해 파악하고, 이를 신호화하여 환경적 내지 신체적 장애 요인으로 인해 청음에 제한이 있는 화자 내지 청자에게 효율적으로 전달하는 장치 및 시스템에 관한 것이다.

(뒷면에 계속)

대표도

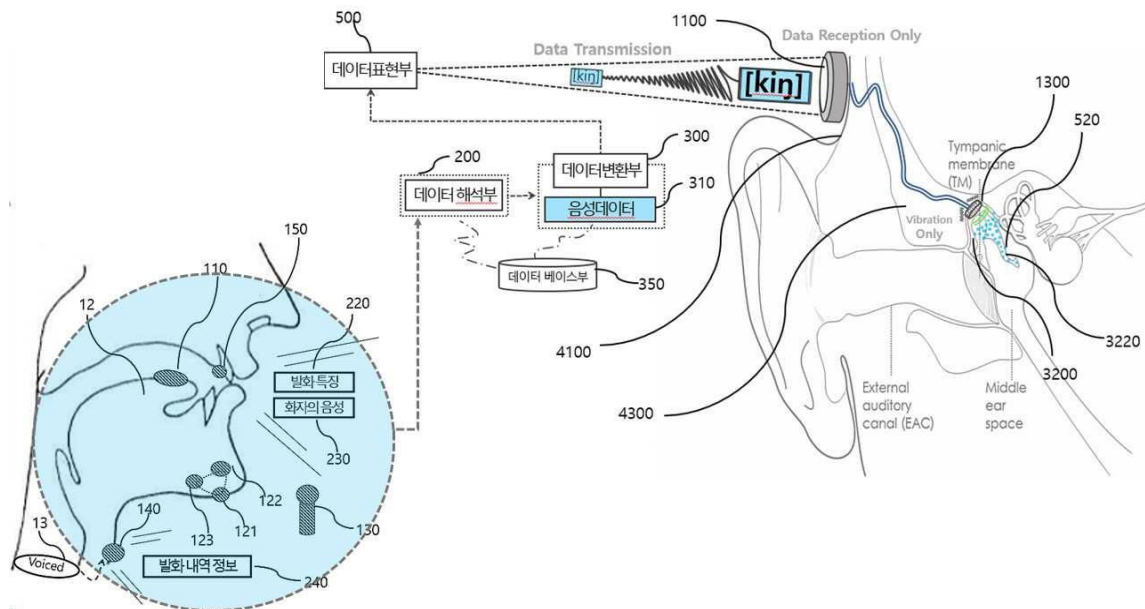

화자(10)의 두정부의 일면에 인접하여 조음기관의 물리특성을 측정하는 센서부(100)와, 상기 센서부의 위치(210)와 측정된 조음 기관의 물리특성을 기반으로 화자의 하나이상의 발화 특징(220)을 파악하는 데이터 해석부(200)와, 상기 하나이상의 센서부의 위치(210)와 상기 하나이상의 발화 특징(220)을 음성데이터(310)로 변환하는 데이터변환부(300)와, 상기 음성데이터(310)를 음파(510), 진동파(520), 충전기자극(530) 중 하나이상의 형태로 외부로 표현하는 데이터 표현부(500)를 포함하고, 상기 데이터 표현부(500)는 상기 음성데이터(310)를 화자, 청자 중 일인이상에게 제공하고자 전송장치(1000)로 구성되는 것을 특징으로 한다.

(52) CPC특허분류

A61N 1/36038 (2017.08)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 K_G011008258001

부처명 한국과학기술원

연구관리전문기관 한국산업기술평가관리원

연구사업명 산업핵심기술개발사업

연구과제명 지식기반 플랜트 O&M을 위한 지식베이스 프레임워크 통합시스템 개념설계 개발

기 여 율 1/1

주관기관 기타공공기관

연구기간 2017.10.01 ~ 2018.05.31

명세서

청구범위

청구항 1

화자(10)의 두경부의 일면에 인접하여 조음기관의 물리특성을 측정하는 센서부(100)와,

상기 센서부의 위치(210)와 측정된 조음기관의 물리특성을 기반으로 화자의 하나 이상의 발화 특징(220)을 파악하는 데이터 해석부(200)와,

상기 하나 이상의 센서부의 위치(210)와 상기 하나이상의 발화 특징(220)을 음성데이터(310)로 변환하는 데이터 변환부(300)와,

상기 음성데이터(310)를 음파(510), 진동파(520), 청전기자극(530) 중 하나이상의 형태로 외부로 표현하는 데이터 표현부(500)를 포함하고,

상기 데이터 표현부(500)는 상기 음성데이터(310)를 화자, 청자 중 일인이상에게 제공하고자 전송장치(1000)로 구성되는 것

을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 센서부(100)는 구강설의 일측면에 고착되거나, 구강설의 표면을 감싸거나, 구강설의 내부에 삽입되어 발화에 따른 구강설의 x축, y축, z축 방향 기반의 시간에 따른 벡터량의 변화량을 파악함으로써, 구강설의 저고도, 전후설성, 굴곡도, 신전도, 회전도, 긴장도, 수축도, 이완도, 진동도 중 하나이상의 물리 특성을 파악하는 구강설 센서(110)를 포함하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 센서부(100)는 구강설의 일측면에 고착되거나, 구강설의 표면을 감싸거나, 구강설의 내부에 삽입되어 발화에 따른 구강설의 x축, y축, z축 방향 기반의 단위 시간 당 회전하는 각도의 변화량을 파악함으로써, 구강설의 저고도, 전후설성, 굴곡도, 신전도, 회전도, 긴장도, 수축도, 이완도, 진동도 중 하나이상의 물리 특성을 파악하는 구강설 센서(110)를 포함하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 센서부(100)는 구강설의 일측면에 고착되거나, 구강설의 표면을 감싸고, 발화에 따른 구강설의 수축 내지 이완으로 발생하는 물리력에 따라 결정 구조(111)의 변화에 의해 편극이 발생하여 전기신호가 발생하는 압전소자(112)를 통해 구강설의 굽힘도를 파악함으로써, 구강설을 포함한 조음기관의 물리 특성을 파악하는 구강설 센서(110)를 포함하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 센서부(100)는 구강설이 두경부 내외의 다른 조음기관과의 상호작용에 의해 생기는 접근 및 접촉에 의해 발생하는 마찰전기(Tribo Electric Generator)에 따른 파열도, 마찰도, 공명도. 접근도 중 하나이상의 물리특성

을 파악하기 위해 마찰대전소자(113)로 구성된 구강설 센서(110)를 포함하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 데이터 해석부는 상기 센서부에서 측정되는 구강설과 타 조음기관과의 물리특성을 통해 화자가 발화하는 자모음, 그에 따라 나타나는 어휘 단위 강세 (Lexical Stress), 문장 단위 강세(Tonic stress) 중 하나 이상의 발화 특징(220)을 파악하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 데이터 해석부는 상기 센서부에 의해 측정되는 조음기관 물리특성에 의한 발화 특징(220)을 파악함에 있어서, 2진수 내지 실수를 포함하는 수치로 구성된 표준 발화 특징 행렬(205)을 기반으로 화자의 발음과 강세의 정도, 유사근접도, 발화 의도 중 하나 이상의 발화 특징(220)을 측정하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 8

제6항에 있어서,

상기 데이터 해석부는 상기 센서부(100)에서 측정된 조음기관의 물리특성을 발화 특징(220)으로 파악함에 있어서,

상기 조음기관의 물리특성을 각 자모음 단위의 패턴으로 인식하는 단계,

상기 자모음 단위의 패턴의 특징을 추출하고, 상기 분류된 패턴의 특징을 유사도에 따라 분류하는 단계,

분류된 패턴의 특징을 재조합하는 단계,

조음기관의 물리특성을 발화 특징으로 해석하는 단계에 따라 발화 특징을 파악하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 9

제7항에 있어서,

상기 데이터 해석부는 상기 센서부에 의해 측정되는 물리특성에 의해 자모음의 동화(Assimilation), 이화(Dissimilation), 탈락(Elision), 첨가(Attachment), 강세(Stress)와, 약화(Reduction)로 야기되는 기식음화(Asperation), 음절성자음화(Syllabic consonant), 탄설음화(Flapping), 경음화(Tensification), 순음화(Labialization), 연구개음화(Velarization), 치음화(Dentalization), 구개음화 (Palatalization), 비음화(Nasalization), 강세변화(Stress Shift), 장음화(Lengthening) 중 하나 이상의 이차조음현상인 발화 변이(250)를 측정하는 것을 특징으로 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 10

제2항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 구강설 센서는 센서 작동을 위한 회로부, 그 회로를 감싸는 캡슐부, 상기 구강설 일면에 부착되는 접촉부로 구성된 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 11

제10항에 있어서,

상기 구강설 센서는 박막 회로를 가진 필름 형태로써 구강설에 인접하여 작동하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 12

제1항에 있어서,

상기 센서부(100)는 하나이상의 안면 근육의 일면에 인접하는 두경부 근육의 신경신호 측정의 기준 전위를 생성하는 하나 이상의 레퍼런스 센서(121)과 상기 두경부 근육의 신경신호를 측정하는 하나이상의 양극센서(122)와 하나 이상의 음극센서(123)으로 구성되는 안면 센서(120)를 더욱 포함하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 13

제12항에 있어서,

상기 데이터 해석부(200)는 안면부 센서(120)에 기반한 센서부의 위치(210)를 획득함에 있어서, 상기 레퍼런스 센서(121)를 기준으로 하여 상기 양극 센서(122)와 상기 음극센서(123)의 전위차를 파악하여 상기 안면부 센서(120)의 위치를 파악하는 것을 특징으로 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 14

제12항에 있어서,

상기 데이터 해석부(200)는 안면부 센서(120)에 기반한 화자의 발화 특징(220)을 획득함에 있어서, 상기 레퍼런스 센서(121)를 기준으로 하여 상기 양극 센서(122)와 상기 음극센서(123)의 전위차를 파악하여 상기 화자의 두경부에서 발생하는 조음기관의 물리 특성에 의한 발화 특징(220)을 파악하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 15

제1항에 있어서,

상기 센서부(100) 내지 데이터 해석부(200)는 화자(10)의 두경부 중 성대에 인접하여 성대의 근전도 내지 떨림을 파악하여, 화자(10)의 발화 시작, 발화 정지, 발화 종료 중 하나이상의 발화 내역 정보(240)를 파악하는 성대 센서(140)를 포함하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 16

제1항에 있어서,

상기 데이터 해석부(200)는 발화에 따른 화자의 두경부 조음기관의 변화 정보(161), 화자의 두경부 표정 변화 정보(162), 화자의 발화 의도에 따라 움직이는 두경부, 흉곽부, 상지부, 하지부의 비언어적 표현(163)을 파악하기 위해 화자(10)의 두경부를 촬상하는 촬상 센서(160)과 연동되는 것을 특징으로 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 17

제1항에 있어서,

상기 센서부는 치아의 일면에 인접하여 상기 구강설 및 아랫 입술의 접촉에 기인하여 발생하는 전기적 용량 변화에 따른 신호발생 위치를 파악하는 치아센서(150)를 더욱 포함할 수 있는 것을 특징으로 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 18

제1항에 있어서,

상기 데이터 해석부(200)는 상기 화자의 두경부 일면에 인접한 음성취득센서(130)를 통해 발화에 따른 상기 화자의 음성(230)을 취득하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 19

제18항에 있어서,

상기 데이터 변환부(300)는 상기 음성취득센서(130)에서 취득된 화자의 음성(230)을 상기 구강설 센서(110) 내지 안면센서(110)에 의해 획득된 센서부의 위치(210) 내지 화자의 발화 특징(220)와 함께 음성데이터(310)로 변환하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 20

제1항에 있어서,

상기 센서부(100)의 구강설 센서, 안면센서, 음성취득센서, 성대센서, 치아 센서 중 하나이상의 센서에 전원을 공급하는 전원부를 포함하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 21

제1항에 있어서,

상기 센서부는 데이터 해석부 내지 데이터 베이스부 중 하나이상 이 외부에 위치하여 작동할 경우, 연동되어 통신할 수 있는 유선 내지 무선의 통신부(400)를 포함하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 22

제1항에 있어서,

상기 데이터변환부(300)는 상기 센서부의 위치(210), 화자의 발화 특징(220), 화자의 음성(230)에 대응하는 하나 이상의 음성데이터 색인(360)을 포함하는 데이터 베이스부(350)와 연동되는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 23

제22항에 있어서,

상기 데이터 베이스부(350)는 발화의 진행 시간, 발화에 따른 주파수, 발화의 진폭, 발화에 따른 두경부 근육의 근전도, 발화에 따른 두경부 근육의 위치변화, 구강설의 굽힘 및 회전에 따른 위치 변화 중 하나이상의 정보를 기반으로, 자모음의 음소단위 색인(361), 음절 단위 색인(362), 단어단위 색인(363), 구절단위 색인(364), 문장

단위 색인(365), 연속 발화 단위 색인(366), 발음의 고저 색인(367) 중 하나 이상의 음성데이터 색인(360)을 구성하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 24

제1항에 있어서,

상기 데이터 표현부는 상기 전음장치(1000)와 더불어, 디스플레이(2000)에 의해 음운론 기호, 음성학 기호, 안내 표식, 그림 중 하나 이상의 부가적 표현으로 외부로 더욱 표현하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 25

제1항 내지 제16항 중 어느 한항에 있어서,

상기 데이터 변환부(300)는 상기 활상센서(160)에 의한 두경부 조음기관의 변화정보(161), 두경부 표정변화정보(162), 비언어적 표현(163) 중 하나이상의 활상정보를 상기 센서부(100)에 의한 조음 기관의 물리 특성에 기반한 음성데이터(310)와 맵핑하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 26

제1항에 있어서,

상기 데이터 표현부(500)의 전음장치(1000)는 데이터수신부(1100)와 스피커부(1200), 전도진동부(1300), 전기전갈부(1400) 중 하나이상으로 구성되며, 화자, 청자 중 일인이상의 청각계(3000) 내지 유사대체기관중(4000)에 위치하여 상기 음성데이터(310)를 제공하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 27

제26항에 있어서,

상기 데이터 표현부(500)의 전음장치(1000)를 구성하는 스피커부(1200)는 상기 변환된 음성데이터(310)를 음파(510)로 재변환시켜 제공하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 28

제27항에 있어서,

상기 스피커부(1200)가 상기 음성데이터(310)를 음파(510)로 제공함에 있어서,

상기 음성데이터(310)의 각 자모음이 지닌 주파수 F값(Formant Frequency)의 고주파수 영역 내지 전체 영역을 선형, 비선형, 압축증폭 중 하나 이상의 방법으로 증폭 내지 감소시키고자 증감조절부(1210)를 포함하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 29

제26항에 있어서,

상기 데이터 표현부(500)의 전음장치(1000)를 구성하는 전도진동부(1300)는 상기 변환된 음성데이터(310)를 진동자(1310)를 통해 진동파(520)로 재변환시켜 제공하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 30

제26항에 있어서,

상기 데이터 표현부(500)의 전음장치(1000)를 구성하는 전기전달부(1400)는 상기 청각계(3000)의 내이(3310) 중 달팽이관(3320)의 내부 내지 외부 일면에 하나이상의 기준전달전극(1410)을 배치하고, 상기 달팽이관(3320)의 내부 일면에 하나이상의 활성전달전극(1420)을 배치하여 전류를 흘림으로서, 상기 음성데이터(310)를 청전기자극(530)으로 재변환시켜 제공하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 31

제26항에 있어서,

상기 데이터 표현부의 전음장치(1000)는 그 데이터수신부(1100)와 스피커부(1200) 내지 전도진동부(1300)가 화자, 청자 중 일인이상의 청각계(3000) 중 외이(3100)에 인접하거나 그 내부에 삽입되어 상기 음성데이터(310)를 중이(3200)에 송출, 증폭, 감소 중 하나이상의 방법으로 제공하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 32

제26항에 있어서,

상기 데이터 표현부의 전음장치(1000)는 화자, 청자 중 일인이상의 청각계(3000) 중 외이(3100)에 인접한 데이터수신부(1100)가 상기 음성데이터(310)를 수신하고, 중이(3200)에 인접한 상기 전도진동부(1300) 내지 전기전달부(1400)는 상기 음성데이터(310)를 중이(3200)에 송출, 증폭, 감소 중 하나이상의 방법으로 제공하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템

청구항 33

제26항에 있어서,

상기 데이터 표현부의 전음장치(1000)는 화자, 청자 중 일인이상의 두경부 일측외면(4100)에 위치한 데이터수신부(1100)가 상기 음성데이터(310)를 수신하고, 그에 연속하는 상기 전도진동부(1300)가 상기 음성데이터를 상기 두경부 측면 내골(4300)을 매개로 청각계(3000) 중 내이(3300)에 송출, 증폭, 감소 중 하나이상의 방법으로 제공하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 34

제26항에 있어서,

상기 데이터 표현부의 전음장치(1000)는 화자, 청자 중 일인이상의 두경부 일측외면(4100)에 위치한 데이터수신부(1100)가 상기 음성데이터(310)를 수신하고, 청각계(3000) 중 중이(3200)에 위치한 상기 전도진동부(1300)가 상기 음성데이터(310)를 청소골(3220)에 송출, 증폭, 감소 중 하나이상의 방법으로 제공하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 35

제26에 있어서,

상기 데이터 표현부의 전음장치(1000)는 화자, 청자 중 일인이상의 두경부 일측외면(4100)에 위치한 데이터수신

부(1100)가 상기 음성데이터(310)를 수신하고 상기 데이터수신부(1100)와 인접한 제1전도진동부(1301)가 상기 음성데이터(310)를 선행하여 전달하고, 상기 청각계(3000) 중 중이(3200)의 일면에 위치한 제2전도진동부(1302)가 상기 제1전도진동부(1301)에서 전달된 음성데이터(310)를 청소골(3220)에 송출, 증폭, 감소 중 하나 이상의 방법으로 제공하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 36

제26항에 있어서,

상기 데이터 표현부의 전음장치(1000)는 화자, 청자 중 일인이상의 두경부 일측외면(4100)에 위치한 데이터수신부(1100)가 상기 음성데이터(310)를 수신하고, 청각계(3000) 중 내이(3300)에 위치한 전기전달부(1400)가 상기 음성데이터(310)를 상기 내이(3300)의 청신경(3320)에 송출, 증폭, 감소 중 하나 이상의 방법으로 제공하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

청구항 37

제26항에 있어서,

상기 데이터 표현부의 전음장치(1000)는 화자, 청자 중 일인이상의 두경부 일측외면(4100)에 위치한 데이터수신부(1100)가 상기 음성데이터(310)를 수신하고, 두경부 일측 내면(4200)으로 이어져 대뇌(3330)에 인접한 전기전달부(1400)가 상기 음성데이터(310)를 대뇌(3330)에 송출, 증폭, 감소 중 하나 이상의 방법으로 제공하는 것을 특징으로 하는 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 센서를 통해 구강설을 포함한 두경부의 조음기관의 물리 특성을 인지하고, 이를 통해 발화 의도를 파악하여, 이를 신호화하여 환경적 내지 신체적 장애 요인으로 인해 청음에 제한이 있는 화자 내지 청자에게 효율적으로 전달하는 장치 및 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 조음기관에서 생성되는 음성은 언어학적 정보전달인 의사소통을 위한 경우에는 발화 혹은 언어음으로 불리며 비 언어학적인 경우에는 발성으로 불린다. 음성의 생성에 관여하는 인체의 주요한 구조물을 신경계통과 호흡기계통이다.

[0004] 신경계통은 중추신경계와 말초신경계가 관여하는데 중추신경 중 뇌간에는 언어의 생성에 필요한 두개골 혹은 뇌신경 세포핵이 위치하며 소뇌는 동작에 대한 근육의 제어를 정밀하게 조율하는 기능이 있으며, 대뇌의 반구는 언어기능에 지배적인 역할을 한다. 언어음 생성을 위해 관여하는 두개골 신경에는 턱의 움직임을 관여하는 제 5 뇌신경, 입술운동에 관여하는 제 7 뇌신경, 인두 및 후두의 운동에 관여하는 제 10 뇌신경, 인두의 운동에 관여하는 제 11 뇌신경, 그리고 혀의 운동에 관여하는 제 12 신경 등이 있다. 말초신경 중에는 특히 미주신경에서 분지되는 상후두신경과 반회후두신경이 후두운동에 직접 관여하게 된다.

[0006] 또한 언어음은 하부 호흡기계, 후두와 성도가 상호 밀접하게 작용하여 생성된다. 성대는 음성의 근원으로, 폐로부터 송출되는 호기의 흐름이 성대를 진동시키고 발성 시 호기조절은 소리 에너지를 적절히 능률적으로 공급한다.

[0007] 성대가 적당히 긴장하여 폐쇄되면 호기(호흡기류)에 의해 성대가 진동하고 성문을 일정한 주기로 개폐시켜 성문을 통과하는 호흡기류를 단속하는데 이 호흡기류의 단속으로 인해 음성이 형성된다.

- [0009] 사람이 의사소통을 목적으로 말을 사용하기 위해서는 여러 가지 생리적인 과정을 거쳐야 한다. 조음과정은 발성된 소리가 공명과정을 거쳐 증폭 및 보완된 후, 말소리의 단위인 음소를 형성해 가는 과정을 의미한다. 조음기관으로는 혀가 가장 중요하게 생각되지만, 실제로 음소를 만드는 데는 혀뿐 아니라 구강 및 안면의 여러 가지 구조들이 관여한다. 이러한 조음기관에는 혀, 입술, 여린입천장(연구개, soft palate), 턱 등과 같이 움직일 수 있는 구조와 치아나 굳은입천장(경구개, hard palate)과 같이 움직일 수 없는 구조들이 포함된다. 이러한 조음기관들이 공기의 흐름을 막거나 제약하여 자음과 모음을 형성하게 되는 것이다.
- [0010] 첫 번째 조음기관으로 혀는 그 부위들이 뚜렷한 경계선을 나타내지 않기 때문에 구별하는 것이 쉽지는 않으나 기능적인 측면에서 혀의 외부구조를 구별하는 것은 정상적인 조음뿐 아니라 병리적인 조음을 이해하는데 도움이 된다. 혀는 앞에서부터 혀끝(apex, tip), 혀날(blade), 혀등(dorsum), 혀몸통(body), 그리고 혀뿌리(root)로 나눌 수 있다. 혀끝을 우리가 혀를 뽀족하게 내밀거나 음절의 첫소리로 오는 /ㄹ/ (예: “라라라”)를 조음할 때 사용되는 부위이고, 혀날은 잇몸소리(치조음 alveolar sounds)와 같은 입의 앞쪽에서 만드는 음소들을 조음할 때 주로 사용되며, 혀등은 여린입천장소리(연구개음 velar sounds)와 같은 뒷소리 음소들을 조음할 때 주로 사용되는 혀의 부분이다.
- [0011] 두 번째로 조음기관으로 입술은 입의 입구를 이루는 부분으로 두정부 표정이나 조음에 중요한 기능을 한다. 특히 여러 가지 모음들은 혀의 움직임뿐만 아니라 입술의 모양에 의하여 음소가 구별되며, 두입술자음(양순자음 bilabial sound)들은 입술이 닫혀져야만 발음될 수 있다. 입술의 모양은 주변의 근육들에 의하여 변형된다. 예를 들어, 입술 주변을 둘러싸고 있는 입둘레근(구륜근 orbicularis oris muscle)은 입술을 다물거나 오므라들게 하여 두입술자음이나 /우/와 같은 원순모음들 발음하는 데 중요한 역할을 하며, 윗입술올림근(quadratus labii superior muscle)과 아랫입술내림근(quadrates labii inferior muscle)은 입술을 열게 한다. 또한, 입꼬리당김근(소근 risorius muscle)은 입술의 모서리를 잡아당겨 미소를 짓거나 입술을 수축시켜서 발음해야 하는 /이/와 같은 소리를 낼 때 중요한 역할을 한다.)
- [0012] 세 번째 조음기관은 턱과 치아로 턱은 움직이지 않는 위턱(상악 maxilla)과 상하 및 좌우 운동을 하는 아래턱(하악 mandible)으로 구분된다. 이들 턱은 얼굴 뼈 중에서 가장 튼튼하고 큰 뼈로서 4쌍의 근육들에 의해서 움직인다. 아래턱의 움직임은 입안의 크기를 변화시키기 때문에 씹기뿐만 아니라 모음산출에 있어서도 중요하다.
- [0013] 네 번째 조음기관은 잇몸 및 굳은입천장으로 잇몸은 /ㄷ/나 /ㅌ/ 계열의 말소리들이 조음되는 부위이며 굳은 입천장은 잇몸 뒤의 단단하고 다소 편편한 부분으로 /ㅈ/ 계열의 소리들이 조음되는 부위이다.
- [0014] 마지막 조음기관은 여린입천장으로 움직이는 조음기관으로 분류되는데, 이는 여린입천장의 근육들이 수축함으로써 연인두폐쇄를 이루고 그에 따라 입소리들(oral sounds)을 조음하기 때문이다.
- [0015] <조음과정>
- [0016] 소리들 중에는 성대를 거친 호흡기류가 성도를 통과하는 과정에서 구강에서, 더 정확히 말하며 구강 통로의 중앙부에서 어떠한 방해(장애)를 받으면서 생성되는 것과, 이와는 달리 아무런 방해를 받지 않고 생성되는 것이 있다. 보통 전자를 자음(consonant) 후자를 모음(vowel)이라고 한다.
- [0018] 1) 자음의 조음
- [0019] 자음은 발생되는 방법과 위치에 따라 살펴보아야 하는데 국제음성기호표상에서 각 칸은 조음위치를, 각 줄은 조음방법을 각각 나타내고 있다. 우선 조음방법에 따라 분류해 본다면, 호흡기류가 중앙부에서 어떤 종류의 방해를 받아서 조음되는가에 따라서 다막음 소리와 덜막음 소리로 크게 나누어 볼 수 있다.
- [0020] 다막음 소리는 구강에서 기류를 완전히 막았다가 터트리면서 내는 소리이고, 덜막음 소리는 성도의 한 부분을 좁혀서 그 좁아진 통로로 기류를 통과시켜 내는 소리이다.
- [0021] 다막음 소리는 다시 비강의 공명을 동반하고 나는 소리와 동반하지 않고 나는 소리로 나눌 수 있다. 성도의 일부를 완전히 막음과 동시에 연구개를 내려 비강 통로를 열고 비강의 공명을 동반하면서 내는 비강 다막음 소리(비강 폐쇄음, nasal stop)들이 전자에 속하며, 연구개를 올려 인두벽에 대고 비강 통로를 차단하여, 기류가 비강으로 통하는 것을 막은 상태로 내는 구강 다막음 소리(구강 폐쇄음, oral stop)들이 후자에 속한다. 구강 다막음 소리는 폐쇄의 길이와 방법에 따라서 폐쇄음(막음소리, stop) 혹은 파열음(터짐소리, plosive), 전동음(떨소리, trill), 탄설음(혹을 설탄음, flap/tap)으로 생각해 볼 수 있다. 그리고 덜막음 소리는 마찰음(갈이소리, fricative)과 접근음(approximant)으로 나누는데, 기류의 통로가 혀의 측면에 만들어지는 경우 이를 통틀어 설

측음(lateral)이라고 한다.

- [0022] 또한 다막음과 덜막음의 조음방법을 복합적으로 사용하는 파찰음(터짐같이, affricate)이 있으며, 마지막으로 알파벳으로는 /r/ 이나 /l/로 표현되나 국어의 경우 /ㄹ/로 표현되는 유음(liquid)과 국어에는 없지만 조음기관을 진동시켜서 소리를 말하는 전동음이 있다.
- [0023] 조음위치에 따라 분류해보면, 양순음(bilabial)이란, 두 입술이 그 조음에 관계하는 소리를 지칭하는 것으로, 한국어의 /ㅂ, ㅃ, ㅍ, ㅁ/등이 이에 속한다. 현대 한국어(표준어)에 존재하는 양순음들은 모두 두 입술을 막아서 내는 소리들이지만, 두 입술의 간격을 좁혀서 그 사이로 기류를 마찰시켜 낼 수도 있으며(양순 마찰음) 두 입술을 떨어져 낼 수도 있다(양순 전동음). 순치음(labiodentals)이란 아랫입술과 윗니가 조음에 관계하는 소리를 지칭하는 것으로 한국어에는 존재하지 않는다. 한국어에는 순치음이 없지만, 영어에 있는[f, v]가 바로 이 순치음(순치 마찰음)에 속한다. 치음(dental)은 기류의 협착이나 폐쇄가 윗니의 뒷부분에서 일어나는 소리를 말하는데 이 사이에서 마찰이 이루어지기도 해서 치간음(interdental)이라고도 한다. 치경음(alveolar)은 윗잇몸 부근에서 기류의 협착이나 폐쇄가 일어나면서 나는 소리로 한국어의 /ㄷ, ㄸ, ㅌ, ㄴ, ㄹ, ㅅ/등이 이에 속한다. 한국어의 /ㄴ, ㄹ/는 치경 부분에서 기류의 협착이 이루어져 나는 소리로 영어의 /s, z/와 기류의 협착이 이루어지는 장소가 거의 비슷하다.
- [0024] 경구개치경음(palatoalveolar)은 후치경음(postalveolar)이라고도 불리는데, 혀끝이나 혀날이 후치경부에 닿아서 나는 소리로 국어에는 존재하지 않지만, 영어나 불어에는 존재한다. 치경경구개음(alveolopalatal)은 전경구개음(prepalatal)이라고도 불리는데, 이 소리가 경구개의 앞쪽 즉 치경과 가까운 쪽에서 조음되기 때문이다.
- [0025] 국어의 세 파찰음 /ㅈ, ㅉ, ㅊ/가 이에 속한다. 권설음(retroflex)은 혀끝이나 혀의 위 표면이 입천장에 닿거나 접근하여서 조음되는 여타의 설음들과는 달리 혀의 아래 표면이 입천장에 닿거나 접근하여서 조음된다는 점에서 뚜렷한 차이가 있다. 경구개음(palatal)은 혀끝이 경구개부에 닿거나 접근하여 조음되는 소리를 말한다. 연구개음(velar)은 혀끝이 연구개부에 닿거나 접근하여 조음되는 소리를 말한다. 국어의 폐쇄음/ㄱ, ㅋ, ㆁ/와 비음 /ㅇ/이 이에 속한다. 구개수음(uvular)은 혀끝이 연구개의 끝부분인 구개수에 닿거나 접근하여 조음되는 소리를 말한다. 인두음(pharyngeal)은 그 조음이 인두장에서 이루어지는 음을 지칭한다. 마지막으로 성문음(glottal)은 성대가 조음기관으로 사용되어 조음되는 소리를 지칭하며 우리말에는 음소로서 성문 무성 마찰음 /ㅎ/만이 존재한다.
- [0026] 2) 모음의 조음: 모음의 조음은 혀의 고저와 전후 위치, 그리고 입술의 모양 등 세가지가 가장 중요한 변수로 작용한다. 첫 번째 변수로, 혀의 고저에 의하여 모음의 개구도, 즉 입을 벌린 정도가 결정되는데, 입을 적게 벌리고 내는 소리를 폐모음(close vowel), 혹은 고모음(high vowel)이라고 하며, 입을 크게 버리고 내는 소리를 개모음(open vowel), 혹은 저모음(low vowel)이라고 한다. 그리고 고모음과 저모음의 사이에서 나는 소리를 중모음(mid vowel)이라고 하는데, 이중모음은 다시 입을 벌린 정도가 더 작은 중고모음(close-mid vowel), 혹은 반폐모음(half-close vowel)과 입을 벌린 정도가 더 큰 중저모음(open-mid vowel), 혹은 반개모음(half-open vowel)으로 세분할 수 있다. 두 번째 변수인 혀의 전후 위치란 사실 혀의 어느 부분이 가장 좁혀졌는가, 다시 말해서 혀의 어느 부분이 입천장과 가장 가까운가를 기준으로 앞뒤를 따지는 것이다.
- [0027] 그 좁아진 부분이 혀의 앞쪽에 있는 모음을 전설모음(front vowel), 뒤쪽에 있는 모음을 후설모음(back vowel)이라고 하며, 그 중간쯤에 있는 모음을 중설모음(central vowel)이라고 한다. 마지막으로 모음의 조음에서 중요한 변수가 되는 것은 입술의 모양이다. 조음 시 입술이 둥그렇게 모아져 앞으로 튀어나오는 모음을 원순모음(rounded vowel)이라고 하고, 그렇지 않은 모음을 평순모음(unrounded vowel)이라고 한다.
- [0028] 발화 장애란 음도, 강도, 음질, 유동성이 성별, 연령, 체구, 사회적 환경, 지리적 위치에 적합하지 않은 것을 말한다. 이는 선천적으로 혹은 후천적으로 유발될 수 있으며, 수술을 통해 후두의 일부분인 성대를 늘이거나 줄여서 어느 정도 치료하는 것이 가능하다. 하지만 완벽한 치료는 되지 않으며, 그 효과 또한 정확하다고 할 수 없다.
- [0029] 후두의 기능으로는 삼킴, 기침, 폐색, 호흡, 발성 등이 있으며, 후두의 기능을 파악하는 방법으로는 발화 내역 검사, 발화패턴, 음향학적 검사, 공기역학적 검사 등이 있다.
- [0030] 이러한 후두 기능 파악방법을 통해 발화 장애의 여부를 어느 정도 판단할 수 있다.
- [0031] 발화장애의 유형도 다양하며 크게 기능적 발화장애와 기질적 발화장애로 나뉘게 된다. 이러한 유형의 대부분은 후두의 일부분인 성대에 이상이 생기는 경우가 많으며, 이러한 성대가 외부의 환경적 요인으로 인해 부어오름,

찢어짐, 이상 물질의 발생 등에 의해 장애가 오는 경우가 많다.

[0032] 그리고, 이러한 성대의 기능을 대신하기 위해 인위적으로 진동을 발생시킬 수 있는 진동발생기를 이용할 수 있다.

[0034] 진동발생기의 한 방식으로는 스피커방식이 있는데, 자석과 코일로 이루어져 있으며, 코일에 전류가 흐르는 방향을 달리하여 자력의 극성을 반대로 형성함으로써 인력과 척력이 교대로 발생토록 하여 공기의 진동을 유발한다.

[0035] 다른 방식으로 압전 현상을 이용한 방식이 있는데 압전 결정 유닛이 저주파 신호 전압을 받아서 일그러짐을 발생하고, 그에 의해서 진동판이 진동하여 음향을 발행하도록 만들 수 있다. 따라서 이러한 원리들을 이용한 진동발생기를 이용하여 성대의 기능을 수행하도록 할 수 있다.

[0036] 하지만 이러한 방법의 경우 외부의 위치하여 단순히 성대를 진동시켜 주는 기능에 불과하기 때문에 나타나는 음이 매우 부정확할 뿐 아니라 화자의 말하기 의도를 파악하는 것이 쉽지 않다. 또한 진동발생기를 가지고 성대에 위치하여 항상 소지해야 되며 말할 때는 한 손을 이용하기 때문에 일상생활에 어려움을 준다. 전술한 발화 장애와 이러한 발화 이상에 대해서는 후두나 성대의 일부를 수술하는 등의 치료적 방법을 모색할 수 있으나, 이러한 수술 방법이나 치료가 불가능한 경우가 있어서 완전한 해결책이 되지 못하고 있다.

[0038] 특히 관련 업계에 있어서는 유럽 및 홍콩을 기점으로 WinEPG, Articulate Instruments Ltd 등의 회사에서 사용 중인 University of Reading, 일본의 Fujimura, Tatsumi가 1973년에 개발하여 Rion 이라는 회사 이름으로 널리 상용화 시킨 The Rion EPG, Flecher이 출원하여 UCLA Phonetics Lab이 연구목적으로 개발하여 사용하는 Kay Palatometer, Schmidt가 개발하여 Complete Speech(Logomertix) 등이 있다.

[0039] 그러나 상기 종래의 기술들은 수동적 조음기관을 기반으로 발화하는 것에 한계가 있으며, 능동적 조음기관 자체인 구강설을 이용하거나, 구강설과 다른 조음기관과의 연계성에 의한 실제 조음 방식에 따른 발화를 구현하는데 명확한 한계가 있었다.

[0040] 기존에 상태 변화나 움직임의 파악하기 위한 다양한 센서가 개발되어 있으며, 센서를 바탕으로 압력, 온도, 거리, 마찰 등의 변화를 파악하는 것이 가능하다.

[0041] 더불어, 청음을 주관하는 신체의 요소는 외이(3100), 중이(3200), 내이(3300)를 포함하는 청각계(3000)로 이루어져 있고, 상기 청각계(3000)가 불완전하고 기능을 온전히 못할 경우, 두경부 외측일면(4100), 두경부 내측일면(4200), 두경부 측면 내골(4300)을 포함하는 유사대체기관중(4000)이 이를 보완하고 대체한다. 청음과 관련한 장애 유형은 환경적 요소에 의한 장애와 청각계의 물리적 손상에 의한 전음성 난청 및 생물학적 손상에 따른 감각신경성 난청과 같은 신체적 요소에 의한 장애가 있다. 자세히 말하자면, 환경적 요소에 의한 장애는 청음 시 주변환경의 소음으로 매질인 공기에 의해 전달되는 음성을 비롯한 소리 등이 외이(3100)에서 중이(3200)에 제대로 이르지 못하거나 많은 방해로 받게 되는 경우이다. 더불어, 매질인 공기가 부족하거나 전무한 바다 내지 우주 등의 공간에서도 음성을 비롯한 소리 등을 제대로 청음할 수 없는 환경적인 장애를 겪게 된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0043] 본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 본 발명의 목적은 화자의 발화 의도에 따른 화자의 조음 방식을 구강설을 포함한 두경부의 센서를 통해 파악하고, 이를 신호화하여 환경적 내지 신체적 장애 요인으로 인해 청음에 제한이 있는 화자 내지 청자에게 효율적으로 전달하는 장치 및 시스템을 제공하고자 하는 것이다.

[0044] 본 발명의 목적은 발화에 있어서 정상적인 기능을 수행하지 못하고 교정이나 치료가 불가능한 경우에 양질의 적절한 발화를 구현하고 해당 발화를 화자 본인 내지 청자가 환경적인 장애 내지 신체적인 장애와 무관하게 청음할 수 있도록 돕는 것이다.

과제의 해결 수단

- [0046] 상술한 바와 같은 종래기술의 문제를 해결하기 위하여 제공되는 본 발명에 따른 청음 향상을 위한 두경부 물리 특성 기반 복합시스템은, 화자의 두경부의 일면에 인접하여 조음기관의 물리특성을 측정하는 센서부와, 상기 센서부의 위치와 측정된 조음기관의 물리특성을 기반으로 화자의 하나 이상의 발화 특성을 파악하는 데이터 해석부와, 상기 하나 이상의 센서부의 위치와 상기 하나이상의 발화 특성을 음성데이터로 변환하는 데이터변환부와, 상기 음성데이터를 음파, 진동파, 청전기자극 중 하나이상의 형태로 외부로 표현하는 데이터 표현부를 포함하고, 상기 데이터 표현부는 상기 음성데이터를 화자, 청자 중 일인이상에게 제공하고자 전음장치로 구성된다.

발명의 효과

- [0048] 본 발명의 조음 및 청음 향상을 위한 복합시스템에 의하면, 소음 및 다수 화자의 발화에 의해 선택적 청취(Selective Hearing)에 심각한 제한이 있는 경우 화자의 발화를 화자 자신 내지 청자의 청각계에 위치한 전음장치로 전달하여 효과적인 청음이 가능하도록 한다.
- [0049] 또한, 화자의 발화에 따른 발화 의도를 문자로서 표현할 경우, Speech to Text로 응용되어, Silent Speech(침묵 대화)가 가능해진다. 이를 통해, 청각 장애인과 의사소통을 할 시에, 화자는 발화를 하고 청자인 청각 장애인은 이를 시각적 자료로 인지하기에 소통상의 어려움이 없어진다.
- [0050] 더불어, 의사전달에 있어서 소음에 영향을 받는 대중 교통, 공공 시설, 군사 시설 및 작전, 수중 활동 등에 활용 될 수 있는 등, 화자의 조음기관 작용에 의해 발생하는 조음도를 수치화(Scaling)하여 발화의도를 청각, 시각, 촉각의 형태로 직관적으로 제시하기 때문에 의사소통의 질 및 생활 편의도가 매우 탁월해 질 것으로 기대된다.

도면의 간단한 설명

- [0053] 도 1은 본 발명에 따른 센서부 구성의 예시도
 도 2는 본 발명에 따른 센서부의 위치 예시도
 도 3은 본 발명에 따른 센서부와 데이터 해석부 구성의 예시도
 도 4는 본 발명에 활용되는 모음 발화를 위한 구강설의 작용 예시도
 도 5는 본 발명에 따른 구강설 센서의 예시도
 도 6은 본 발명에 따른 구강설 센서의 또 다른 예시도
 도 7은 본 발명에 따른 구강설 센서의 또 다른 예시도
 도 8은 본 발명에 따른 구강설 센서의 또 다른 예시도
 도 9는 본 발명에 따른 구강설 센서의 또 다른 예시도
 도 10은 본 발명에 따른 구강설 센서의 통합 예시도
 도 11은 본 발명에 따른 구강설 센서의 부착 형태를 나타내는 단면도
 도 12는 본 발명에 따른 구강설 센서의 구성을 나타낸 사시도
 도 13은 본 발명에 따른 구강설 센서의 회로부의 구성을 나타낸 구성도
 도 14는 본 발명에 따른 다양한 발화에 따른 구강설 센서의 활용 예시도
 도 15은 본 발명에 따른 센서부, 데이터해석부, 데이터베이스부의 구성 예시
 도 16은 본 발명에 따른 데이터해석부가 측정된 조음기관 물리 특성을 발화 특징으로 파악하는 원리도

- 도 17은 본 발명에 따른 데이터해석부가 측정된 조음기관 물리 특성을 발화 특징으로 파악하는 보다 자세한 원리도
- 도 18은 본 발명에 따른 데이터해석부가 조음기관 물리 특성을 발화 특징으로 파악하도록 하는 모음에 관한 표준 발화 특징 행렬도
- 도 19는 본 발명에 따른 데이터해석부가 조음기관 물리 특성을 발화 특징으로 파악하도록 하는 자음에 관한 표준 발화 특징 행렬도
- 도 20은 본 발명에 따른 데이터해석부가 조음기관 물리 특성을 발화 특징으로 파악하기 위하여 진행하는 알고리즘 프로세스 예시도
- 도 21은 본 발명에 따른 데이터해석부가 조음기관 물리 특성을 발화 특징으로 파악하기 위하여 진행하는 알고리즘 프로세스의 상세 예시도
- 도 22는 본 발명에 따른 데이터해석부가 진행하는 발화 특징 파악을 위한 알고리즘 프로세스의 상세 원리도
- 도 23는 본 발명에 따른 구강설 센서가 화자에 의해 발화된 특정 모음을 발화 특징으로 파악하는 예시도
- 도 24는 본 발명에 따른 구강설 센서가 화자에 의해 발화된 특정 자음을 측정하고 데이터해석부가 이를 Alveolar Stop으로 파악하는 것을 나타낸 예시도
- 도 25는 본 발명에 따른 구강설 센서와 안면 센서가 화자에 의해 발화된 특정 자음을 측정하고 데이터해석부가 이를 Bilabial Stop으로 파악하는 것을 나타낸 예시도
- 도 26은 본 발명에 따라 구강설 센서와 안면 센서가 실제로 화자에 의해 발화된 특정 자음을 측정하고 데이터해석부가 이를 Voiced Bilabial Stop인 /버/와 Voiceless Bilabial Stop인 /퍼/로 파악한 실제 실험 데이터
- 도 27은 본 발명에 따라 구강설 센서, 안면 센서, 음성취득센서, 성대센서, 치아센서가 화자에 의해 발화된 특정 자음을 측정하고 데이터해석부가 이를 Voiced Labiodental Fricative로 파악하는 것을 나타낸 예시도
- 도 28은 본 발명에 따라 구강설 센서, 안면 센서, 음성취득센서, 성대센서, 치아센서가 화자에 의해 발화된 특정 자음을 측정하고 데이터해석부가 이를 Voiceless Labiodental Fricative로 파악하는 것을 나타낸 예시도
- 도 29는 본 발명에 따라 센서부에 의해 조음기관 물리 특징을 취득하고 데이터해석부가 상기 데이터베이스와 연동되는 것을 나타낸 예시도
- 도 30은 본 발명에 따라 구강설 센서, 안면 센서, 음성취득센서, 성대센서, 치아센서가 화자에 의해 발화된 특정 자음과 모음을 측정하고 데이터해석부가 이를 /beef/ 내지 [bif]라는 단어로 파악하는 것을 나타낸 예시도
- 도 31은 본 발명에 따라 센서부에서 취득된 음성데이터를 파악할 때 활용되는 데이터베이스부를 나타낸 예시도
- 도 32는 본 발명에 따라 센서부가 외부와 연결되기 위한 통신부와 연동된 것을 나타낸 예시도
- 도 33은 본 발명에 따라 데이터해석부와 연동되는 데이터베이스부의 실제 예시도
- 도 34는 본 발명에 따라 데이터해석부와 연동되는 데이터베이스부의 실제 또 다른 예시도
- 도 35는 본 발명에 따라, 센서부, 데이터해석부, 데이터표현부, 데이터베이스부가 연동된 것을 나타내는 구조도
- 도 36은 본 발명에 따라, 센서부, 데이터해석부, 데이터표현부, 데이터베이스부가 연동되어 작동하는 것을 나타내는 예시도
- 도 37은 본 발명에 따라, 데이터표현부가 음성데이터를 표현하는 것을 나타내는 예시도
- 도 38은 본 발명에 따라, 데이터표현부가 음성데이터를 문자를 포함한 시각적 자료와 음성형태로 표현하는 것을 나타내는 예시도
- 도 39는 본 발명에 따라, 데이터표현부가 음성데이터를 문자를 포함한 시각적 자료와 음성형태로 표현하는 것을 나타내는 또 다른 예시도
- 도 40은 본 발명에 따라, 데이터표현부가 음성데이터를 문자를 포함한 시각적 자료와 음성형태로 표현하는 것을 나타내는 또 다른 예시도

도 41은 본 발명에 따라, 데이터표현부가 음성데이터를 발화 자료를 포함한 시각적 자료와 음성데이터의 표준 발화를 청각적으로 표현하는 것을 나타내는 또 다른 예시도

도 42는 본 발명에 따라, 데이터표현부가 음성데이터를 문자로 시각적으로 표현하고 음성데이터의 표준 발화를 문장 단위로 청각적으로 표현하는 것을 나타낸 예시도

도 43은 본 발명에 따라, 데이터표현부가 음성데이터를 단어 단위의 문자 및 그에 상응하는 그림 내지 사진으로서 시각적으로 표현하고 음성형태로 표현하는 것을 나타내는 또 다른 예시도

도 44는 본 발명에 따라, 데이터 표현부가 음성데이터를 연속 발화 단위로서 문자와 음성형태로 표현하여 제공하는 것을 나타내는 또 다른 예시도

도 45는 본 발명에 따라, 데이터표현부가 음성데이터를 문자로 표현하되, 그에 상응하는 발음의 고저 색인을 함께 시각 및 청각적으로 제공하는 것을 나타내는 또 다른 예시도

도 46은 본 발명에 따라, 촉상 센서가 화자의 발화에 따라 변화하는 두경부 조음기관의 외상을 촉상하고 이를 데이터해석부가 파악하는 것을 나타내는 예시도

도 47은 본 발명에 따라, 촉상센서가 촉상한 정보들과 나머지 센서들이 파악한 발화 특징을 기반으로, 데이터해석부가 표준 발화 특징 행렬을 통해 상호 정보들을 결합시키는 것을 나타내는 예시도

도 48은 본 발명에 따라, 화자의 발화를 교정하기 위해 화자의 발화를 인지하고 분류하는 Confusion Matrix

도 49는 본 발명에 따라, 상기 Confusion Matrix를 백분율로 나타낸 결과

도 50은 본 발명과 관련한 청각계와 유사대체기관종을 나타낸 예시도

도 51은 본 발명에 따라, 전음장치가 청각계 중 외이에 위치하여 데이터수신부가 음성데이터를 수신하고 스피커부가 음성데이터를 음파로 송출하여 중이에 전달하는 것을 나타내는 예시도

도 52는 본 발명에 따라, 전음장치가 청각계 중 외이에 위치하여 데이터수신부가 음성데이터를 수신하고 스피커부가 음성데이터를 음파로 송출하되 증감조절부를 통해 증폭시켜 중이로 전달하는 것을 나타내는 예시도

도 53은 본 발명에 따라, 전음장치 중 데이터수신부가 청각계 중 외이에 위치하여 음성데이터를 수신하고, 외이도 내부에 위치한 전도진동부가 음성데이터를 진동파로 송출하여 중이로 전달하는 것을 나타내는 예시도

도 54는 본 발명에 따라, 전음장치 중 데이터수신부가 유사대체기관종 중 두경부 일측외면에 위치하여 음성데이터를 수신하고, 그와 인접한 전도진동부가 두경부 측면 내골을 매개로 음성데이터를 진동파로 송출하여 내이에 전달하는 것을 나타내는 예시도

도 55는 본 발명에 따라, 전음장치 중 데이터수신부가 유사대체기관종 중 두경부 일측외면에 위치하여 음성데이터를 수신하고, 중이의 일면에 위치한 전도진동부가 음성데이터를 진동파로 송출하여 청소골에 전달하는 것을 나타내는 예시도

도 56은 본 발명에 따라, 전음장치 중 데이터수신부가 유사대체기관종 중 두경부 일측외면에 위치하여 음성데이터를 수신하고 그와 인접한 제1전도진동부가 음성데이터를 진동파로 선행하여 송출하고, 중이의 일면에 위치한 제2전도진동부가 제1전도진동부에서 전달된 음성데이터를 후행하여 청소골로 전달하는 것을 나타내는 예시도

도 57은 본 발명에 따라, 전음장치 중 데이터수신부가 유사대체기관종 중 두경부 일측외면에 위치하여 음성데이터를 수신하고, 내이 중 달팽이관 외부에 위치한 하나이상의기준전갈전극과 달팽이관 내부에 위치한 하나이상의 활성전갈전극으로 이루어진 전갈전극부가 음성데이터를 청전기자극으로 송출하여 달팽이관의 역할을 대체하므로써 청신경에 전달하는 것을 나타내는 예시도

도 58은 본 발명에 따라, 전음장치 중 데이터수신부가 유사대체기관종 중 두경부 일측 외면에 위치하여 음성데이터를 수신하고, 내이 중 달팽이관 내부에 위치한 하나이상의 기준전갈전극과 달팽이관 내부에 위치한 하나이상의 활성전갈전극으로 이루어진 전갈전극부가 음성데이터를 청전기자극으로 송출하여 달팽이관의 역할을 대체하므로써 청신경에 전달하는 것을 나타내는 예시도

도 59는 본 발명에 따라, 전음장치 중 데이터수신부가 유사대체기관종 중 두경부 일측 외면에 위치하여 음성데이터를 수신하고, 내이 중 달팽이관 내부에 위치한 하나이상의 기준전갈전극과 달팽이관 내부에 위치한 단일한 활성전갈전극으로 이루어진 전갈전극부가 음성데이터를 청전기자극으로 송출하여 달팽이관의 역할을 대체하므로써 청신경에 전달하는 것을 나타내는 예시도

서 청신경에 전달하는 것을 나타내는 예시도

도 60은 본 발명에 따라, 전음장치 중 데이터수신부가 유사대체기관중 중 두경부 일측 외면에 위치하여 음성데이터를 수신하고, 유사대체기관중 중 두경부 일측내면으로 이어져 대뇌에 인접한 하나 이상의 기준전갈전극과 하나 이상의 활성전갈전극으로 이루어진 전갈전극부가 음성데이터를 청전기자극으로 송출하여 청신경 역할을 대체하므로써 대뇌에 전달하는 것을 나타내는 예시도

도 61은 본 발명에 따라, 전음장치 중 전도진동부에 활용되는 진동자의 종류 및 그 동작 원리 예시도

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0054] 이하, 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명의 일실시예에 따라 상세히 설명하기로 한다.
- [0055] 본 발명의 하기의 실시예는 본 발명을 구체화하기 위한 것일 뿐 본 발명의 권리범위를 제한하거나 이를 한정하는 것이 아님은 물론이다. 본 발명의 상세한 설명 및 실시예로부터 본 발명이 속하는 기술 분야의 전문가가 용이하게 유추할 수 있는 것은 본 발명의 권리범위에 속하는 것으로 해석된다.
- [0056] 본 발명을 실시하기 위한 내용을 도 1부터 도 60을 기반으로 상세히 설명하고자 한다. 도 1과 도2에 따르면, 본 발명의 센서부(100)는 두경부(11)에 위치하는 구강설 센서(110). 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150), 활상센서(160)로 구성된다.
- [0057] 더욱 자세히는 두경부에 위치하는 구강설 센서(110). 안면센서(120), 음성 취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150)는 상기 각 센서들이 위치하는 센서부의 위치(210), 화자(10)의 발화에 따른 발화 특징(220), 화자의 음성(230), 발화 내역 정보(240), 발화변이(250)을 제공한다.
- [0058] 도 3에 따르면, 데이터해석부(200)가 상기 이러한 데이터들을 취득하고, 데이터 변환부(300)는 이를 음성데이터(310)로 처리한다.
- [0059] 도 4, 도 5에 따르면 구강설 센서(110)의 경우, 구강설(12)의 일측면에 고착되거나 그 표면을 감싸거나, 그 내부에 삽입되며, 저고도, 전후설성, 굴곡도, 신전도, 회전도, 긴장도, 수축도, 이완도, 진동도 중 하나 이상의 구강설 자체의 독립 적인 물리 특성을 파악한다.
- [0060] 도 6, 도 7에 따르면, 상기 구강설 자체의 독립적인 물리 특성을 파악함에 있어서, 구강설 센서(110)는 x축, y축, z축 방향의 가속도 내지 단위 시간 당 회전하는 각도의 변화량 중 하나 이상을 파악함으로써, 구강설(12)을 포함한 다른 조음기관의 물리특성에 의한 발화특징(220)을 파악한다.
- [0061] 더불어, 도 8에 따르면, 구강설 센서(110)는 발화에 따른 구강설의 수축 내지 이완으로 발생하는 물리력에 따라 결정구조(111)의 변화에 의해 편극이 발생하여 전기신호가 발생하는 압전소자(112)를 통해 구강설의 굽힘도를 파악함으로써, 구강설을 포함한 조음기관의 물리특성에 의한 발화특징(220)을 파악할 수 있다.
- [0062] 도 9에 따르면, 구강설 센서(110)는 구강설(12)이 두경부(11) 내외의 다른 조음기관과의 상호작용에 의해 생기는 접근 및 접촉에 의해 발생하는 마찰전기(Tribo Electric Generator)에 따른 연계물리특성을 파악하기 위해 마찰대전소자(113)를 사용하여 화자(10)의 발화 특징(220)을 파악한다.
- [0063] 도 10, 도 11, 도 12에 따르면, 상기 구강설 센서(110)의 작동 원리는 복합 박막 회로로 구성되어 단일한 필름 형태로 구현될 수 있다.
- [0064] 이때 상기 구강설 센서(110)는, 회로부(114), 회로부(114)를 감싸는 캡슐부(115)와, 구강설(12)의 일면에 고착되도록 하는 접착부(116)로 구성된다.
- [0065] 더불어, 도 6, 7, 8, 9에 따르면, 구강설 센서(110)는 각 센서의 특징에 따라 두경부(11) 내외의 다른 조음기관과의 인접 내지 응접에 의해 생기는 과열도, 마찰도, 공명도, 접근도 중 하나 이상의 물리 특성을 파악할 수 있다.
- [0066] 도 13에 따르면, 상기 구강설 센서(110)의 회로부(114)는 통신칩, 센싱회로, MCU로 구성된다.
- [0067] 도 14에 따르면, 본 발명은 화자(10)의 다양한 자모음의 발화에 따라, 상기 자모음 발화에 따른 발화 특징(220)을 파악할 수 있게 된다.
- [0068] 상기 도 12는 Bilabial Sound (양순음), Alveolar Sound (치경음), Palatal Sound (구개음)에 따른 상기 구강설 센서의 작용을 보여주는 예시이다.

- [0069] 도 15에 따르면, 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150), 활상센서(160)로 이루어진 두경부 조음기관 인근의 센서부(100)는 두경부 조음기관에서 센서부가 위치한 센서부의 위치(210), 발화에 따른 발화특징(220), 발화에 따른 화자의 음성(230), 발화의 시작, 발화 정지, 발화 종료를 포함하는 발화내역정보(240)를 파악한다.
- [0070] 이때 발화특징(220)은 인간이 발화할 때 발생하는 폐쇄파열음화, 마찰음화, 파찰음화도, 비음화, 유음화, 활음화, 치찰음화, 유무성음화, 성문음화 중 하나이상의 기본적인 물리적 발화 특징을 의미한다. 또한 화자의 음성(230)은 상기 발화 특징으로 인해 함께 수반되는 청각적인 발화 특징이다.
- [0071] 더불어, 도 15에 따르면, 발화내역정보(240)는 상기 성대센서(140)를 통하여, 성대의 근전도 내지 떨림으로 그 정보를 파악한다.
- [0072] 상기 데이터해석부는 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150), 활상센서(160)로 이루어진 두경부 조음기관 인근의 센서부(100)가 측정한 화자의 조음기관 물리특성에서 화자의 성별, 인종, 나이, 모국어에 따라 발생하는 발화변이(250)를 파악한다.
- [0073] 이때 발화변이(250)는 자모음의 동화(Assimilation), 이화(Dissimilation), 탈락(Elision), 첨가(Attachment), 강세(Stress), 약화(Reduction)로 야기되는 기식음화 (Asperation), 음절성자음화(Syllabic cosonant), 탄설음화(Flapping), 경음화(Tensification), 순음화(Labialization), 연구개음화(Velarization), 치음화(Dentalization), 구개음화 (Palatalization), 비음화(Nasalization), 강세변화(Stress Shift), 장음화(Lengthening) 중 하나이상의 이차조음현상을 포함한다.
- [0074] 도 15에 따르면, 본 발명은 상기 두경부 조음기관에 인접한 센서들 외에 두경부 외측에서 발화에 따른 두경부의 조음기관 변화정보(161)를 포함하고 이에 따라 자연스럽게 발생하는 두경부 표정변화정보(162), 비언어적 표현정보(163)를 파악하는 활상센서(160)를 포함한다.
- [0075] 도 15에 따르면, 데이터 해석부(200)는 상기 두경부 조음기관 센서들(110, 120, 130, 140, 150)에 의해 측정된 센서부의 위치(210), 발화에 따른 발화특징(220), 발화에 따른 화자의 음성(230), 발화내역정보(240), 발화변이(250)를 인지한다.
- [0076] 더불어, 데이터 변환부(300)가 상기 데이터들을 상기 음성데이터(310)로 변환하여 처리함에 있어서, 데이터 해석부(300)는 데이터 베이스부(350)와 연동된다.
- [0077] 상기 활상센서(160)에 의해 측정된 두경부의 조음기관 변화정보(161), 두경부 표정변화정보(162), 비언어적 표현정보(163)를 음성데이터(310)로 인지하여 처리한다.
- [0078] 상기 활상센서와 연동되어 파악된 음성데이터(310)를 인지하여 처리함에 있어서, 데이터해석부(200)도 데이터베이스부(350)와 연동된다.
- [0079] 도 31에 따르면, 이때 데이터 베이스부(350)는 자모음의 음소단위(361), 색인 음절단위색인(362), 단어단위색인(363), 구절단위색인(364), 문장단위색인(365), 연속발화색인(366), 발음의 고저색인(367)을 포함하는 음성데이터 색인(360)을 가지고 있다.
- [0080] 이러한 음성데이터 색인(360)을 통해, 데이터 해석부(200)는 센서부(100)에서 취득된 다양한 발화 관련 정보들을 음성데이터로 처리할 수 있게 된다.
- [0081] 도 16, 17, 18, 19에 따르면, 상기 데이터 해석부(200)는 상기 구강설 센서(110)를 포함한 센서부(100)로부터 측정된 조음기관의 물리특성을 먼저 획득한다.
- [0082] 구강설 센서로 인해 조음기관 물리특성이 획득된 경우, 구강설 센서는 조음기관 물리특성을 센싱하면서 센싱된 물리특성의 행렬값을 만든다.
- [0083] 이후, 데이터 해석부(200)는 자모음의 표준발화특징행렬(205)에서 상기 이러한 물리특성의 행렬값에 대응하는 자모음의 발화특징(220)을 파악한다.
- [0084] 이때 자모음의 표준발화특징행렬(205)은 그 내부의 값들이 자모음 발화 기호, 2진수 내지 실수 중 하나 이상으로 존재할 수 있다.
- [0085] 더불어, 도 16에 따르면, 데이터 해석부(200)는 상기 센서부에서 측정되는 구강설과 두경부 내외의 타 조음기관과의 물리특성을 통해 화자가 발화하는 자모음, 그에 따라 나타나는 어휘단위강세 (Lexical Stress), 문장단위

강세(Tonic stress) 중 하나 이상의 발화 특징(220)을 파악한다.

- [0086] 도 20에 따르면, 상기 데이터 해석부(200)는 상기 센서부(100)에 의해 측정된 조음기관의 물리특징을 파악함에 있어서, 조음기관 물리특성을 취득하는 단계, 취득된 조음기관 물리특성이 가지고 있는 각 자모음 단위의 패턴을 파악하는 단계, 각 자모음 패턴으로부터 고유한 특징을 추출하는 단계, 상기 추출된 특징들을 분류하는 단계, 분류된 패턴의 특징들을 다시금 재조합하는 단계를 거치는 방식으로 작동되고, 이를 통해 최종적으로 특정 발화 특징으로 파악한다.
- [0087] 도 21, 도 22, 23에 따르면, 상기 데이터 해석부(200)가 진행하는 발화특징 파악 알고리즘에 있어서, 상기 각 자모음의 단위의 패턴을 파악하는 단계는 조음기관 물리특성을 파악한 센서부(100)가 구강설일 경우에 x, y, z 축을 기반으로 그 자모음 단위의 패턴을 파악한다.
- [0088] 상기 알고리즘은 K-nearest Neighbor(KNN), Artificial Neural Network(ANN), Convolutional Neural Network(CNN), Recurrent Neural Network(RNN), Restricted Boltzmann Machine(RBM), Hidden Markov Model(HMM) 중 하나이상의 알고리즘에 기반할 수 있다.
- [0089] 실제로 도 22, 23에서는 상기 구강설 센서(110)가 벡터량의 변화량 내지 각도 변화량을 파악하는 센서로 구동될 경우, 화자의 발화를 측정함으로써 벡터량의 변화량, 각도 변화량을 파악하고, 이를 통해 고설성(Tongue Height)과 전설성(Tongue Frontness)을 가지는 모음 [i]으로 인지한다.
- [0090] 또 다른 방법으로는 구강설 센서(110)가 압전신호 내지 마찰전기신호의 원리로 구동되는 센서일 경우, 압전에 따른 전기 신호 변화와 구강설 센서와 구강 내외부의 조음기관과 근접 내지 마찰하여 발생하는 마찰전기신호를 파악하여 고설성과 전설성을 가지는 모음 [i]으로 인지한다.
- [0091] 이 뿐만 아니라, [u]의 경우에도 같은 원리들을 기반으로, 고설성(Tongue Height: High)과 후설성(Backness)를 측정하여 해당 모음으로 파악하게 된다.
- [0092] [ae]의 경우에도 같은 원리들을 기반으로, 저설성(Tongue Height: Low)과 전설성(Tongue Frontness)을 측정하여 해당 모음으로 파악한다.
- [0093] 더불어 도 23에 따르면, 구강설 센서(110)는 화자의 발화에 따라 발생한 [i], [u], [ae]과 같은 모음을 발화 특징(220)으로 측정한다.
- [0094] 이러한 모음의 발화 특징(220)은 상기 데이터베이스부(350)의 자모음의 음소 단위 색인(361)에 대응한다.
- [0095] 도 24에 따르면, 구강설 센서(110)는 화자에 의해 발화된 특정 자음을 측정하고 상기 데이터 해석부(200)는 이를 발화특징(220)으로 측정한다.
- [0096] 이러한 자음의 발화특징(220)은 상기 데이터 베이스부(350)의 자모음의 음소 단위 색인(361)에 대응되며, 이를 데이터 해석부(200)가 음성데이터(310)의 기반이 되는 Alveolar Stop으로 파악한다.
- [0097] 도 25에 따르면, 구강설 센서(110)와 안면센서(120)는 화자에 의해 발화된 특정 자모음을 측정하고 데이터 해석부(200)는 이를 발화특징(220)으로 파악한다.
- [0098] 이러한 자음의 발화특징(220)은 상기 데이터 베이스부(350)의 자모음의 음소 단위색인(361)에 대응되며, 이를 데이터 해석부(200)가 음성데이터(310)의 기반이 되는 Bilabial Stop으로 파악한다.
- [0099] 도 26은 본 발명에 따른 실제 실험 결과로서, 구강설 센서(110)와 안면센서(120)는 화자에 의해 발화된 특정 자모음을 측정하고, 데이터 해석부는 상기 발화 특징(220)으로 파악한다.
- [0100] 이러한 자음의 발화특징(220)은 상기 데이터 베이스부(350)의 자모음의 음소 단위색인(361)에 대응되며, 이를 데이터 해석부(200)가 음성데이터(310)의 기반이 되는 Voiced Bilabial Stop인 /버/와 Voiceless Bilabial Stop인 /퍼/로 파악하였다.
- [0101] 도 27에 따르면, 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150)은 화자에 의해 발화된 특정 자모음을 발화특징(220)으로 측정한다.
- [0102] 이러한 자음의 발화특징(220)은 상기 데이터 베이스부(350)의 자모음의 음소 단위 색인(361)에 대응되며, 이를 데이터 해석부(200)가 음성데이터(310)의 기반이 되는 Voiced Labiodental Fricative로 파악한다.
- [0103] 도 28에 따르면, 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150)는 화자

에 의해 발화된 특정 자음을 발화특징(220)으로 측정한다.

- [0104] 이러한 자음의 발화특징(220)은 상기 데이터 베이스부(350)의 자모음의 음소 단위 색인(361)에 대응되며, 이를 데이터 해석부(200)가 음성데이터(310)의 기반이 되는 Voiceless Labiodental Fricative로 파악한다.
- [0105] 도 29에 따르면, 상기 촉상센서(160)는 화자(10)가 상기 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(160) 중 하나 이상을 사용하는 상황에서 발화할 시에 발생하는 두경부의 조음기관 변화정보(161), 두경부 표정변화정보(162), 비언어적 표현정보(163)를 음성데이터(310)로 인지하여 처리한다.
- [0106] 특히, 두경부의 일면에 위치한 안면센서는 레퍼런스 센서(121)를 기준으로 양극센서(122)와 음극센서(123)의 전위차를 가지고 그 자체 위치를 제공하며, 이는 상기 촉상센서(160)가 촉상함으로써 파악되는 물리적인 두경부의 조음기관 변화정보(161), 두경부 표정변화정보(162), 비언어적 표현정보(163)와 함께 음성데이터(310)으로 데이터 변환부(300)에 전달된다.
- [0107] 도 30에 따르면, 본 발명에 따라 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150), 촉상센서(160)가 화자에 의해 발화된 특정자음과 모음을 측정하고, 상기 데이터해석부(200)는 자음과 모음을 발화 특징(220)으로 파악한다.
- [0108] 이러한 각 자모음의 발화 특징(220)인 [b], [i], [f]는 상기 데이터 베이스부(350)의 자모음의 음소단위색인(361)에 각각 대응되며, 데이터 변환부(300)가 이를 /beef/ 내지 [bif]라는 음성데이터(310)로 파악한다.
- [0109] 도 31에 따르면, 상기 데이터 베이스부(350)의 음성데이터 색인(360)은 자모음의 음소단위색인(361), 음절단위색인(362), 단어단위색인(363), 구절단위색인(364), 문장단위색인(365), 연속발화색인(366), 발음의 고저색인(367)으로 구성된다.
- [0110] 도 32에 따르면, 본 발명에는 데이터 해석부와 데이터 변환부 중 하나 이상이 외부에 위치하여 작동할 경우, 연동되어 통신할 수 있는 통신부(400)를 포함한다.
- [0111] 상기 통신부는 유선 내지 무선으로 구현되며, 무선의 경우 블루투스, 와이파이, 3G, 4G, NFC 등 다양한 방법이 사용될 수 있다.
- [0112] 도 33, 도 34에 따르면, 본 발명에 따라 데이터 해석부와 연동되는 데이터 베이스부는 상기 음성데이터 색인을 이용하여 실제 발화에 따른 발화특징(220) 화자의 음성(230), 발화내역정보(240), 발화변이(250)를 음성데이터(310)로 파악한다.
- [0113] 도 33은 상기 도 23의 High Front tense Vowel과 High Back tense Vowel, 도 24의 Alveolar Sounds, 도 28의 Voiceless labiodental fricative를 포함하는 다양한 자모음 발화특징을 센서부가 측정하고 데이터 해석부가 반영한 실제데이터이다.
- [0114] 도 34은 상기 도 23의 High Front lax Vowel, 도 24의 Alveolar Sounds, 도 25의 Bilabial Stop Sounds를 포함하는 다양한 자모음 발화특징을 센서부가 측정하고 데이터 해석부가 반영한 실제데이터이다.
- [0115] 도 35에 따르면, 상기 센서부(100), 데이터 해석부(200), 데이터 변환부(300), 데이터 표현부(500), 데이터 베이스부(350)가 유기적으로 연동되어 작동하는 시스템을 알 수 있다.
- [0116] 더불어, 도 36에 따르면, 상기 센서부가 실제 조음기관에 위치하여 화자의 발화에 따른 조음기관 물리특성을 측정하고 이를 상기 데이터 해석부로 전달하고 상기 데이터 해석부는 이를 음성데이터로 해석한다.
- [0117] 상기 해석된 음성데이터는 데이터 표현부로 전달되며, 그 음성데이터의 해석 과정과 표현과정에서 데이터 베이스부가 연동되어 작동함을 알 수 있다.
- [0118] 도 37부터 도 41까지는 센서부(100)에 의해 획득된 화자의 두경부 조음기관의 물리특성이 데이터 해석부(200)를 통해 센서부의 위치(210), 발화특징(220), 화자의 음성(230), 발화내역정보(240), 발화변이(250)로 파악된다.
- [0119] 이후, 이러한 상기 정보들은 데이터 변환부(300)에서 음성데이터(310)로 변환되며, 데이터 표현부(500)에서 외부로 표현된다.
- [0120] 이때, 도 37은 음성데이터(310)를 데이터 표현부(500)가 청각적으로 표현하는 것을 나타낸 것이다.
- [0121] 도 38은 데이터 표현부(500)가 음성데이터(310)를 시각적으로 표현함에 있어서, 상기 데이터 해석부(200)가 측정한 화자의 조음기관의 물리특성을 데이터 베이스부(350)의 음성데이터 색인(360)과 비교하여, 실제 표준발음

의 광역표기(broad description)와 함께 강세의 정오도, 유사근접도, 발화의도 중 하나이상을 측정할 수치와 음성을 제공하는 것을 나타낸 것이다.

- [0122] 도 39는 데이터 표현부(500)가 음성데이터(310)를 시각과 청각적으로 표현함에 있어서, 상기 데이터 해석부(200)가 측정할 화자의 조음기관의 물리특성을 데이터 베이스부(350)의 음성데이터 색인(360)과 비교하여, 실제 표준발음의 미세표기(narrow description)와 함께 강세의 정오도, 유사근접도, 발화 의도 중 하나이상을 측정할 수치와 음성을 함께 제공하는 것을 나타낸 것이다.
- [0123] 도 40은 데이터 표현부(500)가 음성데이터(310)를 시각적으로 표현함에 있어서, 상기 데이터 해석부(200)가 측정할 화자의 조음기관의 물리특성을 데이터 베이스부(350)의 음성데이터 색인(360)과 비교하여, 실제 표준 발음의 미세표기(narrow description)와 함께 강세의 정오도, 유사근접도, 발화의도 중 하나 이상을 측정할 수치, 그리고 해당 음성데이터(310)가 단어로서 단어단위색인(363)에 대응할 경우, 그에 해당하는 이미지와 해당 음성을 함께 제공하는 것을 나타낸 것이다.
- [0124] 도 41은 데이터 표현부(500)가 음성데이터(310)를 시각과 청각적으로 표현함에 있어서, 상기 데이터 해석부(200)가 측정할 화자의 조음기관의 물리특성을 데이터 베이스부(350)의 음성데이터 색인(360)과 비교하여, 실제 표준 발음의 미세표기(narrow description)와 함께 강세의 정오도, 유사근접도, 발화 의도 중 하나 이상을 측정할 수치를 제공하고 화자에 의한 음성데이터(310)를 교정하고 강화할 수 있도록 해당 발음을 발화할 수 있는 발화교정 이미지를 함께 제공하는 것을 나타낸 것이다.
- [0125] 도 42는 데이터 표현부(500)가 상기 음성데이터(310)를 문자로 시각화하고 소리로 신호화하여 제공함에 있어서, 상기 데이터 해석부(200)가 측정할 화자의 조음기관의 물리특성을 데이터 베이스부(350)의 자모음 음소 단위 색인(361), 음절단위 색인(362), 단어단위 색인(363), 구절 단위 색인(364), 문장 단위 색인(365) 중 하나이상의 음성데이터 색인(360)과 비교한다. 이러한 음성데이터(310)를 트레이닝부(500)가 화자의 음성데이터(310)에 관련된 실제 표준 발음의 미세표기(narrow description)와 함께 강세의 정오도, 유사근접도, 발화 의도 중 하나 이상을 측정할 음성과 소리로 제공하여 화자가 음성데이터(310)를 교정하고 강화할 수 있도록 돕는다.
- [0126] 도 43는 데이터 표현부(500)가 상기 음성데이터(310)를 음성, 그림, 사진, 영상 중 하나이상으로 시각화하여 제공한다.
- [0127] 이 때 상기 데이터 해석부(200)는 측정할 화자의 조음기관의 물리특성을 데이터 베이스부(350)의 자모음 음소 단위 색인(361), 음절단위 색인(362), 단어단위 색인(363), 구절단위 색인(364), 문장단위 색인(365) 중 하나 이상의 음성데이터 색인(360)과 비교한다.
- [0128] 더불어, 문자로 시각화될 경우, 실제 표준발음의 미세표기(narrow description)와 광역표기 (broad description)를 모두 제공한다. 이를 통해 음성데이터(310)를 실제 표준 발음의 미세표기(narrow description) 및 광역표기 (broad description)와 함께 강세의 정오도, 유사근접도, 발화의도 중 하나이상을 측정할 음성과 소리로 제공하여 화자가 음성데이터(310)를 교정하고 강화할 수 있도록 돕는다.
- [0129] 도 44는 데이터 표현부(500)가 상기 음성데이터(310)를 문자로 시각화하여 제공함에 있어서, 상기 데이터 해석부(200)가 측정할 화자의 조음기관의 물리특성을 데이터 베이스부(350)의 자모음 음소 단위 색인(361), 음절단위 색인(362), 단어단위 색인(363), 구절단위 색인(364), 문장단위 색인(365), 연속발화색인(366) 중 하나이상의 음성데이터 색인(360)과 비교한다.
- [0130] 이러한 음성데이터(310)를 실제 표준 발음의 미세표기(narrow description) 및 광역표기 (broad description)와 함께 강세의 정오도, 유사근접도, 발화 의도 중 하나이상을 측정할 연속 발화 단위의 음성과 소리로 제공하여 화자가 음성데이터(310)를 교정하고 강화할 수 있도록 돕는다.
- [0131] 도 45는 데이터 표현부(500)가 상기 음성데이터(310)를 문자로 시각화하고 소리로 신호화하여 제공함에 있어서, 상기 데이터 해석부(200)가 측정할 화자의 조음기관의 물리특성을 데이터 베이스부(350)의 자모음 음소단위 색인(361), 음절단위 색인(362), 단어단위 색인(363), 구절단위 색인(364), 문장단위 색인(365), 연속발화색인(366), 발음의 고저 색인(367) 중 하나 이상의 음성데이터 색인(360)과 비교한다.
- [0132] 이러한 음성데이터(310)를 실제 표준발음의 미세표기(narrow description) 및 광역표기 (broad description)와 함께 강세의 정오도, 유사근접도, 발화 의도 중 하나 이상을 측정할 음성과 소리로 제공하여 화자가 음성데이터(310)를 교정하고 강화할 수 있도록 돕는다.
- [0133] 도 46에 따르면, 상기 활상센서(160)는 발화에 따른 화자의 두경부 조음기관의 외관상 변화를 활상하고, 상기

데이터 해석부(200)는 이를 통해 화자의 두경부 조음기관의 변화정보(161), 두경부 표정변화정보(162)를 파악한다.

[0134] 이때 상기 센서부(100)의 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150)을 통해 파악된 화자의 발화 특징(210)도 함께 데이터 해석부(200)가 고려하게 된다.

[0135] 도 47에 따르면, 상기 센서부(100)의 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150)는 화자의 발화 특징(210)을 파악하고, 상기 활상센서(160)는 화자의 두경부 조음기관의 변화정보(161), 두경부 표정 변화정보(162)를 파악한다.

[0136] 이를 상기 데이터 해석부(200)가 표준발화 특징행렬(205)를 기반으로 상기 두경부 조음기관의 변화정보(161), 두경부 표정변화정보(162)에 대응하는 발화특징을 결합시킨다.

[0137] 도 47, 54에 따르면, 상기 데이터 해석부(200)는 발화 특징을 파악하기 위해서 Time Domain의 Variance, 주파수 영역의 Cepstral Coefficient, Linear Predict Coding Coefficient를 사용하는 특징 추출 알고리즘을 대표하여 사용한다.

[0138] 데이터의 분산 정도를 나타내는 Variance는 다음 [수학 식1]에 따라 계산되며, n은 모집단의 네트워크, 는 수집된 조음기관 물리 특성인 데이터의 모집단의 평균, 는 수집된 조음기관 물리 특성인 데이터들을 나타낸다.

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

[0140]

[0141] [수학식1]

[0142] Cepstral Coefficient는 주파수의 세기를 정형화하기 위해 다음 [수학식 2]로 계산된다. 는 역 푸리에급수 변환인 Inverse Fourier Transform을 나타내고, X(f)는 신호에 대한 주파수의 스펙트럼을 나타낸다. 본 예시에서는 Cepstral의 Coefficient는 n=0일 때의 값을 활용하였다.

[0144] [수학식2]

$$C_n = F^{-1} \log |X(f)|$$

[0145]

[0146] Linear Predict Coding Coefficient는 주파수의 선형적 특성을 나타내는 것으로 다음[수학식 3]에 따라 계산된다. 다음 n은 표본의 개수를 나타내며, 는 Linear Predict Coding Coefficient 계수이다. Cepstral의 계수는 n=1일때의 값을 활용하였다.

[0148] [수학식 3]

$$C_n = -a_n - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} (n-i) a_i c_{n-i}$$

[0149]

[0150] 더불어, 조음기관 물리 특성인 데이터를 유사도에 따라 묶고 예측데이터를 생성하여 각 데이터를 분류하는 ANN을 활용하였다. 이를 통해, 화자가 최초 발화에 대해 표준 발화에 대비하여 본인 발화 내용의 정오도, 근접유사도, 발화 의도를 파악할 수 있게 된다.

[0151] 이를 바탕으로 화자는 자신에 발화 내용에 대한 피드백을 얻고 지속적으로 발화교정을 위한 재발화를 실시한다. 이러한 반복적 조음기관 물리특성 데이터 입력 방식을 통해 많은 조음기관 물리 특성 데이터가 모이고 ANN의 정확도가 증가한다.

- [0152] 본 연구에서는 입력 데이터인 조음기관 물리 특성을 10개의 자음으로 선정하였고, 추출과정에서 5개의 조음위치인 Bilabial, Alveolar, Palatal, Velar, Glottal로 분류되었다. 이를 위해, 상기 5개의 조음위치에 해당하는 10개의 자음을 순서대로 100번씩, 총 1000번 무작위로 50번씩 총 500번 발음을 하였다.
- [0153] 이에 따라, 도 47과 같이 자음 분류를 위한 Confusion Matrix가 형성되었다. 이를 기반으로 각 조음위치마다 발화되는 자음의 개수가 상이하다는 것을 고려하여, 다음 도 48과 같이 백분율로 나타내었다.
- [0154] 이를 통해, 화자는 표준 발화와 대비하여 발음의 정도도 및 근접유사도가 낮은 Palatal과 관련하여, 자음을 제대로 발화하지 못함을 알 수 있다.
- [0155] 또한 도 52에 따르면, Palatal과 관련된 자음을 발화하고자 하였으나 Alveolar와 관련된 자음으로 잘못 발화한 경우는 17%이다. 이는 화자가 Palatal과 관련된 자음과 Alveolar와 관련된 자음 간의 차이를 명확히 인지하지 못함을 의미한다.
- [0156] 도 49에 따르면, 청음을 주관하는 신체의 요소는 외이(3100), 중이(3200), 내이(3300)를 포함하는 청각계(3000)로 이루어져 있고, 상기 청각계(3000)가 불완전하고 기능을 온전히 못할 경우, 두경부 외측일면(4100), 두경부 내측일면(4200), 두경부 측면 내골(4300)을 포함하는 유사대체기관중(4000)이 이를 보완하고 대체한다.
- [0157] 청음과 관련한 장애유형은 환경적 요소에 의한 장애와 청각계의 물리적 손상에 의한 전음성 난청 및 생물학적 손상에 따른 감각신경성 난청과 같은 신체적 요소에 의한 장애가 있다.
- [0158] 자세히 말하자면, 환경적 요소에 의한 장애는 청음 시 주변환경의 소음으로 매질인 공기에 의해 전달되는 음성을 비롯한 소리 등이 외이(3100)에서 중이(3200)에 제대로 이르지 못하거나 많은 방해로 받게 되는 경우이다.
- [0159] 더불어, 매질인 공기가 부족하거나 전무한 바다 내지 우주 등의 공간에서도 음성을 비롯한 소리 등을 제대로 청음할 수 없는 환경적인 장애를 겪게 된다.
- [0160] 신체적인 장애에 관련한 예로서는, 외이(3100)와 관련한 손상은 외이도 및 고막의 손상에 의한 증폭 제한이 있다.
- [0161] 이를 해결하기 위해서는 전음성 난청의 경우에는 음파를 선형으로 증폭시켜 고막으로 전달하고 감각신경성 난청을 극복하기 위해서는 비선형 내지 압축 증폭을 해야 한다.
- [0162] 중이(3200)와 관련한 손상은 중이 내 청소골의 손상으로 인하여 증폭이 제한된 경우가 있다.
- [0163] 이 경우에는, 청각계 중 중이에 위치한 청소골을 직접 자극하여 해결하거나, 청각계가 아닌 유사대책관중(4000)중에서 두경부 측면 내골(4300)을 매개로 골전도 효과를 이용하는 방법이 있다.
- [0164] 내이(3300)와 관련된 손상은 달팽이관 손상에 따른 내림프액 진동을 통한 파형 생성의 제한으로 음성이 청전기 신호로 변환되지 못해 청신경으로 도달하지 못하는 경우가 있다.
- [0165] 이를 해결하기 위해서는 달팽이관 안에 전극을 배치하여 종래의 인공와우의 형태를 청신경에 청전기신호를 전달하는 방법이 있다. 또는 종래의 인공뇌간과 같이 대뇌에 청전기신호를 바로 전달하는 방법으로도 해결할 수 있다.
- [0166] 도 50에 따르면, 화자의 두경부에 위치한 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150)는 화자의 조음기관 물리특성을 센싱한다.
- [0167] 이를 바탕으로 데이터 해석부(200)는 발화특징(220) 및 화자의 음성(230) 등을 파악한다. 이를 기반으로 데이터 변환부(300)는 상기 화자의 발화 특징(220) 및 화자의 음성(230) 등에 대응하는 하나이상의 음성데이터 색인(360)을 포함하는 데이터 베이스부(350)와 연동되어 음성데이터(310)를 생성한다.
- [0168] 데이터 표현부(500)는 상기 음성데이터(310)를 전음장치(1000)로 전달한다. 이때, 상기 전음장치(1000)의 데이터수신부(1100)는 청각계 중 외이에 위치하여 음성데이터를 수신하고 스피커부(1200) 역시 외이의 일면에 위치하여 음성데이터(310)를 음파(510)로 송출하여 중이, 특히 고막(3210)에 전달한다.
- [0169] 도 51에 따르면, 화자의 두경부에 위치한 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150)는 화자의 조음기관 물리특성을 센싱한다.
- [0170] 이를 바탕으로 데이터 해석부(200)는 발화특징(220) 및 화자의 음성(230) 등을 파악한다. 이를 기반으로 데이터 변환부(300)는 상기 화자의 발화 특징(220) 및 화자의 음성(230) 등에 대응하는 하나이상의 음성데이터 색인

(360)을 포함하는 데이터 베이스부(350)와 연동되어 음성데이터(310)를 생성한다.

- [0171] 데이터 표현부(500)는 상기 음성데이터(310)를 전음장치(1000)로 전달한다. 이때, 상기 전음장치(1000)의 데이터수신부(1100)는 청각계 중 귓바퀴(3110)를 포함한 외이 일면에 위치하여 음성데이터를 수신하고, 스피커부(1200) 역시 외이의 일면에 위치하여 음성데이터(310)를 음파(510)로 송출하되 증감조절부(1210)를 통해 음성데이터(310)의 고주파수 영역 내지 전체 영역이 증폭 내지 감소시켜 중이, 특히 고막(3210)에 전달한다.
- [0172] 이때, 증감조절부(1210)는 화자의 상기 음성데이터(310)의 각 자모음이 지닌 고유한 주파수인 F값(Formant Frequency)을 F1, F2, F3를 구분하여 선별적으로 증폭 내지 감소시켜 조절할 수 있게 된다.
- [0173] 도 52에 따르면, 화자의 두경부에 위치한 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150)는 화자의 조음기관 물리특성을 센싱한다.
- [0174] 이를 바탕으로 데이터 해석부(200)는 발화특징(220) 및 화자의 음성(230) 등을 파악한다. 이를 기반으로 데이터 변환부(300)는 상기 화자의 발화 특징(220) 및 화자의 음성(230) 등에 대응하는 하나이상의 음성데이터 색인(360)을 포함하는 데이터 베이스부(350)와 연동되어 음성데이터(310)를 생성한다.
- [0175] 데이터 표현부(500)는 상기 음성데이터(310)를 전음장치(1000)로 전달한다. 이때, 상기 전음장치(1000)의 데이터수신부(1100)는 청각계 중 외이에 위치하여 음성데이터를 수신하고, 전도진동부(1300)는 외이도(3120) 일면에 위치하여 음성데이터(310)를 진동파(520)로 중이(3200), 특히 고막(3210)에 전달한다.
- [0176] 도 53에 따르면, 화자의 두경부에 위치한 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150)는 화자의 조음기관 물리특성을 센싱한다.
- [0177] 이를 바탕으로 데이터 해석부(200)는 발화특징(220) 및 화자의 음성(230) 등을 파악한다. 이를 기반으로 데이터 변환부(300)는 상기 화자의 발화 특징(220) 및 화자의 음성(230) 등에 대응하는 하나이상의 음성데이터 색인(360)을 포함하는 데이터 베이스부(350)와 연동되어 음성데이터(310)를 생성한다.
- [0178] 데이터 표현부(500)는 상기 음성데이터(310)를 전음장치(1000)로 전달한다. 이때, 상기 전음장치(1000)의 데이터수신부(1100)는 유사대체기관중(4000) 중 두경부 일측외면(4100)에 위치하여 음성데이터(310)를 수신하고 그와 인접한 전도진동부(1300)는 두경부 측면 내굴(4300)을 매개로 음성데이터(310)를 진동파(520)로 송출하여 내이(3300)에 전달한다.
- [0179] 도 54에 따르면, 화자의 두경부에 위치한 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150)는 화자의 조음기관 물리특성을 센싱한다. 이를 바탕으로 데이터 해석부(200)는 발화특징(220) 및 화자의 음성(230) 등을 파악한다. 이를 기반으로 데이터변환부(300)는 상기 화자의 발화 특징(220) 및 화자의 음성(230) 등에 대응하는 하나이상의 음성데이터 색인(360)을 포함하는 데이터 베이스부(350)와 연동되어 음성데이터(310)를 생성한다.
- [0180] 데이터 표현부(500)는 상기 음성데이터(310)를 전음장치(1000)로 전달한다. 이때, 상기 전음장치(1000)의 데이터수신부(1100)는 유사대체기관중(4000) 중 두경부 일측외면(4100)에 위치하여 음성데이터(310)를 수신하고, 중이(3200)의 일면에 위치한 전도진동부(1300)는 음성데이터(310)를 진동파(520)로 송출하여 내이(3200), 특히 청소골(3220)에 전달한다.
- [0181] 도 55에 따르면, 화자의 두경부에 위치한 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150)는 화자의 조음기관 물리특성을 센싱한다.
- [0182] 이를 바탕으로 데이터 해석부(200)는 발화특징(220) 및 화자의 음성(230) 등을 파악한다. 이를 기반으로 데이터 변환부(300)는 상기 화자의 발화 특징(220) 및 화자의 음성(230) 등에 대응하는 하나이상의 음성데이터 색인(360)을 포함하는 데이터 베이스부(350)와 연동되어 음성데이터(310)를 생성한다. 데이터 표현부(500)는 상기 음성데이터(310)를 전음장치(1000)로 전달한다.
- [0183] 이때, 상기 전음장치(1000)의 데이터수신부(1100)는 유사대체기관중(4000) 중 두경부 일측외면(4100)에 위치하여 음성데이터(310)를 수신하고 그와 인접한 제1전도진동부(1301)가 음성데이터(310)를 진동파(520)로 선행하여 송출하고 중이(3200)에 위치한 제2전도진동부(1302)가 상기 제1전도진동부(1301)에서 전달된 음성데이터(310)를 후행하여 내이(3200), 특히 청소골(3220)에 전달한다.
- [0184] 도 56에 따르면, 화자의 두경부에 위치한 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150)는 화자의 조음기관 물리특성을 센싱한다.

- [0185] 이를 바탕으로 데이터 해석부(200)는 발화특징(220) 및 화자의 음성(230) 등을 파악한다. 이를 기반으로 데이터 변환부(300)는 상기 화자의 발화 특징(220) 및 화자의 음성(230) 등에 대응하는 하나이상의 음성데이터 색인(360)을 포함하는 데이터 베이스부(350)와 연동되어 음성데이터(310)를 생성한다. 데이터 표현부(500)는 상기 음성데이터(310)를 전음장치(1000)로 전달한다.
- [0186] 이때, 상기 전음장치(1000)의 데이터수신부(1100)는 유사대체기관중(4000) 중 두경부 일측외면(4100)에 위치하여 음성데이터(310)를 수신하고, 내이(3300) 중 달팽이관(3310)의 외부 일면 위치한 하나이상의 기준전갈전극(1410)과 달팽이관(3310)의 내부 일면에 위치한 하나이상의 활성전갈전극(1420)으로 이루어진 전기전갈부(1400)는 음성데이터(310)를 청전기자극(530)으로 송출하여 내이(3200), 특히 청소골(3210)에 전달한다. 이에 따라, 청신경(3320)이 상기 청전기자극(530)을 수용한다
- [0187] 도 57에 따르면, 데이터 표현부(500)는 상기 음성데이터(310)를 전음장치(1000)로 전달한다. 이때, 상기 전음장치(1000)의 데이터수신부(1100)는 유사대체기관중(4000) 중 두경부 일측외면(4100)에 위치하여 음성데이터(310)를 수신하고, 내이(3300) 중 달팽이관(3310)의 외부 일면에 위치한 하나이상의 기준전갈전극(1410)과 하나이상의 활성전갈전극(1420)으로 이루어진 전기전갈부(1400)는 음성데이터(310)를 청전기자극(530)으로 송출하여 내이(3200), 특히 청소골(3210)에 전달한다. 이에 따라, 청신경(3320)이 상기 청전기자극(530)을 수용한다.
- [0188] 도 58에 따르면, 데이터 표현부(500)는 상기 음성데이터(310)를 전음장치(1000)로 전달한다. 이때, 상기 전음장치(1000)의 데이터수신부(1100)는 유사대체기관중(4000) 중 두경부 일측외면(4100)에 위치하여 음성데이터(310)를 수신하고, 내이(3300) 중 달팽이관(3310)의 외부 일면에 위치한 하나이상의 기준전갈전극(1410)과 단일한 활성전갈전극(1420)으로 이루어진 전기전갈부(1400)는 음성데이터(310)를 청전기자극(530)으로 송출하여 내이(3200), 특히 청소골(3210)에 전달한다. 이에 따라, 청신경(3320)이 상기 청전기자극(530)을 수용한다.
- [0189] 도 59에 따르면, 화자의 두경부에 위치한 구강설 센서(110), 안면센서(120), 음성취득센서(130), 성대센서(140), 치아센서(150)는 화자의 조음기관 물리특성을 센싱한다. 이를 바탕으로 데이터 해석부(200)는 발화특징(220) 및 화자의 음성(230) 등을 파악한다. 이를 기반으로 데이터변환부(300)는 상기 화자의 발화 특징(220) 및 화자의 음성(230) 등에 대응하는 하나이상의 음성데이터 색인(360)을 포함하는 데이터 베이스부(350)와 연동되어 음성데이터(310)를 생성한다.
- [0190] 데이터 표현부(500)는 상기 음성데이터(310)를 전음장치(1000)로 전달한다. 이때, 상기 전음장치(1000)의 데이터수신부(1100)는 유사대체기관중(4000) 중 두경부 일측외면(4100)에 위치하여 음성데이터(310)를 수신하고, 두경부 일측내면(4200)으로 이어져 대뇌(3330)에 인접한 하나이상의 기준전갈전극(1410)과 하나이상의 활성전갈전극(1420)으로 이루어진 전기전갈부(1400)는 음성데이터(310)를 청전기자극(530)으로 송출하여 대뇌(3330)에 전달한다. 이에 따라, 대뇌(3330)는 상기 청전기자극(530)을 바로 수용한다.
- [0191] 도 60에 따르면, 상기 데이터 표현부(500)의 전음장치(1000)를 구성하는 전도진동부(1300)는 상기 변환된 음성데이터(310)를 진동자(1310)를 통해 진동파(520)로 재변환시켜 제공하는 데, 이때 여러 종류의 진동자와 및 그 동작 원리가 제공될 수 있다.
- [0192] 먼저 로렌츠 힘을 이용한 진동자로서 W-Type과 C-Type의 두 진동자 모델이 있다. 상기 두 가지 형태의 진동자는 좌측의 그림1)과 그림2)의 스피커 개념도와 같이 원통형 마그넷과 도넛형 마그넷을 이용하여 자장을 형성한 후, 자장 내에 코일을 두어 전류에 의해 인가되는 로렌츠힘을 이용하여 동작한다.
- [0193] 다른 방식으로, 우측 그림3)과 그림4)에서 보이는 것처럼, E-Type 진동자는 전자석을 이용한 진동자로서 스피커 기능과 진동자 기능을 동시에 가지는 R+V 복합형과 진동자 단독 형태인 V 단독형 두 모델이 있다. 두 모델 모두 원통형 전자석과 도넛형 마그넷에 부착된 원판형 메탈 플레이트 간의 자기력을 이용하여 동작한다.
- [0195] 도면에 기재된 방법 외에도 센서부의 경우 다음과 같은 것들이 포함 될 수 있다.
- [0196] 1. 압력센서: MEMS 센서, Piezoelectric (압력-전압) 방식, Piezoresistive (압력-저항) 방식, Capacitive 방식, Pressure sensitive 고무 방식, Force sensing resistor (FSR) 방식, Inner particle 변형 방식, Buckling 측정 방식.
- [0197] 2. 마찰 센서: 마이크로 hair array 방식, 마찰온도 측정방식.
- [0198] 3. 정전기 센서: 정전기 소모 방식, 정전기 발전 방식.

- [0199] 4. 전기저항 센서: 직류저항 측정방식, 교류저항 측정방식, MEMS, Lateral 전극 array 방식, Layered 전극 방식, Field Effect Transistor (FET) 방식 (Organic-FET, Metal-oxide-semiconductor-FET, Piezoelectric-oxide-semiconductor -FET 등 포함).
- [0200] 5. Tunnel Effect Tactile 센서: Quantum tunnel composites 방식, Electron tunneling 방식, Electroluminescent light 방식.
- [0201] 6. 열저항 센서: 열전도도 측정방식, Thermoelectric 방식.
- [0202] 7. Optical 센서: light intensity 측정방식, refractive index 측정방식.
- [0203] 8. Magnetism based 센서: Hall-effect 측정 방식, Magnetic flux 측정 방식.
- [0204] 9. Ultrasonic based 센서: Acoustic resonance frequency 방식, Surface noise 방식, Ultrasonic emission 측정방식.
- [0205] 10. 소프트 재료 센서: 고무, 파우더, 다공성 소재, 스펀지, 하이드로젤, 에어로젤, 탄소섬유, 나노탄소재료, 탄소나노튜브, 그래핀, 그래파이트, 복합재, 나노복합재, metal-고분자 복합재, ceramic-고분자 복합재, 전도성 고분자 등의 재료를 이용한 pressure, stress, 혹은 strain 측정 방식, Stimuli responsive 방식.
- [0206] 11. Piezoelectric 소재 센서: Quartz, PZT (lead zirconate titanate) 등의 세라믹 소재, PVDF, PVDF copolymers, PVDF-TrFE 등의 고분자 소재, 셀룰로오스, ZnO 나노선 등의 나노소재 방식.


부호의 설명

- [0208] 10: 화자 11: 두경부 12: 구강설 13: 성대
 100 : 센서부 110: 구강설 센서 111: 결정 구조 112: 압전소자
 120: 안면 센서 121: 레퍼런스 센서 122: 양극센서 123: 음극센서
 130: 음성취득센서 140: 성대 센서
 160: 촉상 센서 161: 조음기관의 변화 정보
 162: 두경부 표정변화정보 163: 비언어적표현
 200: 데이터 해석부 205: 표준 발화 특징 행렬
 210: 센서부의 위치 220: 발화 특징 230: 화자의 음성
 240: 발화 내역 정보
 250: 발화 변이
 300: 데이터변환부 310: 음성데이터
 350: 데이터 베이스부 360: 음성데이터 색인
 361: 자모음의 음소단위 색인 362: 음절 단위 색인 363: 단어단위 색인
 364: 구절단위 색인 365: 문장단위 색인 366: 연속 발화 색인
 367: 발음의 고저 색인
 400: 통신부
 500: 데이터 표현부 510: 음파 520: 진동파 530: 청전기자극
 1000: 전음장치 1100: 데이터수신부
 1200: 스피커부 1210: 증감조절부
 1300: 전도진동부 1301: 제1전도진동부 1302: 제2전도진동부 1310: 진동자


1400: 전기전갈부 1410: 기준전갈전극 1420: 활성전갈전극
 2000: 디스플레이
 3000: 청각계
 3100: 와이 3110: 콧바퀴 3120: 와이도
 3200: 종이 3210: 고막 3220: 청소골
 3300: 내이 3310: 달팽이관 3320: 청신경 3330: 대뇌
 4000: 유사대체기관중 4100: 두정부 일측외면
 4200: 두정부 일측내면 4300: 두정부 측면 내골

도면


도면1

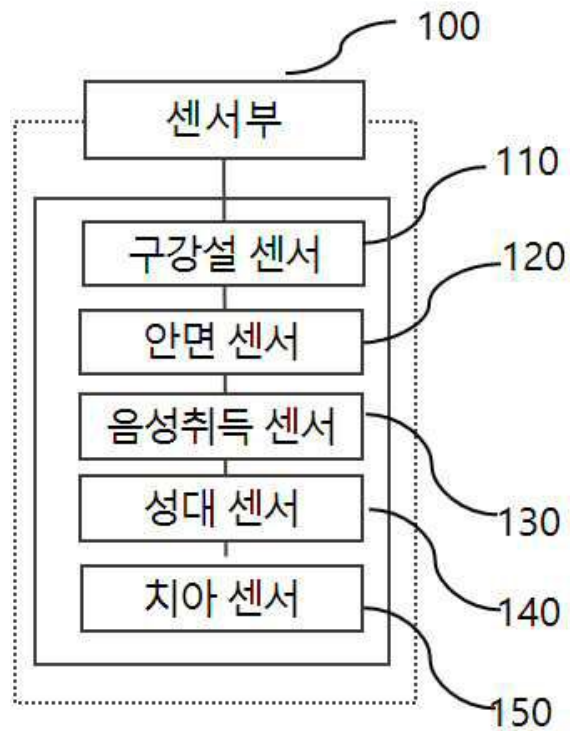


도면2

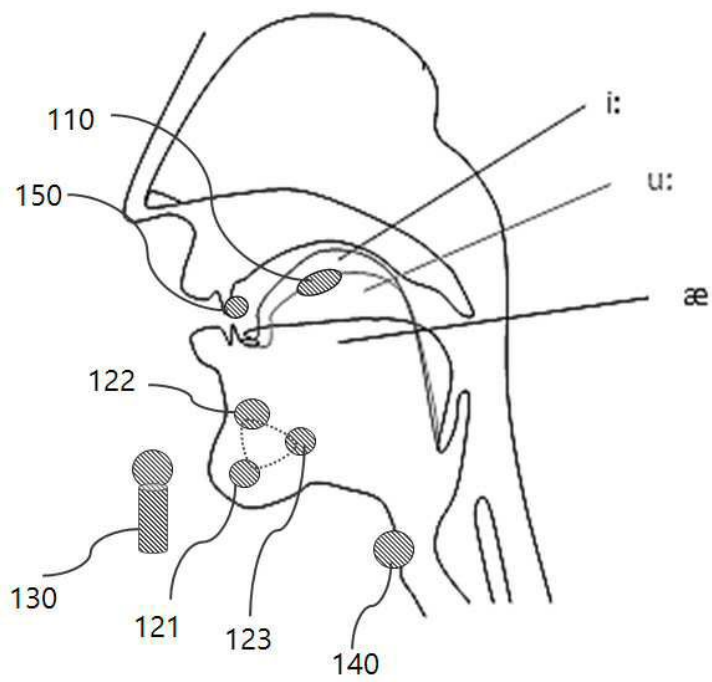


도면3

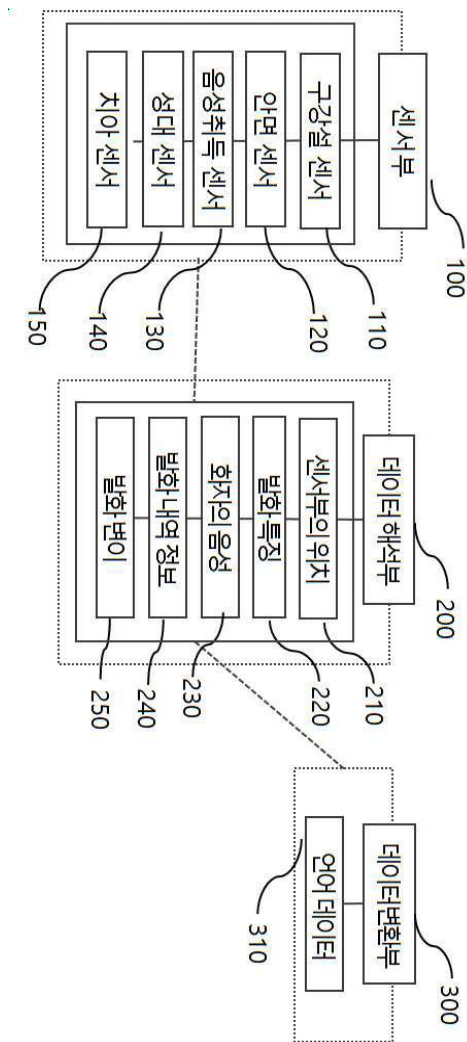


도면4

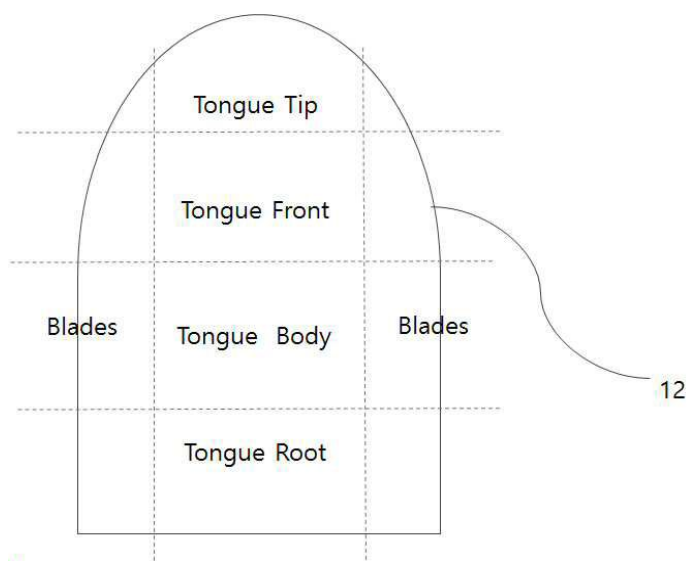


도면5

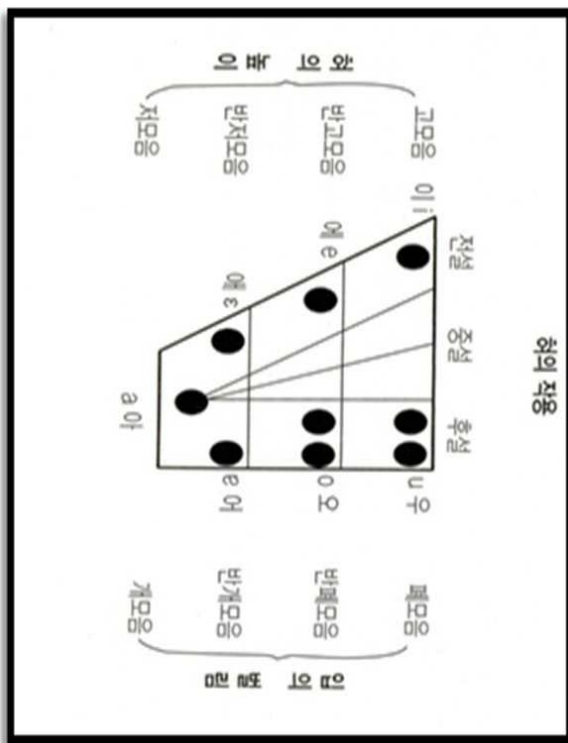


도면6

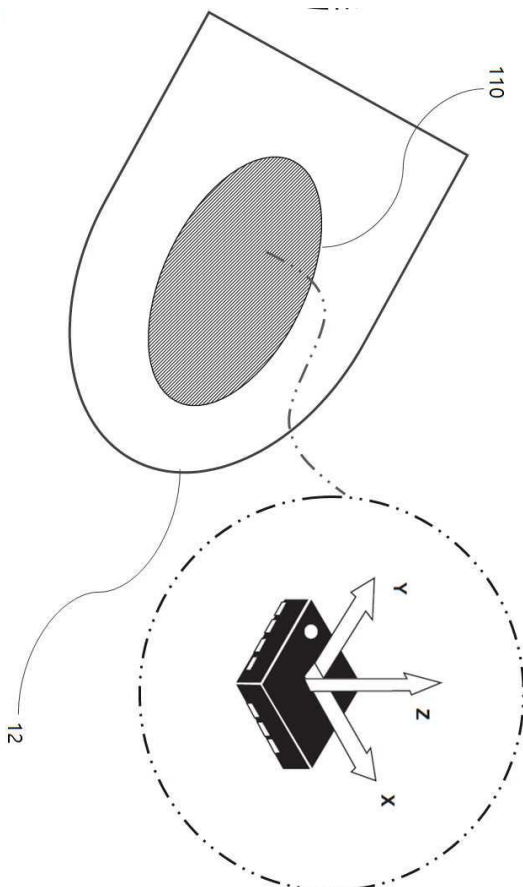


도면7

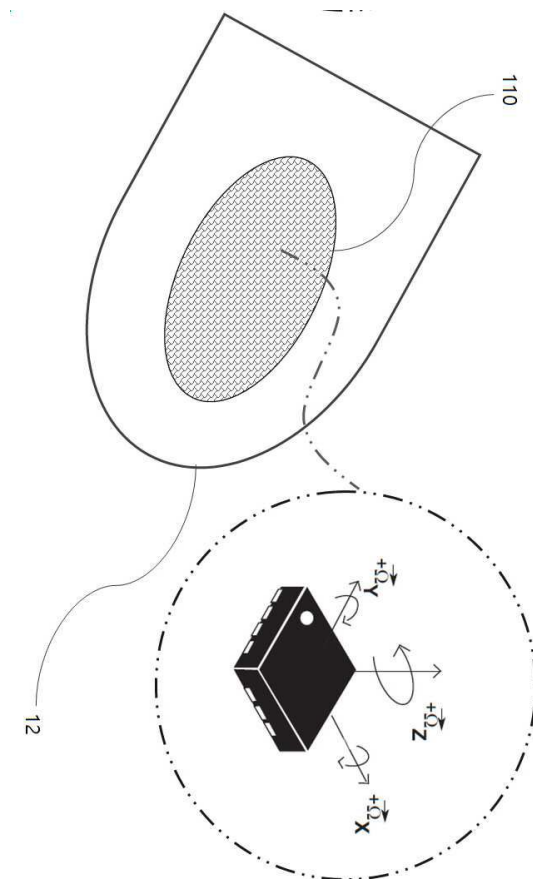


도면8

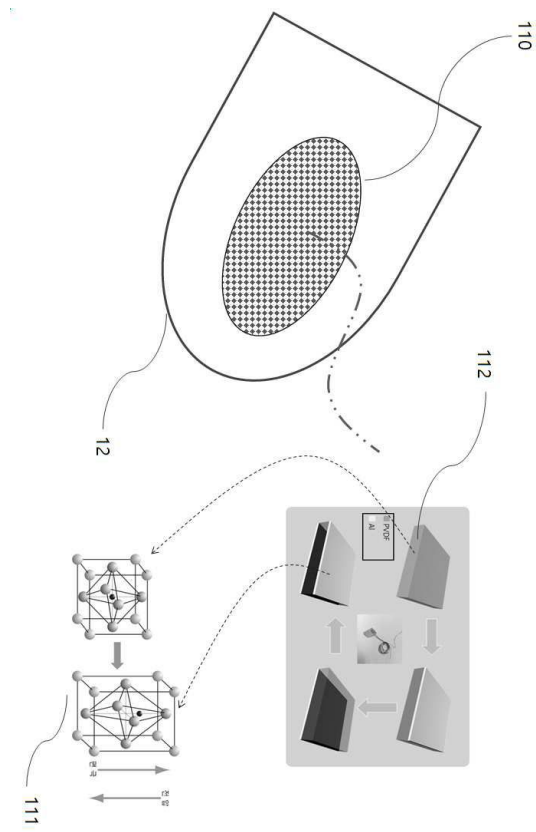


도면9

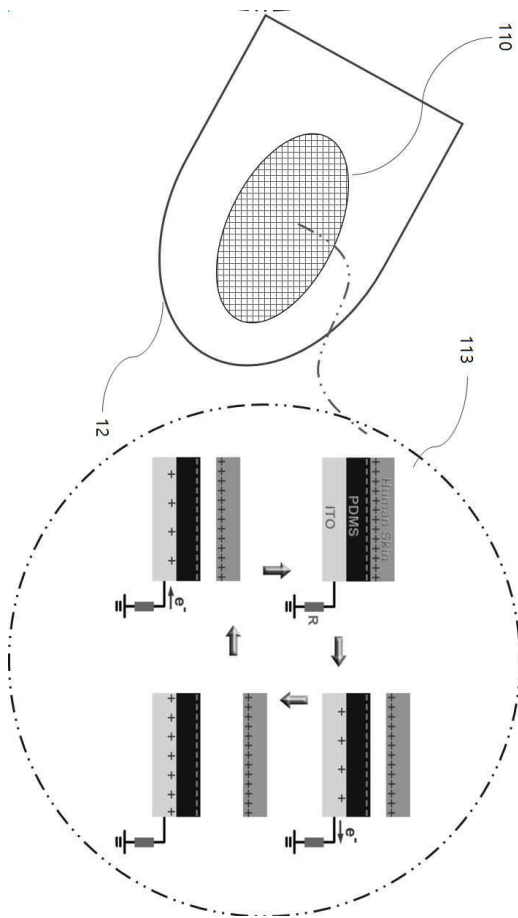


도면10

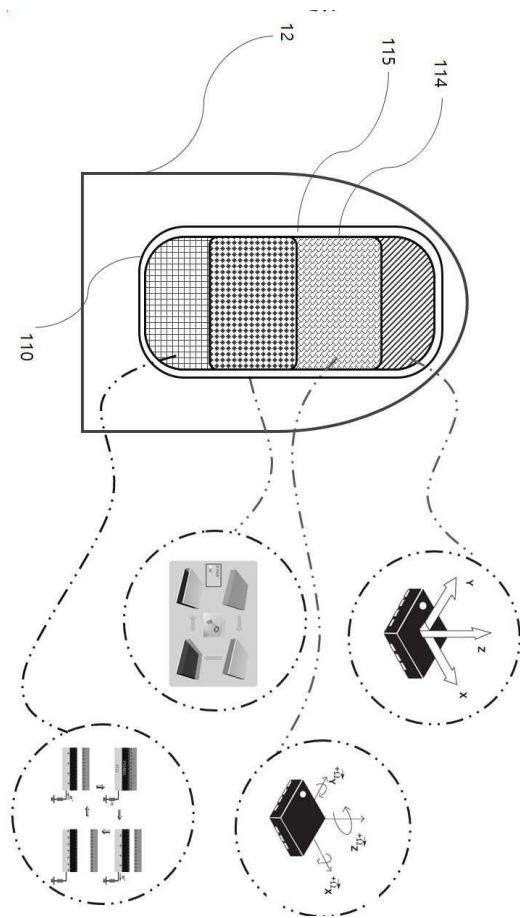


도면11

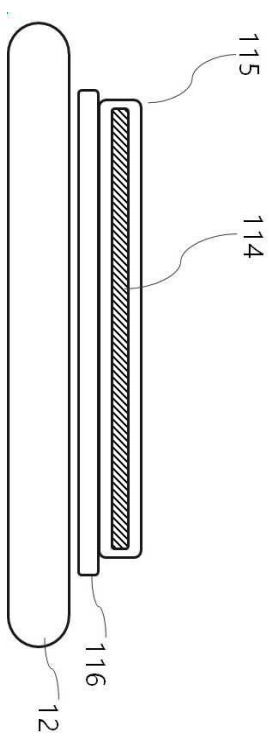


도면12

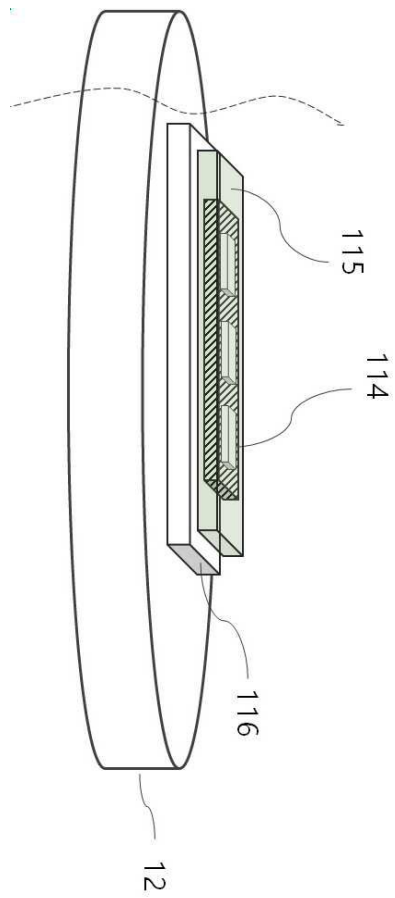


도면13

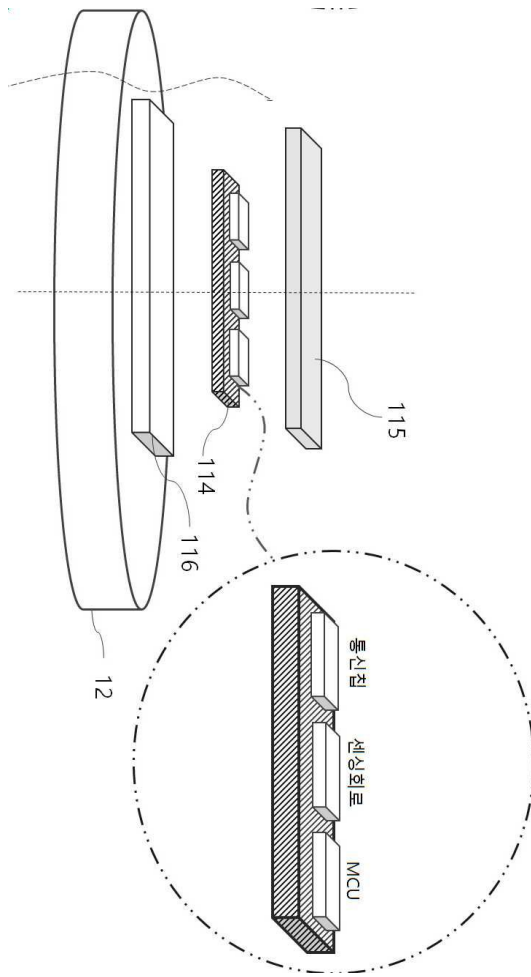


도면14

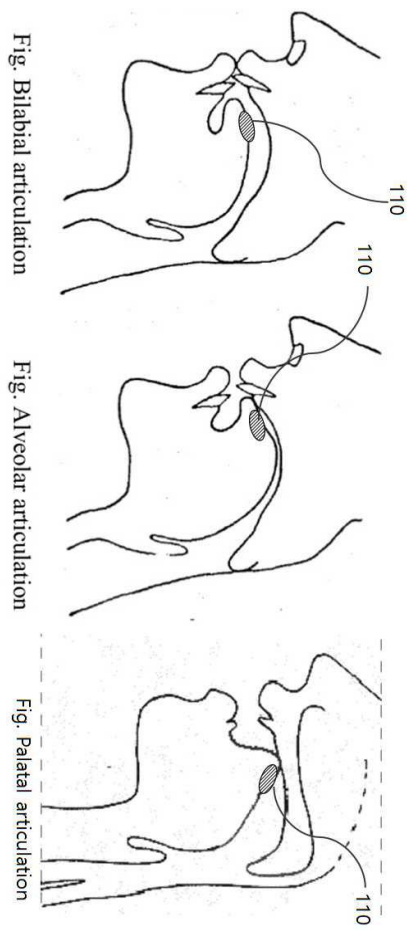


도면15

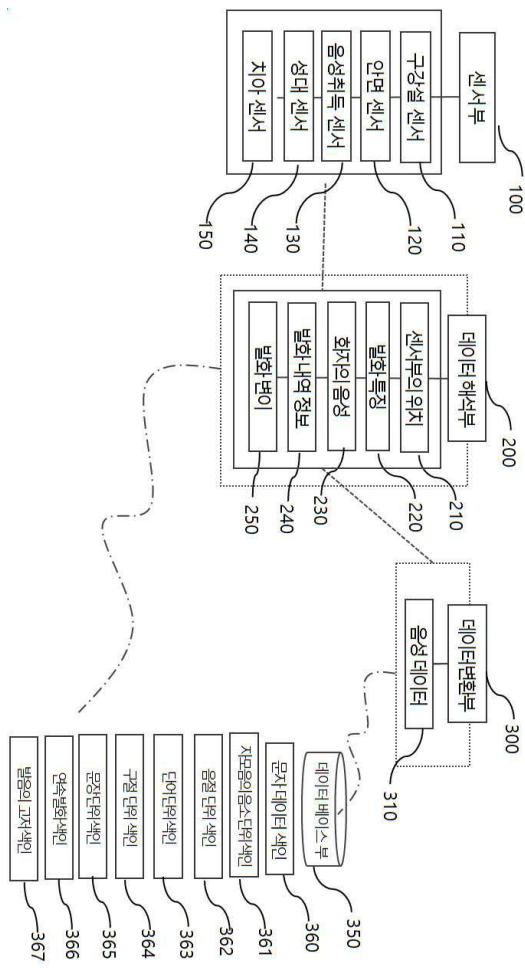


도면16

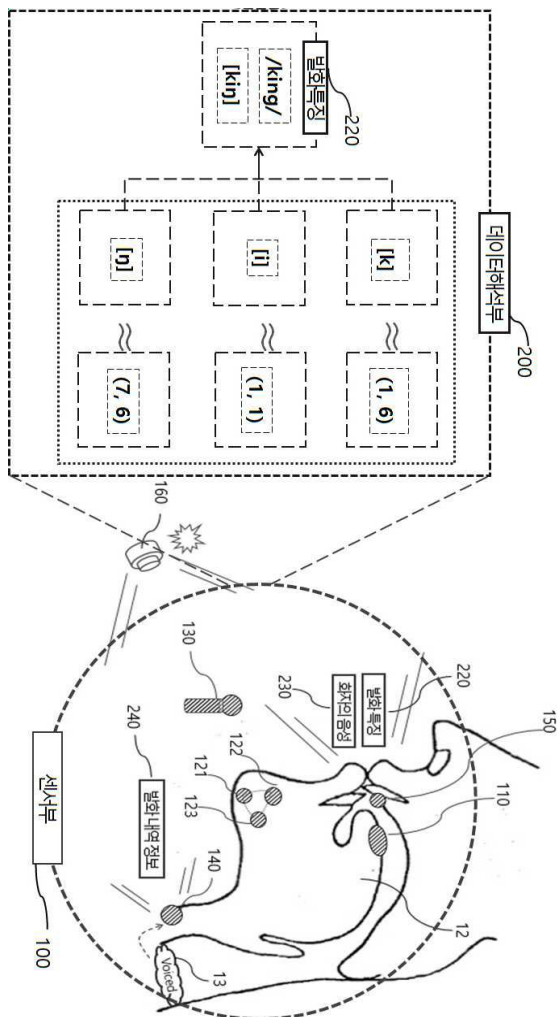


도면17

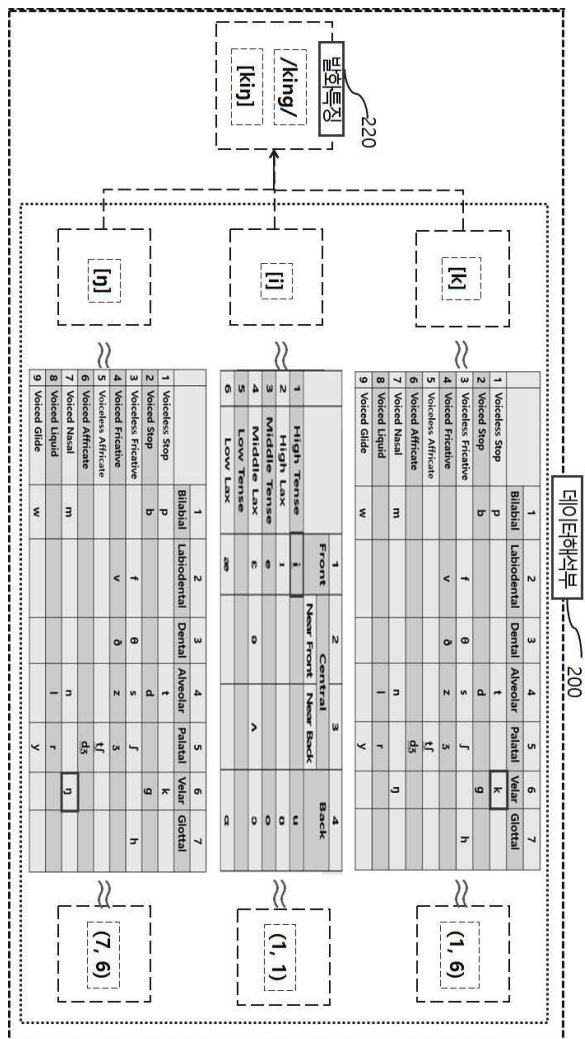


도면18

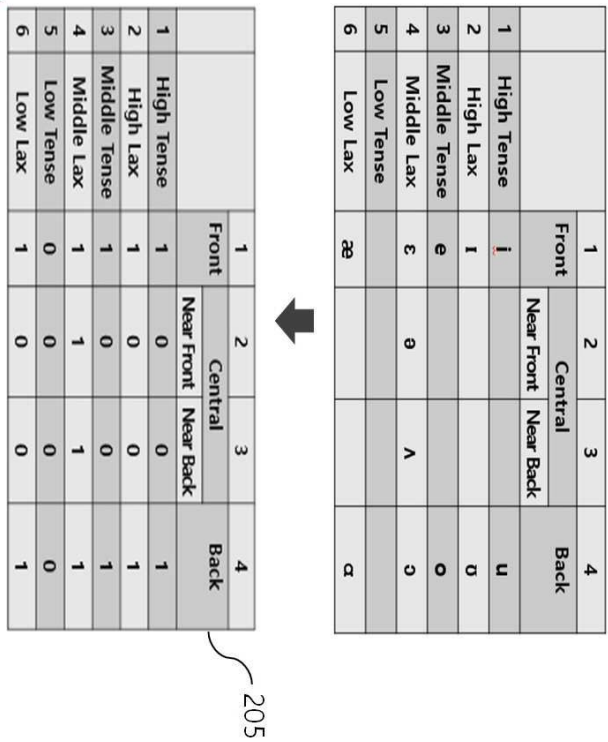


도면19

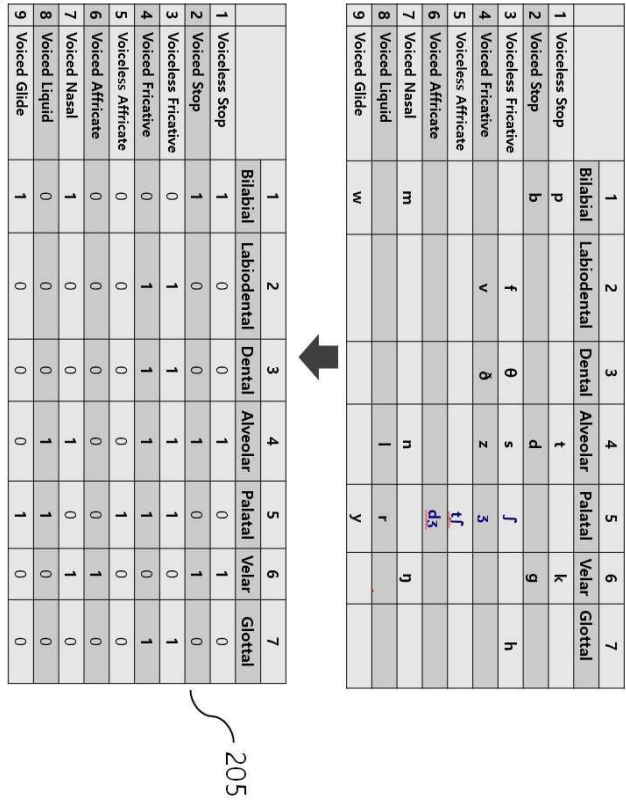

도면20

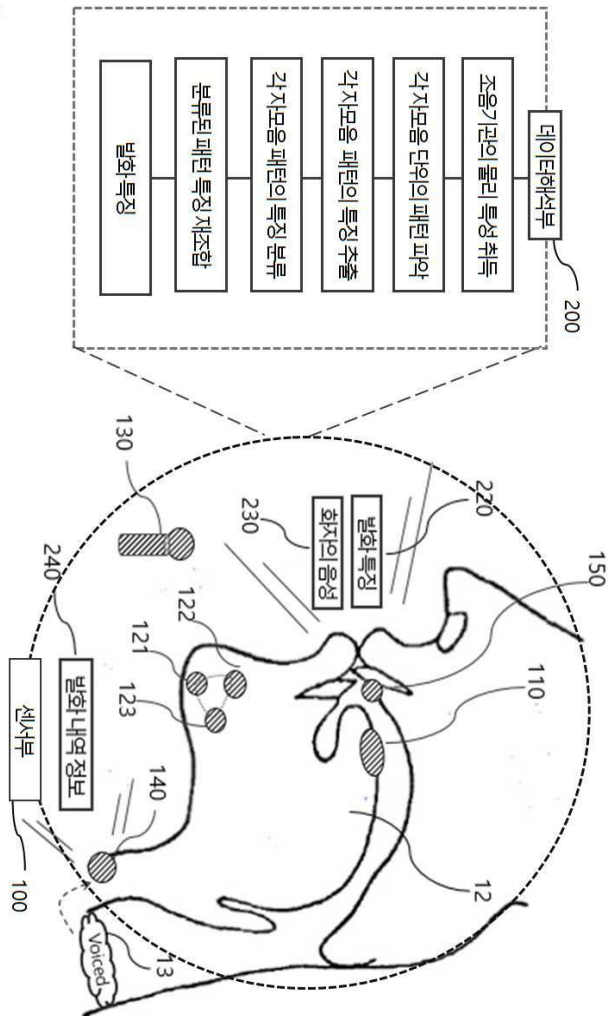



도면21

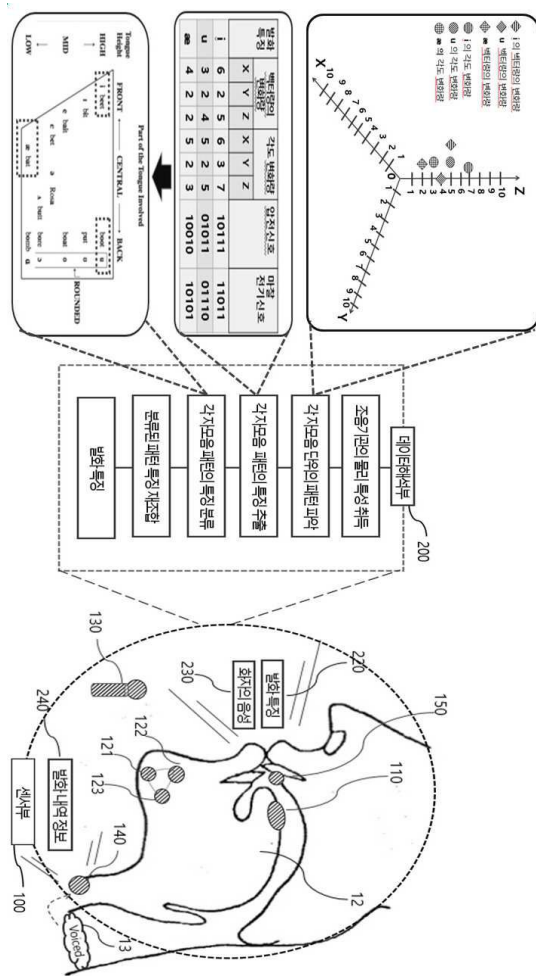


도면22

발 화 특 징	팩터링의 변화량				기도변화량		압전신호	미찰 전기신 호
	X	Y	Z	X	Y	Z		
i	6	2	5	6	3	7	10111	11011
u	3	2	4	5	2	5	01011	01110
ae	4	2	2	5	2	3	10010	10101

데이터 해석부

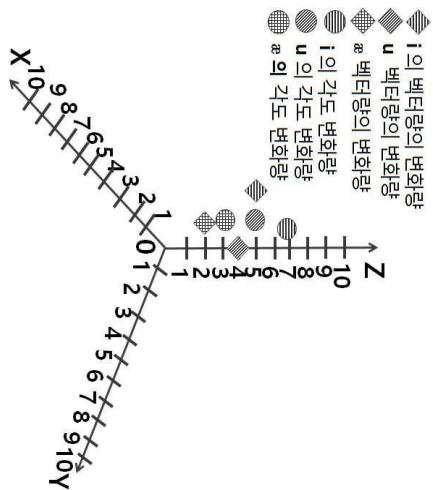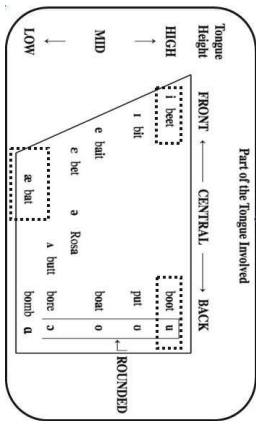

도면23

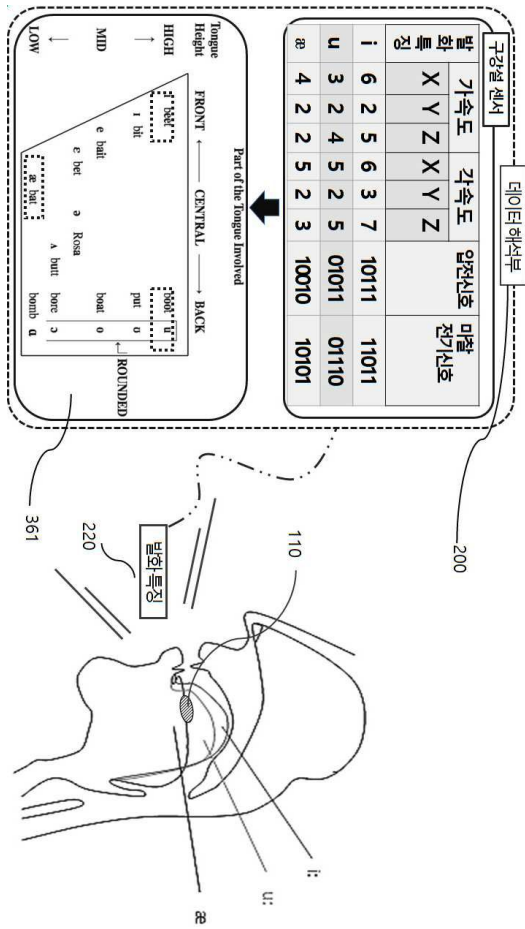

도면24



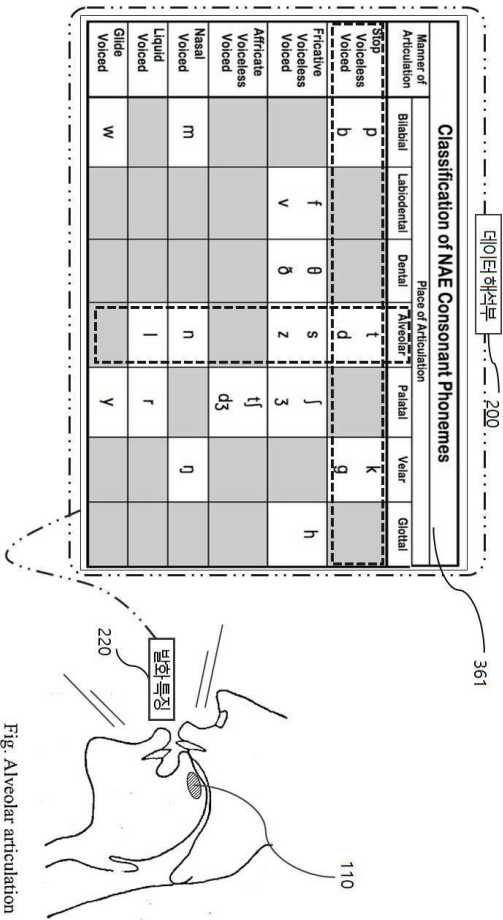


Fig. Alveolar articulation


도면25

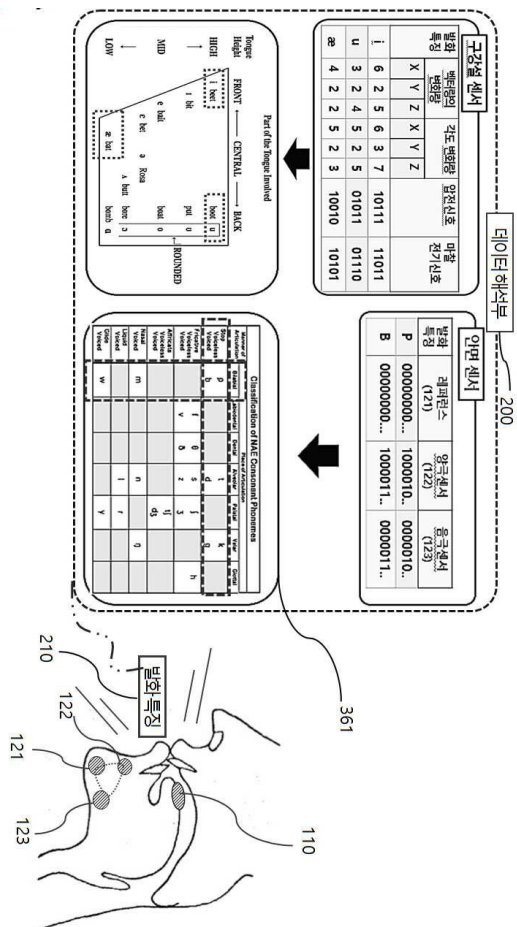


도면26

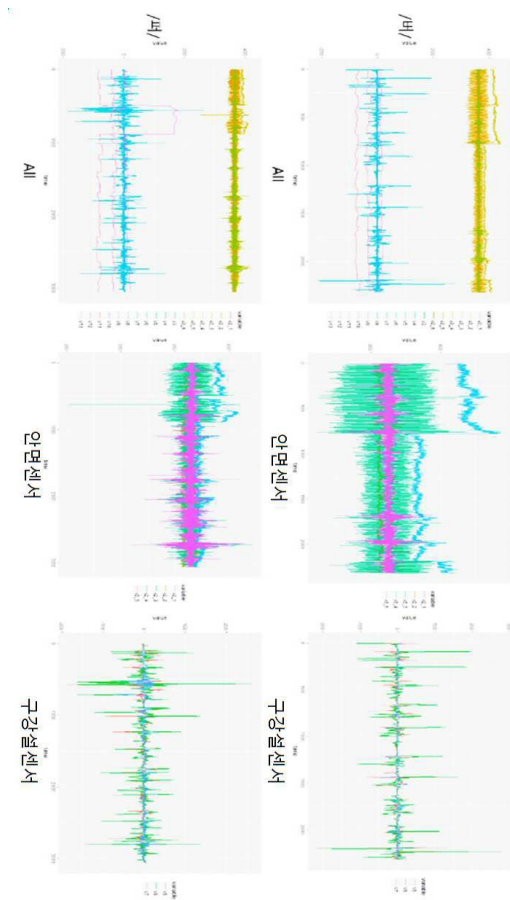


도면27

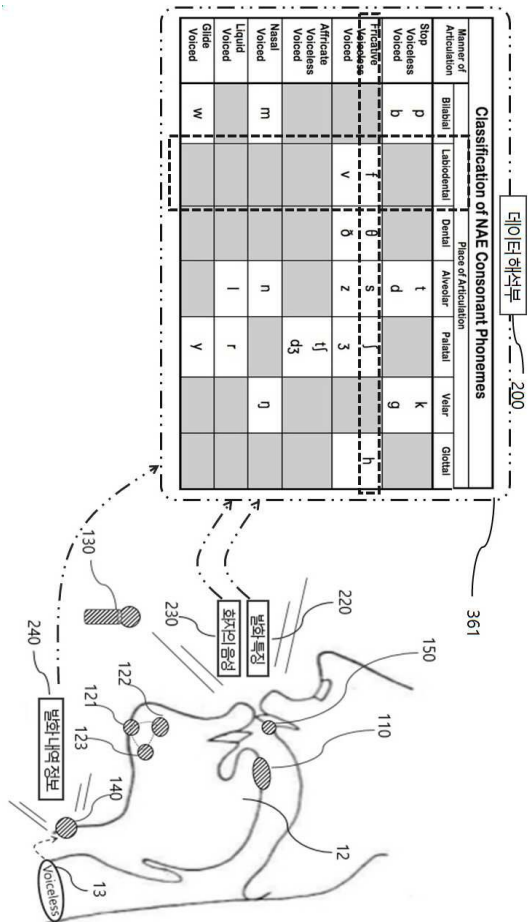


도면28

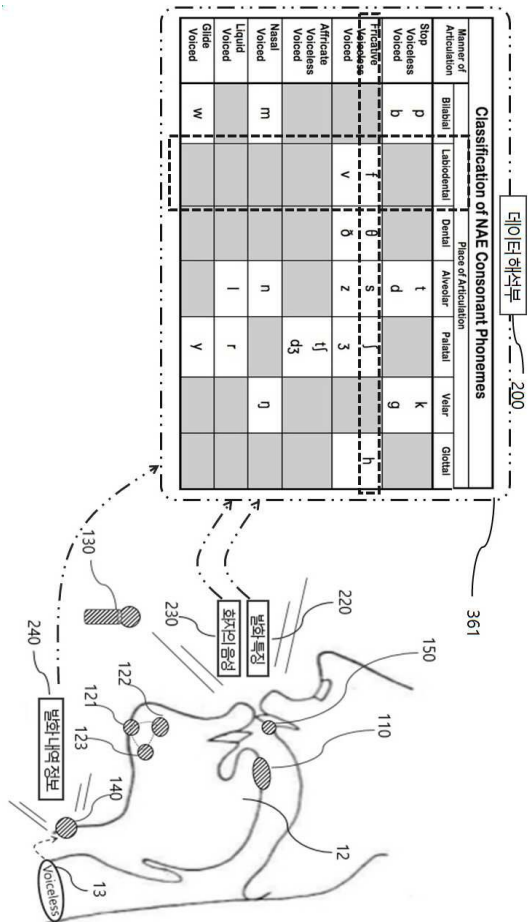


도면29

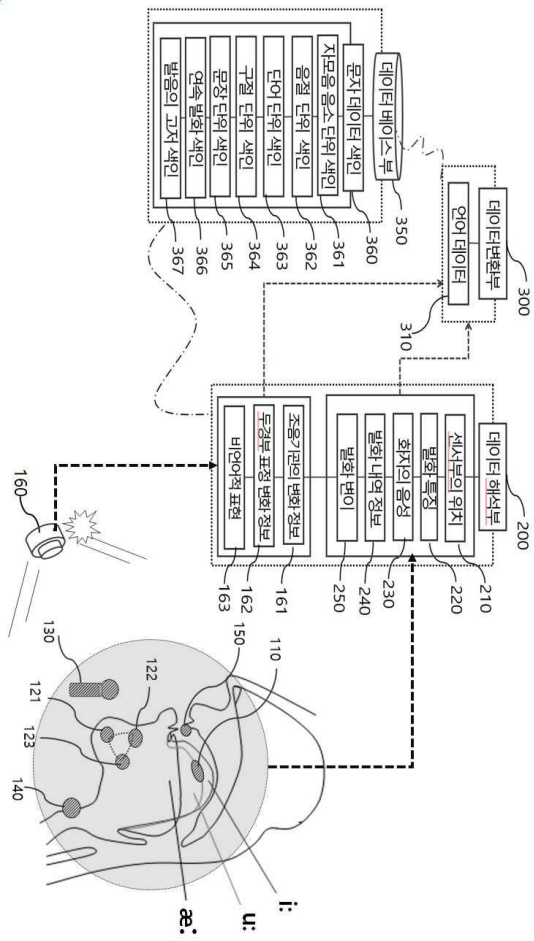


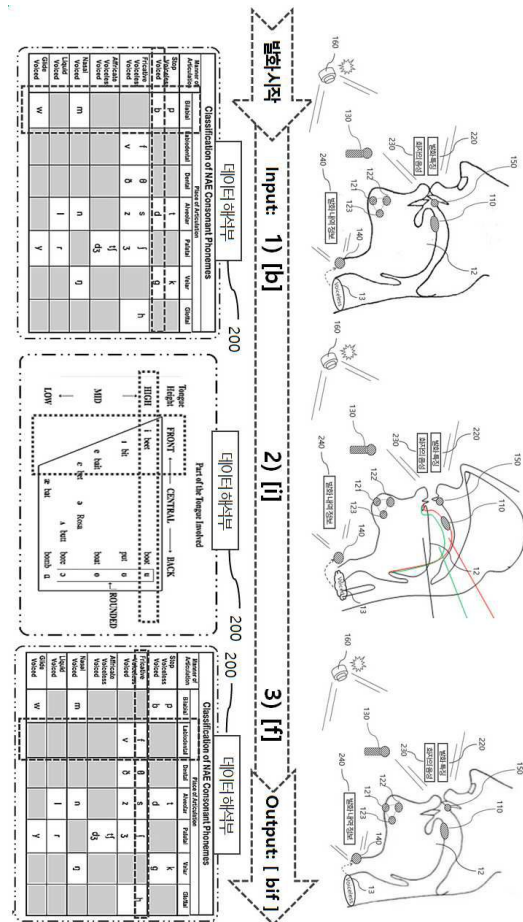


도면31

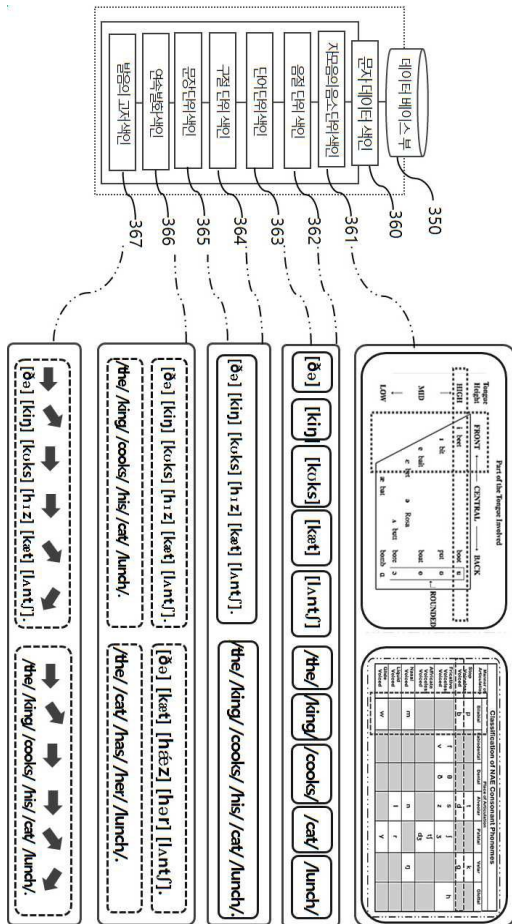


도면32

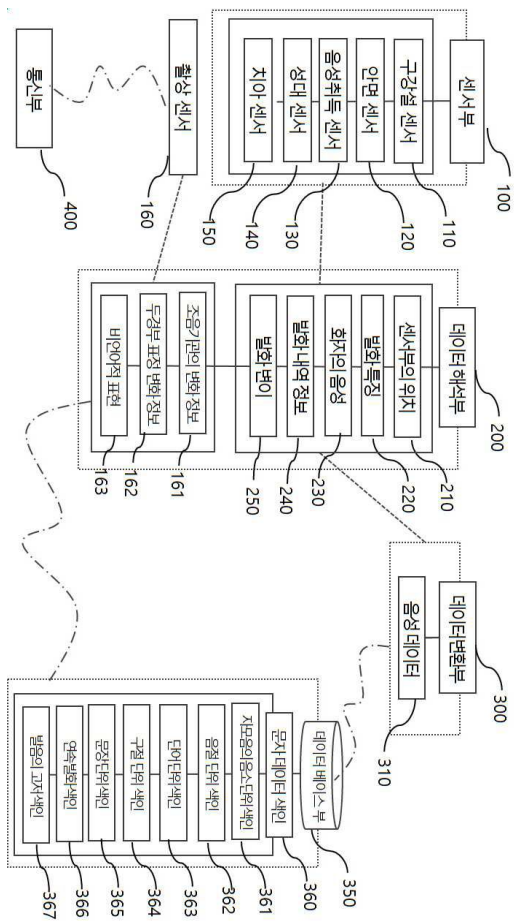


도면33

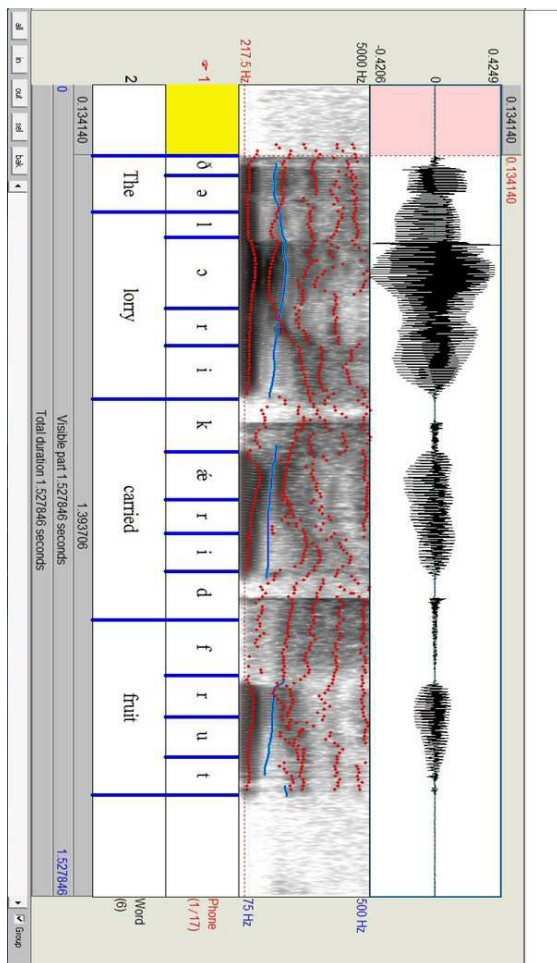


도면34

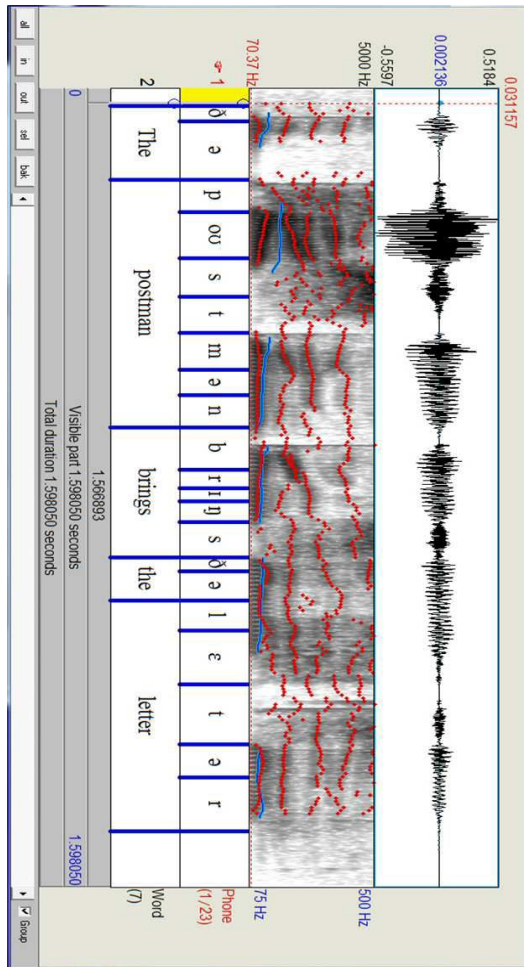


도면35

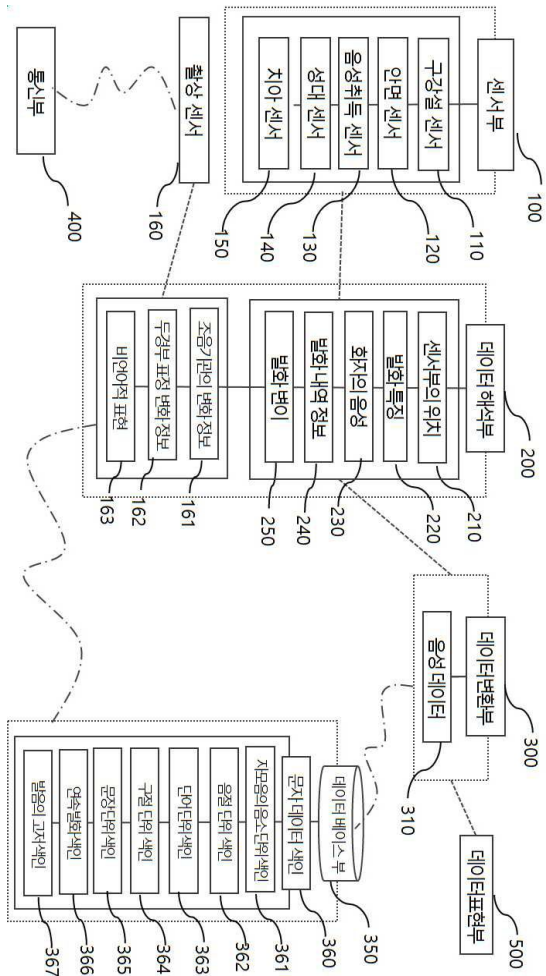


도면36

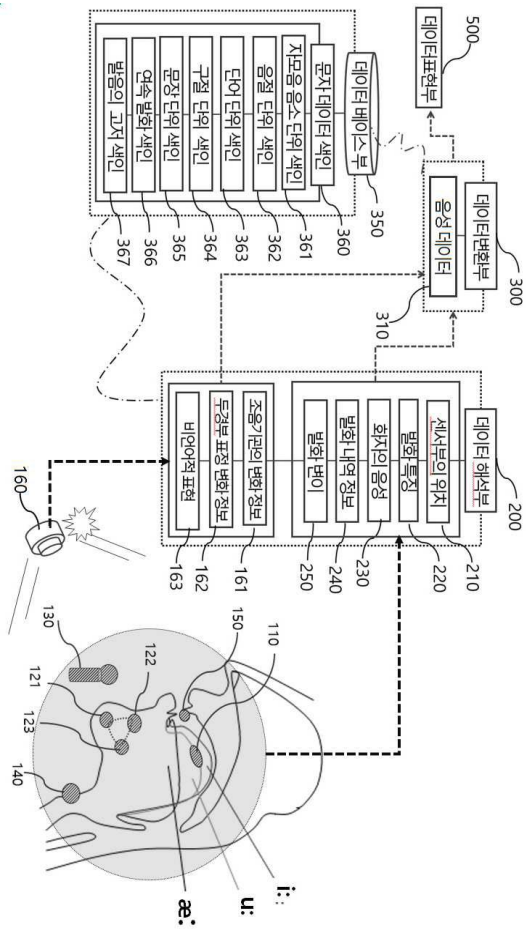


도면37

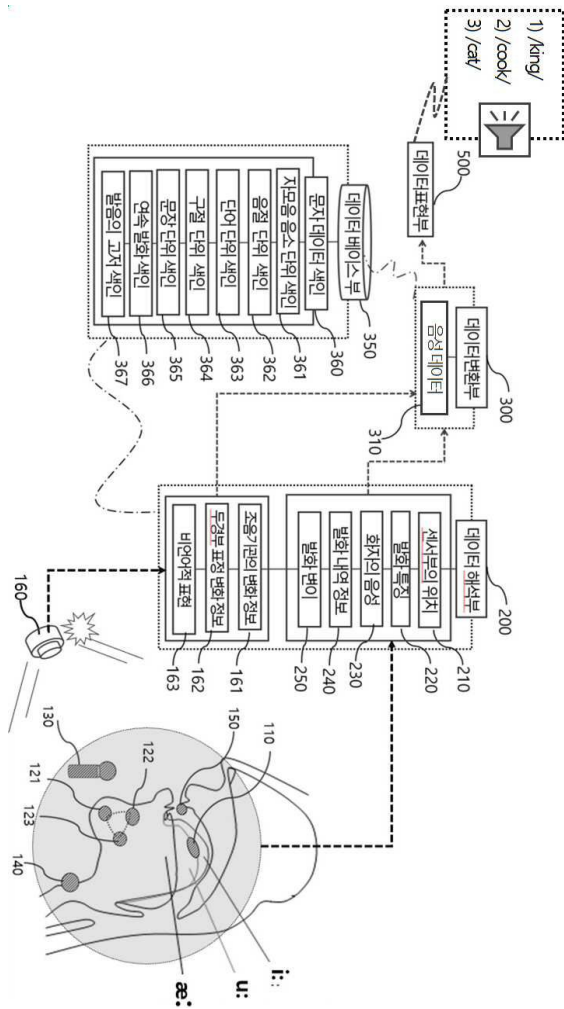


도면38

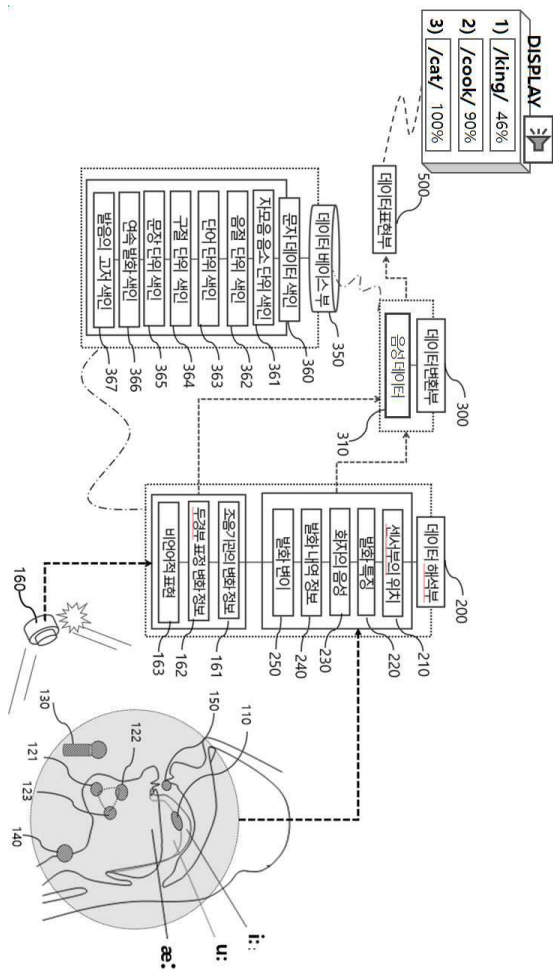


도면39

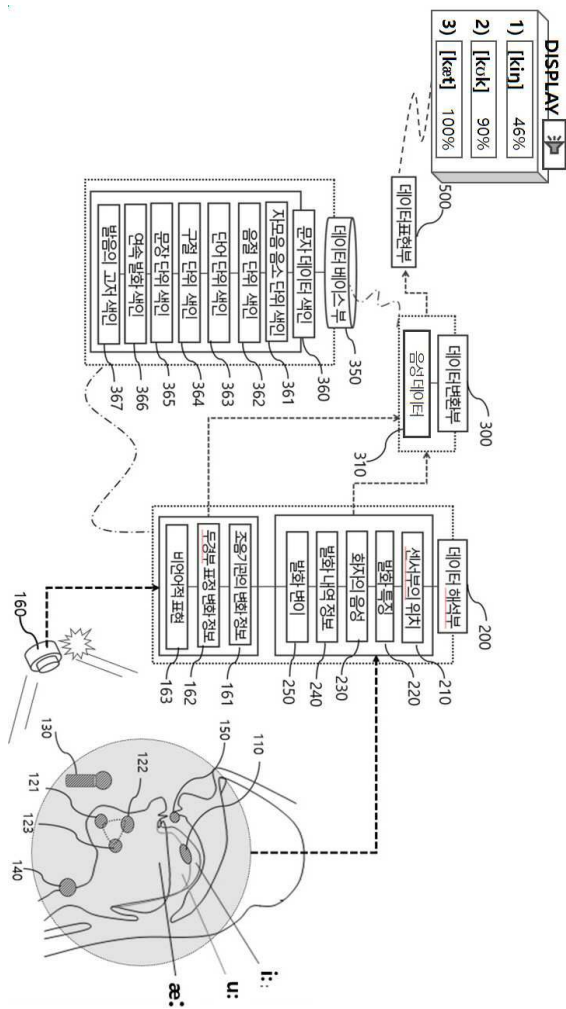


도면40

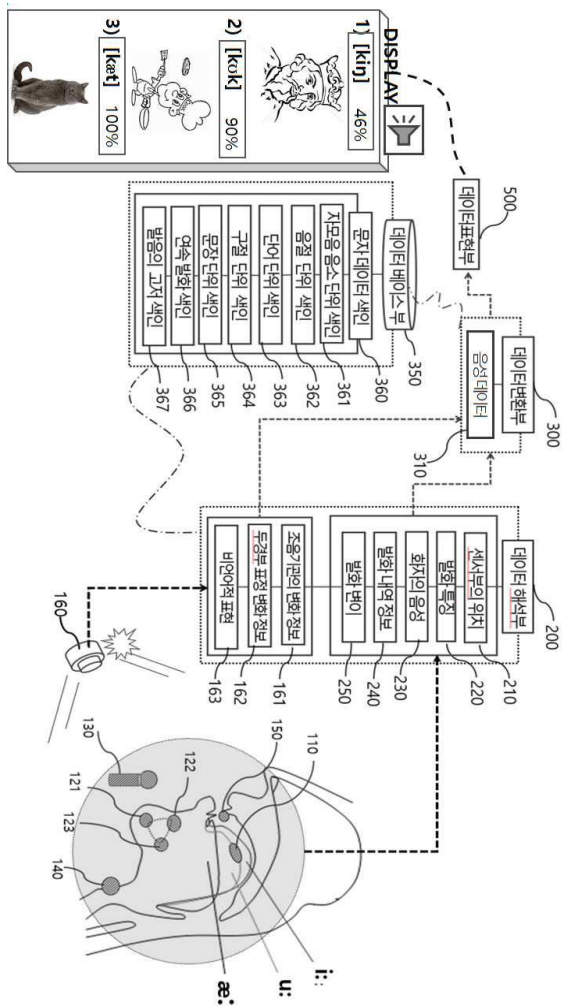


도면41

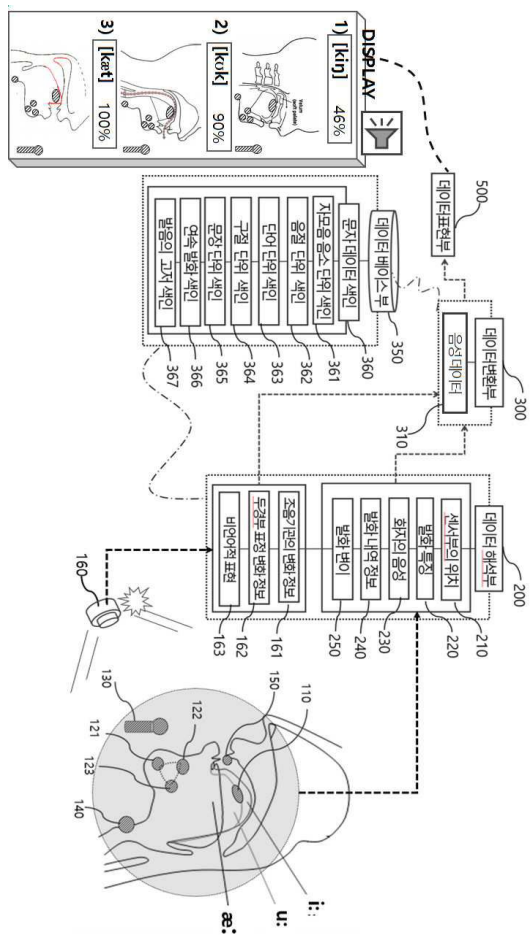


도면42

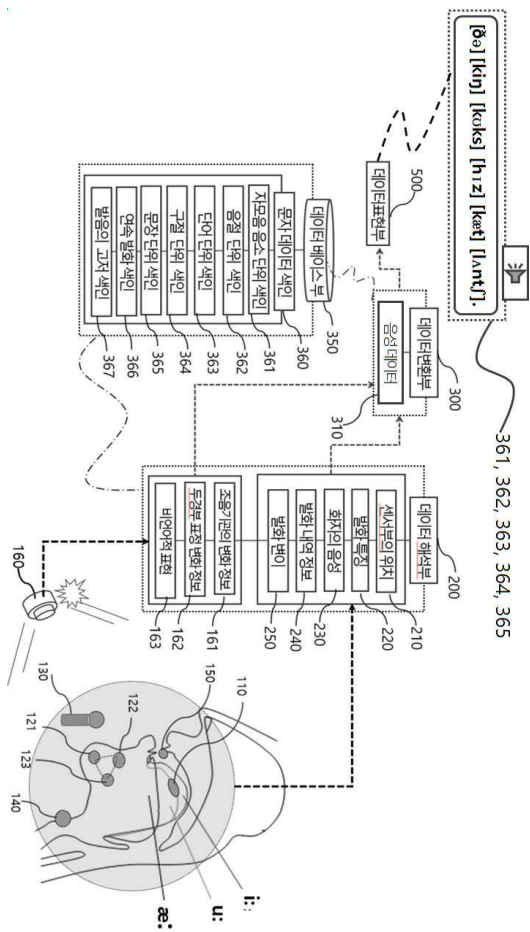


도면43

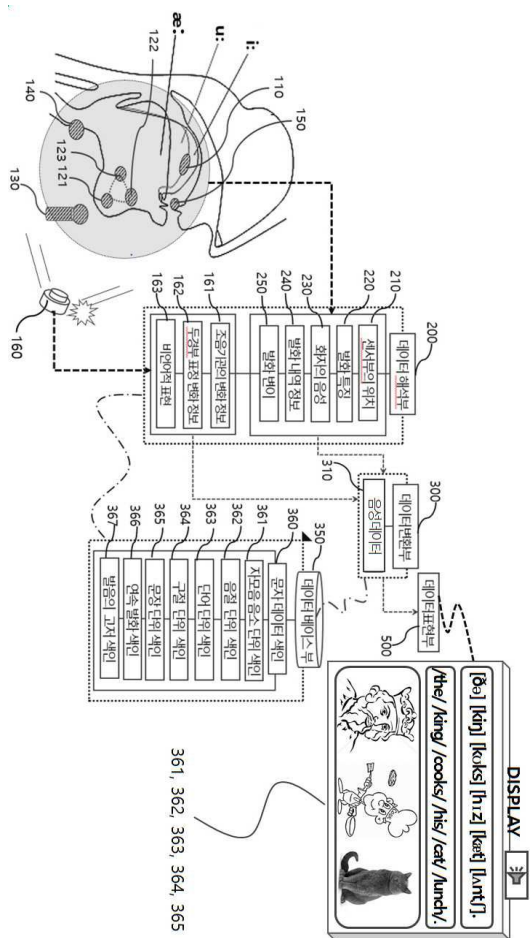


도면44

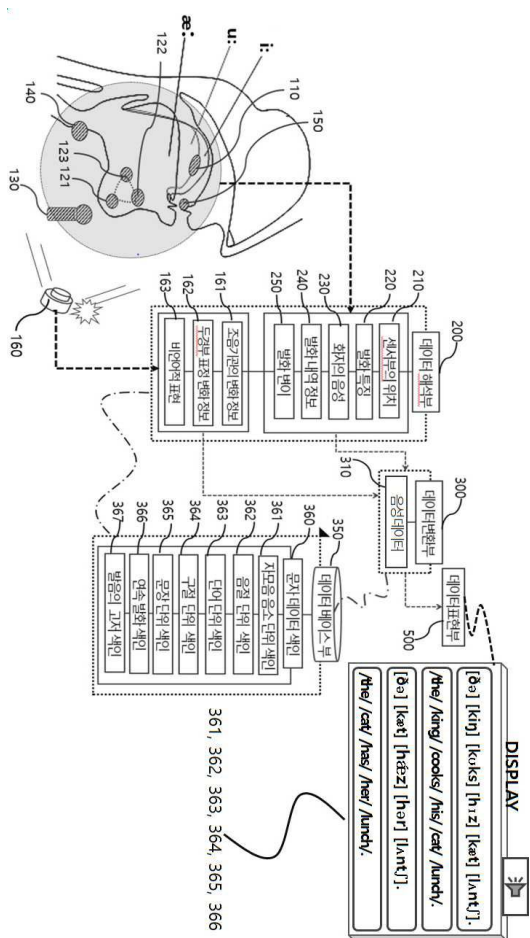


도면45

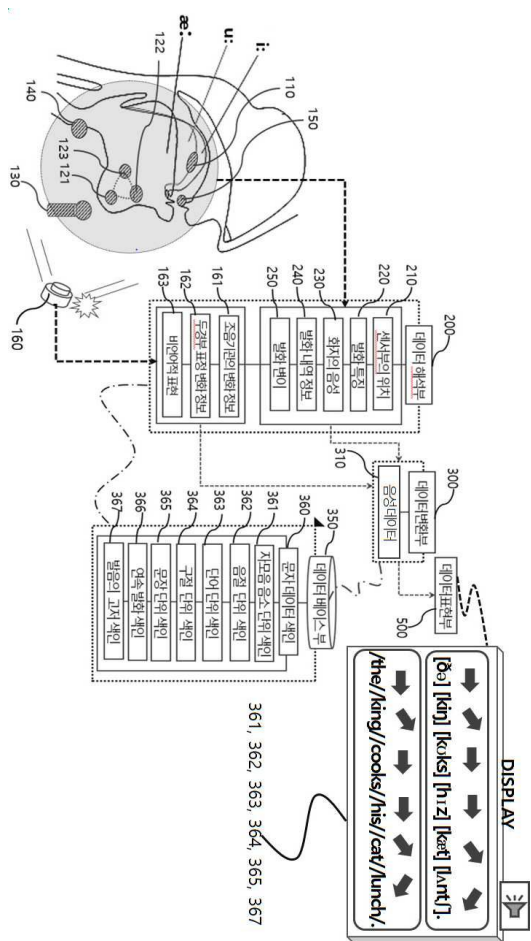

도면46

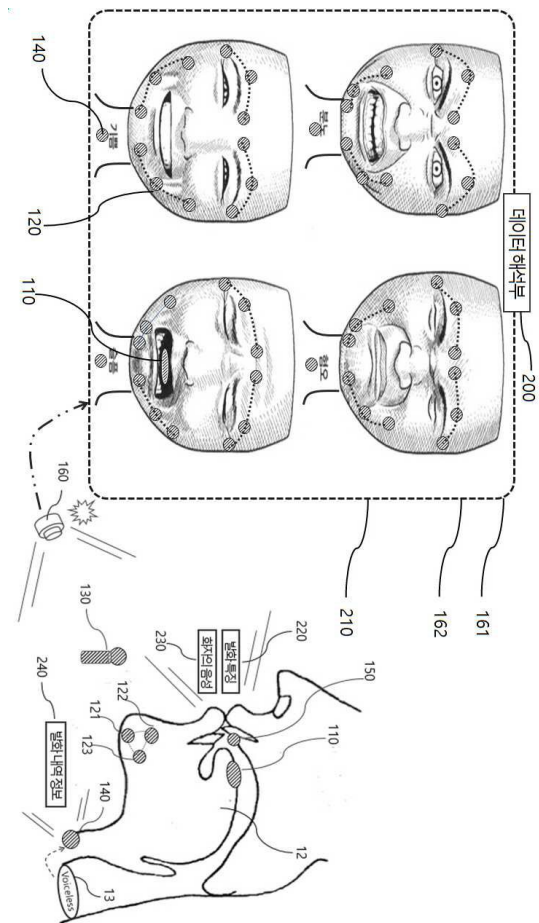

도면47

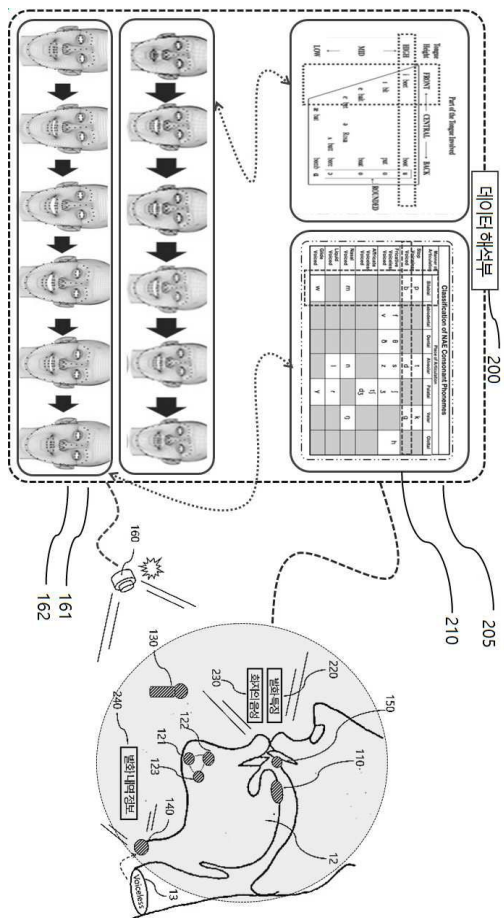

도면48

단위: %

		표준 발화로 센싱된 조음기관 물리특성				
		1	2	3	4	5
발화된 조음기관 물리특성		Bilabial	Alveolar	Palatal	Velar	Glottal
	1	80	5	3	5	7
	2	Alveolar	82	10	3	1
	3	Palatal	17	70	6	3
	4	Velar	5	9	81	2
	5	Glottal	4	4	8	75

610


도면49

단위: %


		센싱된 조음기관 물리특성			
		1	2	3	4
발화된 조음기관 물리특성		True Positive	False Negative	False Positive	True Negative
	1	80.4	19.6	15.3	84.7
	2	Alveolar	81.2	18.8	22.2
	3	Palatal	70.4	29.6	15.3
	4	Velar	81.4	18.6	19.1
	5	Glottal	74.7	25.3	21.8

610


도면50

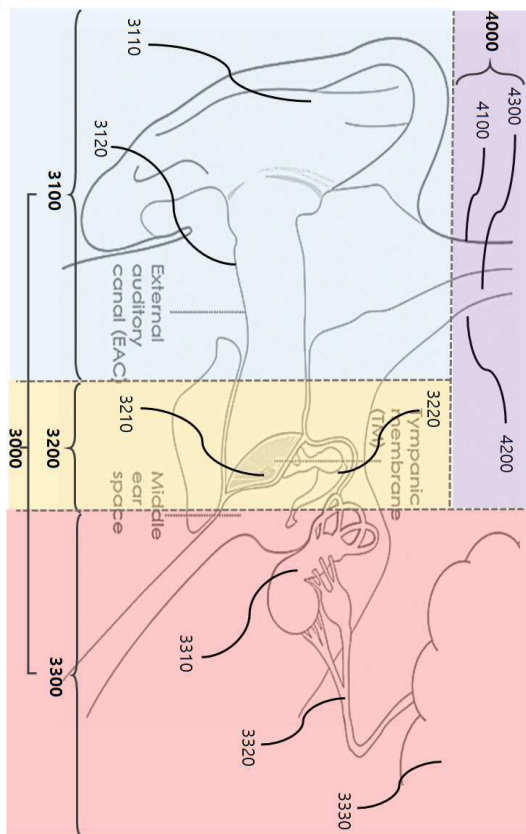


도면51

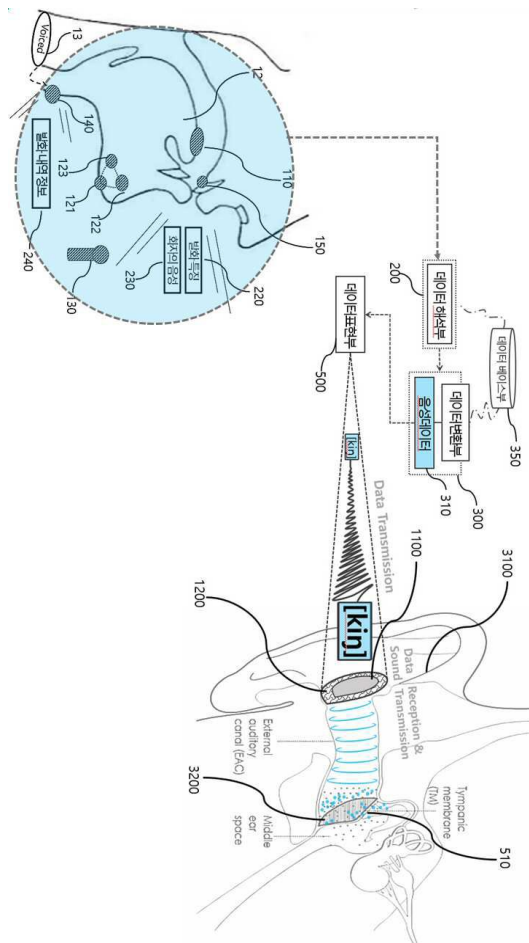


도면52

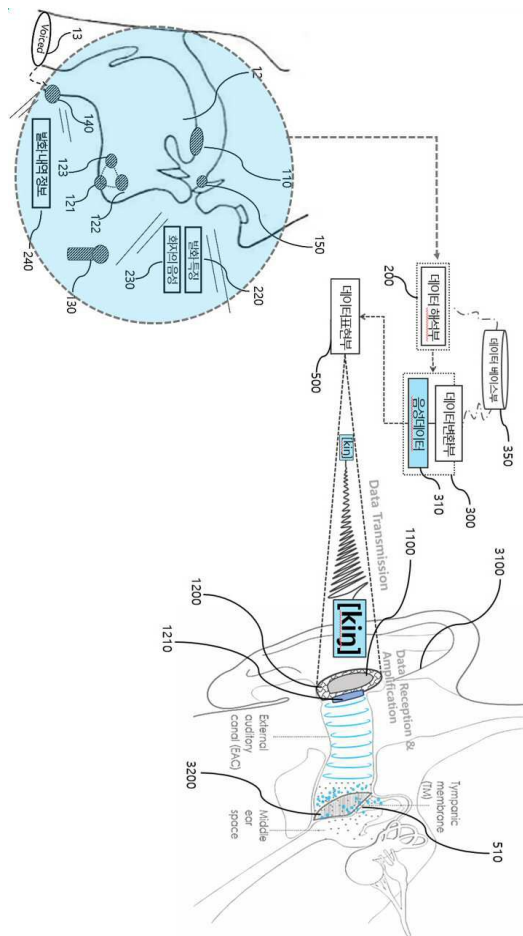


도면53

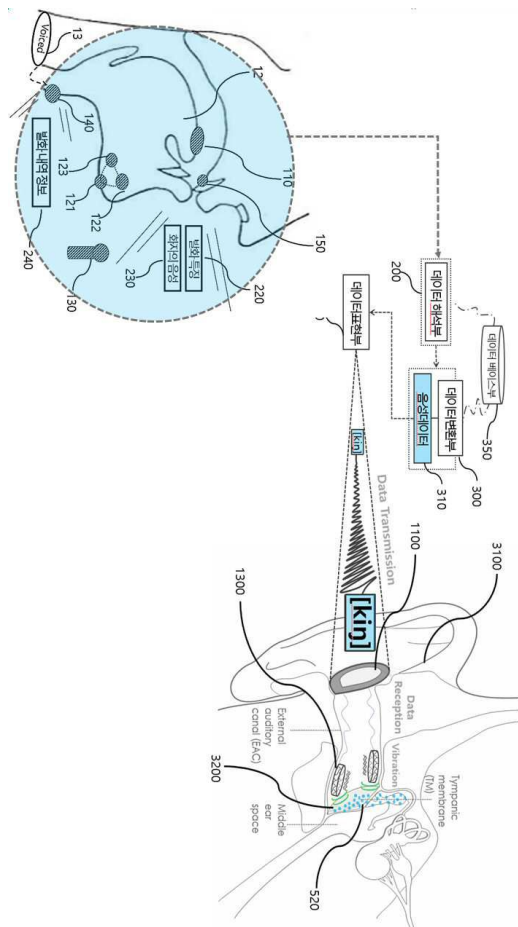


도면54

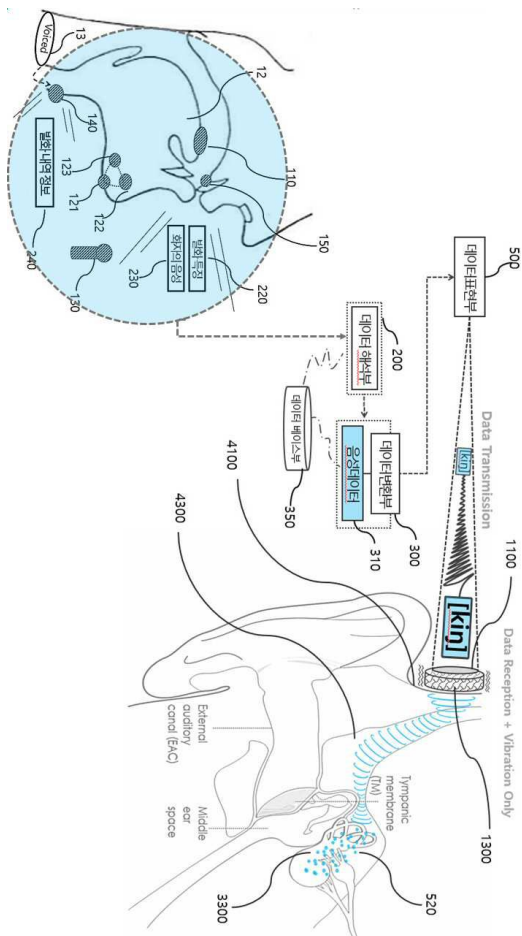


도면55

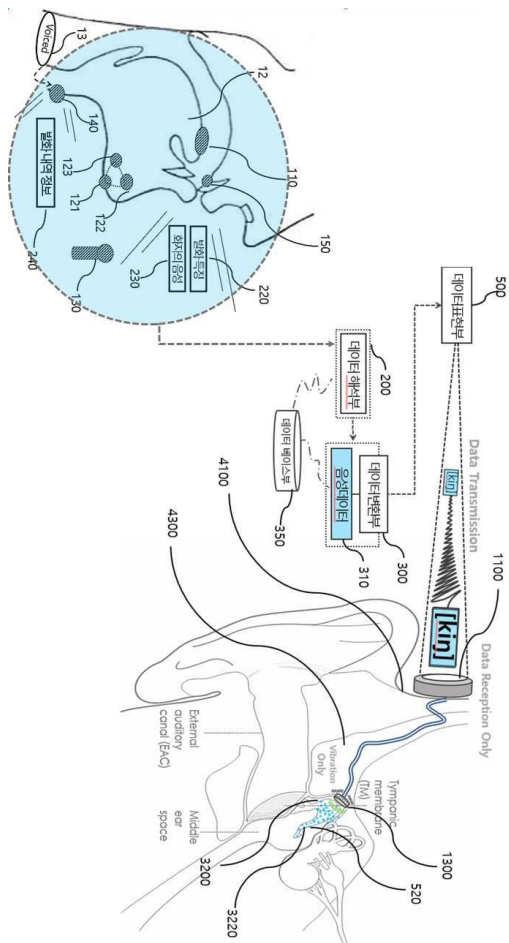


도면56

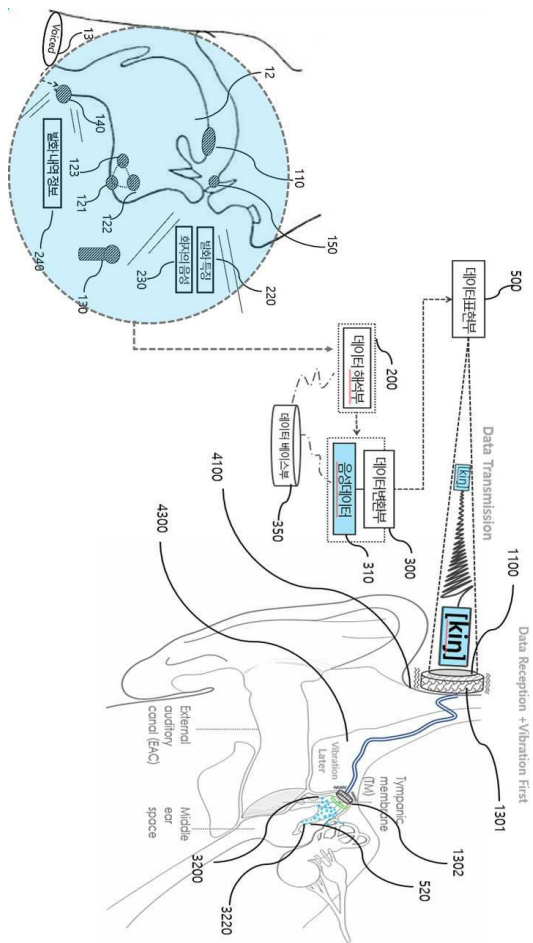


도면57

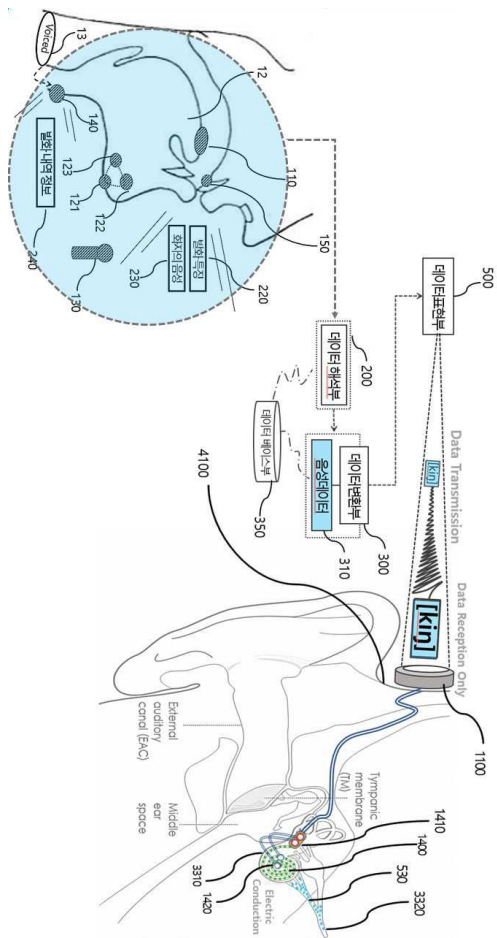


도면58

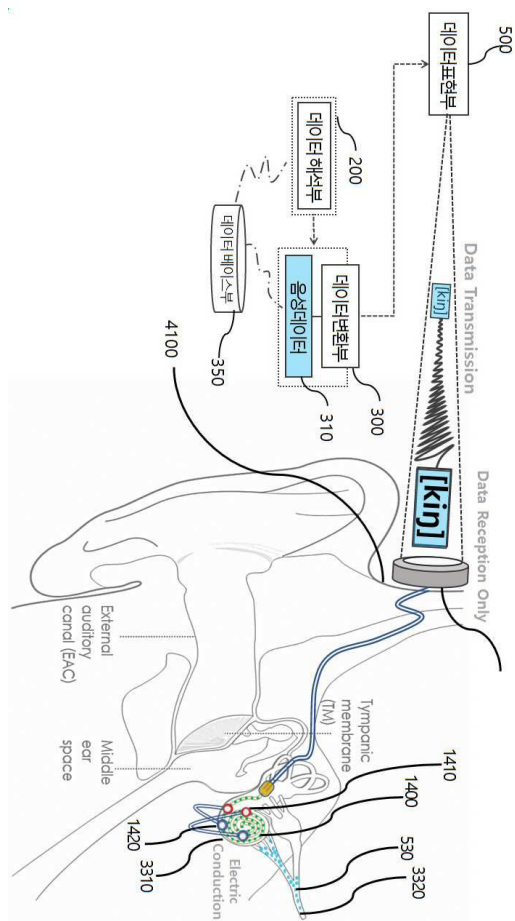

도면59

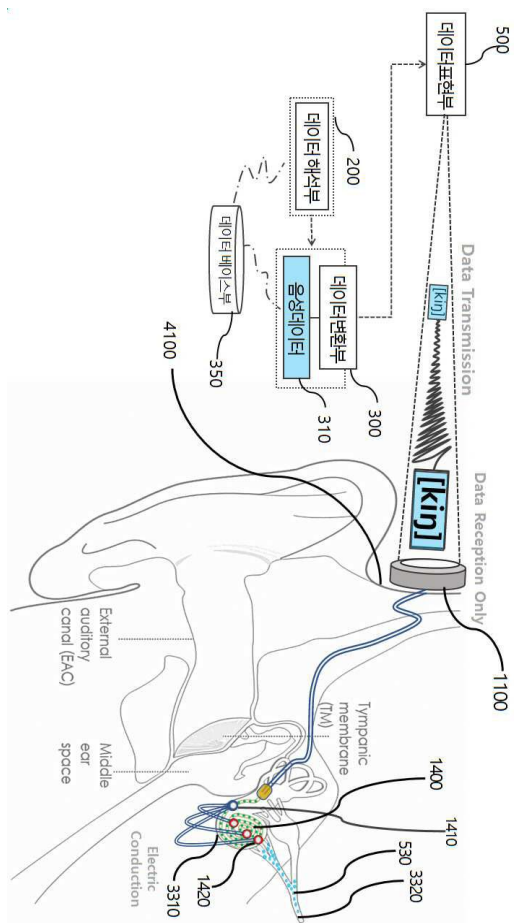

도면60

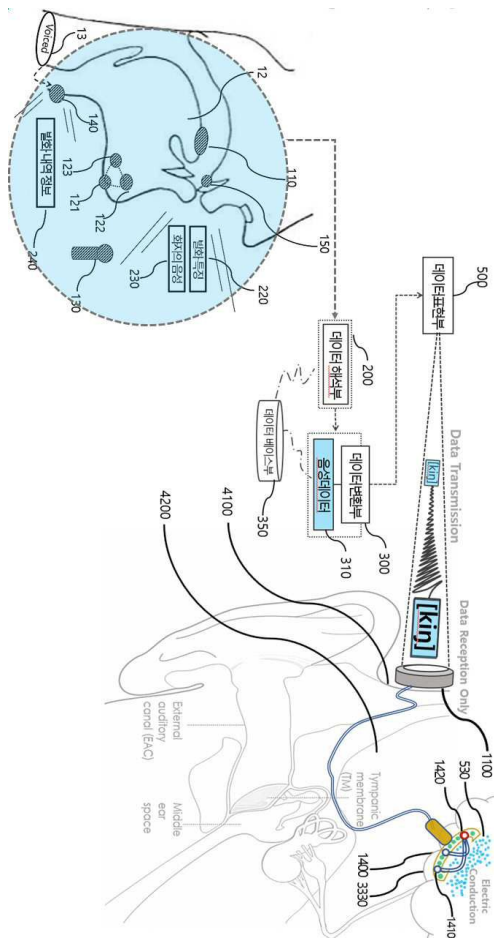

도면61

