



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201997900637698
Data Deposito	17/11/1997
Data Pubblicazione	17/02/1998

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	61	M		

Titolo

MODIFICA DISPOSITIVO PER INFUSIONE ENDOVENOSA

MODIFICA DEL DISPOSITIVO PER INFUSIONE ENDOVENOSA

Descrizione dell'invenzione di modifica del dispositivo per infusione endovenosa

Roma, 12/10/1977. L'Invenzione è stata fatta dalla Sig.ra Maimone Rita, residente a Mentana, domiciliata in Mentana, via Doganella 11 Tor Lupara.

La presente invenzione ha per oggetto una innovazione nel dispositivo per infusione endovenosa, con particolare riferimento alle alette dell'ago cannula a due entrate.

L'uso attuale oblige l'operatore ad una serie di accorgimenti che richiedono un impiego di tempo alquanto sensibile e un margine limitato di sicurezza durante le operazioni necessarie per raggiungere l'esito finale ovvero la stabilità sulla pelle.


Infatti dopo aver inserito la cannula, è necessario fissarla con una striscia di cerotto. Proprio in questa frazione di tempo, c'è il rischio che la cannula possa muoversi dal momento che rimane incustodita, soprattutto quando il paziente è particolarmente agitato e confuso dallo stato di emergenza.

L'innovazione che forma oggetto del presente trovato, ha lo scopo di eliminare l'inconveniente sopra citato e di sfruttare in modo più razionale e più rapido l'operazione soprattutto nei momenti di emergenza in cui spesso il dispositivo viene usato.

La caratteristica di questa modifica consiste nel ricoprire la superficie delle alette, quella che poggierà sulla cute, con uno strato di adesivo coperto da pellicola trasparente (come da cerotto), cosicchè nel momento in cui la cannula viene inserita in vena, basta strappare la pellicola e le alette si fisseranno sulla cute tramite l'adesivo che le ricopre evitando in tal modo di lasciare incustodito il dispositivo e quindi il rischio di muoversi.

Si ottiene così, lo stesso risultato con maggiore igiene, rapidità e sicurezza.


Rita Maimone




RIVENDICAZIONI:

- 1) Dispositivo per infusione endovenosa in cui la superficie delle alette (che poggiano sulla cute) è caratterizzata da un strato di adesivo anallergico.
- 2) Dispositivo per infusione endovenosa in cui lo strato adesivo che ricopre le alette, è ricoperto da una pellicola trasparente.

Prote. Marimone



RM 97 U 000247

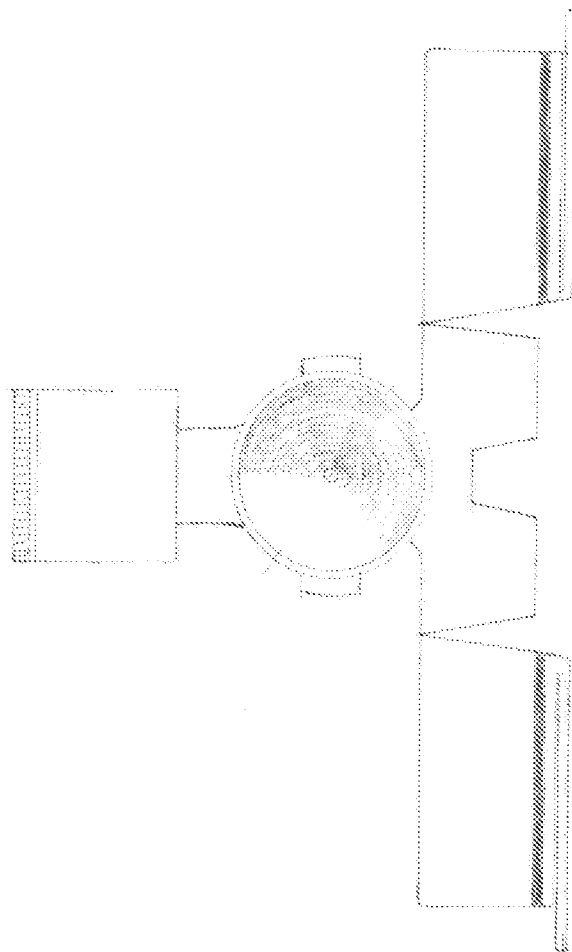

Rita Harmon

