



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202514686 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 07

(21) 申请号 201220107075. 6

(22) 申请日 2012. 03. 11

(73) 专利权人 张守来

地址 276800 山东省日照市中医医院

(72) 发明人 张守来 李乃杰 王丽

(51) Int. Cl.

A43B 7/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种糖尿病用鞋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种糖尿病用鞋,属于一种医疗保健鞋,包括鞋底和鞋帮,鞋底上端面设置衬垫,衬垫内设置远红外按摩磁石,衬垫的厚度至少2厘米,每只鞋中远红外按摩磁石的数量为5-8个,衬垫可以减少外界或自身对足部血管的压迫,远红外按摩磁石可以加快足部血管的血液循环,增加足部的营养供应。

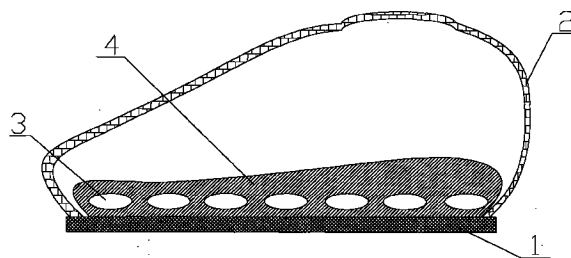

1. 一种糖尿病用鞋,包括鞋底(1)和鞋帮(2),其特征在于:鞋底(1)上端面设置衬垫(4),衬垫(4)内设置远红外按摩磁石(3)。
2. 根据权利要求1所述的一种糖尿病用鞋,其特征在于:衬垫(4)的厚度至少2厘米。
3. 根据权利要求1所述的一种糖尿病用鞋,其特征在于:每只鞋中远红外按摩磁石(3)的数量为5-8个。

一种糖尿病用鞋

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种医疗保健鞋,特别涉及一种糖尿病用鞋。

背景技术

[0002] 近几年,我国糖尿病发病率呈逐年上升趋势,糖尿病足是糖尿病病人常见的并发症,临床上糖尿病病足的发病原因主要是足部的组织细胞得不到足够的营养,从而导致组织病变或者死亡。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为解决上述问题,提供了一种糖尿病用鞋。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种糖尿病用鞋,包括鞋底和鞋帮,鞋底上端面设置衬垫,衬垫内设置远红外按摩磁石。

[0005] 衬垫的厚度至少 2 厘米。

[0006] 每只鞋中远红外按摩磁石的数量为 5-8 个。

[0007] 本实用新型的有益效果是:衬垫可以减少外界或自身对足部血管的压迫,远红外按摩磁石可以加快足部血管的血液循环,增加足部的营养供应。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图;

[0009] 图中:1、鞋底,2、鞋帮,3、远红外按摩磁石,4、衬垫。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示:一种糖尿病用鞋,包括鞋底 1 和鞋帮 2,鞋底 1 上端面设置衬垫 4,衬垫 4 内设置远红外按摩磁石 3。

[0011] 衬垫 4 的厚度至少 2 厘米。

[0012] 每只鞋中远红外按摩磁石 3 的数量为 5-8 个。

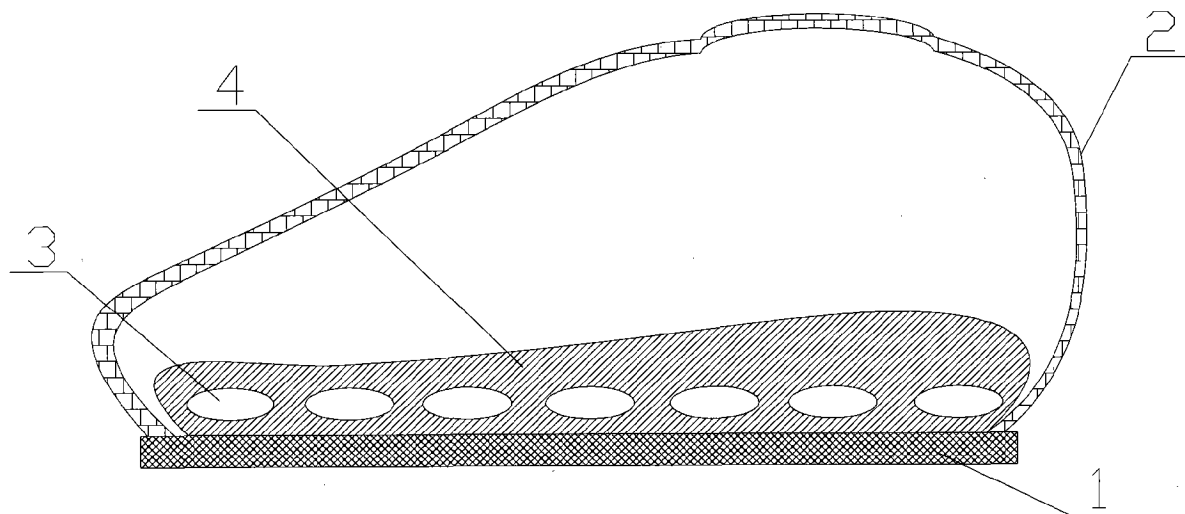


图 1