

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号
特許第5873723号
(P5873723)

(45) 発行日 平成28年3月1日(2016.3.1)

(24) 登録日 平成28年1月22日(2016.1.22)

(51) Int.Cl.

A 6 1 H 7/00 (2006.01)

F I

A 6 1 H 7/00 3 2 2 Z

A 6 1 H 7/00 3 2 2 B

請求項の数 2 (全 32 頁)

(21) 出願番号	特願2012-5526 (P2012-5526)	(73) 特許権者	000005810
(22) 出願日	平成24年1月13日 (2012.1.13)		日立マクセル株式会社
(65) 公開番号	特開2013-144025 (P2013-144025A)		大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号
(43) 公開日	平成25年7月25日 (2013.7.25)	(74) 代理人	100099634
審査請求日	平成26年11月19日 (2014.11.19)		弁理士 平井 安雄
		(72) 発明者	桑畑 広幸
			福岡県田川郡福智町伊方4680番地 九州日立マクセル株式会社内
		(72) 発明者	島田 和明
			福岡県田川郡福智町伊方4680番地 九州日立マクセル株式会社内
		審査官	増山 慎也
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 マッサージ機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

座面前部の位置を上下動させる座部調整手段を有す座部と背もたれ部とを備えると共に、座部の前側に脚を支持する脚支持部が配設されるマッサージ機において、

前記脚支持部が、前記座部前端部に傾動可能に取付けられる基礎部と、当該基礎部に対し脚長手方向へ移動可能として配設され、脚に接する脚受部と、当該脚受部と一体に配設され、脚の少なくともふくらはぎ部分を側方から挟持して脚の膝から下部分を脚受部上に保持固定する挟持手段と、基礎部に対し脚受部を移動させて脚長手方向位置を調整する第1アクチュエータとを備えてなり、

前記脚支持部を傾動させ、脚支持部の座部に対する傾斜角度を変化させる第2アクチュエータを備え、

脚裏部へのストレッチ施療として、前記挟持手段で被施療者の脚の膝から下部分を脚受部上に保持固定した状態で、前記第2アクチュエータで脚支持部を上向きに傾動させるのと同調して、前記座部の座面前部の位置を上げると共に、前記第1アクチュエータで脚受部を脚ごと座部から離れる向きに移動させることを

特徴とするマッサージ機。

【請求項2】

座部と背もたれ部とを備えると共に、座部の前側に脚を支持する脚支持部が配設されるマッサージ機において、

前記脚支持部が、前記座部前端部に傾動可能に取付けられる基礎部と、当該基礎部に対

し脚長手方向へ移動可能として配設され、脚に接する脚受部と、当該脚受部と一体に配設され、脚の少なくともふくらはぎ部分を側方から挟持して脚の膝から下部分を脚受部上に保持固定する挟持手段と、基礎部に対し脚受部を移動させて脚長手方向位置を調整する第1アクチュエータとを備えてなり、

前記脚支持部を傾動させ、脚支持部の座部に対する傾斜角度を変化させる第2アクチュエータを備え、前記第2アクチュエータが、座部の下側に配設され、所定範囲内で伸縮して長さを変化させる機構を有してなり、一端部の位置を固定状態とされる一方、他端部が脚支持部の裏面側に当接可能とされ、伸縮による他端部の位置変化に伴って、脚支持部を傾動させ、前記座部が、前端部における脚支持部の基礎部の傾動中心位置を上下動させる位置調整手段を有してなり、

10

脚裏部へのストレッチ施療として、前記挟持手段で被施療者の脚の膝から下部分を脚受部上に保持固定した状態で、前記第2アクチュエータで脚支持部を上向きに傾動させると共に、前記第1アクチュエータで脚受部を脚ごと座部から離れる向きに移動させる際に、前記基礎部の傾動中心位置を上げることを

特徴とするマッサージ機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、被施療者の着座する座部に対し傾動する脚支持部を用いて、被施療者の脚のストレッチ施療を実行できるマッサージ機に関する。

20

【背景技術】

【0002】

被施療者の身体を支持しつつマッサージ動作を実行する椅子型のマッサージ機は、通常、その背もたれ部に設けられる施療子としての揉み玉で、背もたれ部にもたれた被施療者に対し揉みや叩き等の施療を行う仕組みを有しているが、この他、被施療者の脚部分に対しても所定の施療が行えるよう、施療機構を内蔵した脚支持部（オットマン）を設けたものがある。

【0003】

さらに、脚に対しては、揉みやローリング等の施療の他に、脚の筋肉のストレッチを行うものも実用に供されていた。このような脚のストレッチ施療を実行可能とするマッサージ機の一例として、特開2008-92973号公報に開示されるものがある。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2008-92973号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

従来の脚のストレッチ施療を行えるマッサージ機は、前記特許文献に示される構成とされており、脚を支える脚受部を上方へ傾動させて脚のストレッチを行う仕組みとなっているが、このストレッチの際、脚受部や座部に設けられたエアセルで脚が拘束されていることから、脚受部の傾動に伴って脚受部前面部分と座部上面との距離が縮まり、座部及び脚受部上の脚の長さに対応しない状態となって、脚受部に拘束された関係で長手方向に動けない脚で、その膝部分が、余長を調整するように座部先端部及び脚受部上端部から離れて脚の伸張が阻害される状態となったり、膝に無理な力が加わり膝への影響が懸念される状態となるという課題を有していた。

40

【0006】

また、ストレッチは適切な強度で実行すべきであり、前記特許文献に記載のものなど従来のマッサージ機におけるストレッチの施療実行にあたっては、脚受部の傾動角度やこれを駆動するアクチュエータの作動変位の目標値を適宜設定して所定の施療強度を得られる

50

ようにするのが一般的であった。しかし、マッサージ機を用いる人の体格は様々であり、ストレッチの施療強度を脚受部の傾動角度やアクチュエータの作動変位の大小に対応付ける場合に、脚の長い人に合わせて強度を設定すると、脚の短い人にとっては、ある施療強度に対応する脚受部の傾動角度が過大となるにもかかわらず、長い人と同じ強度設定が適用されて脚受部が大きく傾動することで、脚の短い人にはストレッチの施療強度が強すぎて脚を痛めるおそれが生じる。

【0007】

逆に、脚の短い人に合わせて強度を設定すると、脚の長い人にとっては、ある施療強度に対応する脚受部の傾動角度が過小となるにもかかわらず、短い人と同じ強度設定が適用されて脚受部が小さめに傾動することで、脚の長い人にはストレッチの施療が実現する程度の傾動角度が得られず、ストレッチが有効に行えないなど、施療強度を傾動角度などの施療実行部分の変位の大きさに対応付ける方法では、被施療者の脚の長さ、すなわち体格の違いによる実際の施療強度の発現状態の変化に対応できない、という課題を有していた。

10

【0008】

本発明は前記課題を解消するためになされたもので、脚を支える脚支持部を適切に作動させて、脚に余計な負担をかけることなく適切にストレッチの施療を実行でき、より効果的な脚のストレッチを実現可能にするマッサージ機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

20

本発明に係るマッサージ機は、座部と背もたれ部とを備えると共に、座部の前側に脚を支持する脚支持部が配設されるマッサージ機において、前記脚支持部が、前記座部前端部に傾動可能に取付けられる基礎部と、当該基礎部に対し脚長手方向へ移動可能として配設され、脚に接する脚受部と、当該脚受部と一体に配設され、脚の少なくともふくらはぎ部分を側方から挟持して脚の膝から下部分を脚受部上に保持固定する挟持手段と、基礎部に対し脚受部を移動させて脚長手方向位置を調整する第1アクチュエータとを備えてなり、前記脚支持部を傾動させ、脚支持部の座部に対する傾斜角度を変化させる第2アクチュエータを備え、脚裏部へのストレッチ施療として、前記挟持手段で被施療者の脚の膝から下部分を脚受部上に保持固定した状態で、前記第2アクチュエータで脚支持部を上向きに傾動させると共に、前記第1アクチュエータで脚受部を脚ごと座部から離れる向きに移動させるものである。

30

【0010】

このように本発明によれば、座部の前側で傾動可能に脚を支える脚支持部を、座部に取付けられる基礎部とこれに対し移動可能な脚受部との組合せ構造とし、脚へのストレッチの施療として脚支持部を上向きに傾動させる際に、あらかじめ脚を挟持して脚受部上に保持固定した状態とし、さらに傾動の進行に合わせて、脚受部を座部から離れる向きに少しずつ移動させることにより、脚を脚支持部や座部から浮かせることなく脚支持部を上向きに傾動させて脚を伸して、膝に負担をかけることなく、効率よく脚裏部分の筋肉のストレッチを行う状態が得られることとなり、脚のストレッチに係る施療をスムーズ且つ適切に実行でき、被施療者に対し優れた施療効果を付与できる。

40

【0011】

また、本発明に係るマッサージ機は必要に応じて、前記座部が、座面前部の位置を上下動させる座部調整手段を有してなり、前記脚裏部へのストレッチ施療の際に、前記第2アクチュエータで脚支持部を上向きに傾動させるのと同調して、前記座部の座面前部の位置を上げるものである。

【0012】

このように本発明によれば、脚へのストレッチの施療の際に、座部の座面前部を上に向けて、脚支持部の傾動に伴って伸びる脚の大腿部下側部分を押圧し、脚の膝部を上側に移動させることにより、脚に対し脚裏の筋肉が伸びる側への負荷がさらに加わる状態となり、脚裏へのストレッチ効果がさらに向上する。

50

【0013】

また、本発明に係るマッサージ機は必要に応じて、前記脚支持部の挟持手段が、脚を挟む配置として複数配設されて、所定の給排気手段による空気の給排で膨縮動作するエアセルであり、脚に対するマッサージ用の施療機構を兼ね、前記脚裏部へのストレッチ施療の際に、前記挟持手段が空気供給で膨張して被施療者の脚のふくらはぎ部分を両側方から押圧して挟持するものである。

【0014】

このように本発明によれば、脚に対するマッサージを行う施療機構としてのエアセルが、脚支持部の上向きの傾動によるストレッチ施療時の挟持手段として用いられ、脚支持部が上向きに傾動する間、エアセルが膨張して脚を挟持し、脚を脚受部に保持固定することにより、エアセルを脚のマッサージとストレッチの両方の施療に有効に活用でき、脚支持部の傾動の際に脚を脚受部上に確実に保持固定してストレッチ効果を高める状態を確保しつつ、脚支持部の機構の簡略化が図れる。

10

【0015】

また、本発明に係るマッサージ機は必要に応じて、前記第2アクチュエータが、座部の下側に配設され、所定範囲内で伸縮して長さを変化させる機構を有してなり、一端部の位置を固定状態とされる一方、他端部が脚支持部の裏面側に当接可能とされ、伸縮による他端部の位置変化に伴って、脚支持部を傾動させ、前記座部が、前端部における脚支持部の基礎部の傾動中心位置を上下動させる位置調整手段を有してなり、前記脚裏部へのストレッチ施療の際に、前記基礎部の傾動中心位置を上げるものである。

20

【0016】

このように本発明によれば、脚へのストレッチの施療の際に、座部前端の脚支持部の傾動中心位置を上へ上げて、脚支持部の傾動に伴って脚の膝裏側部分が伸びた状態で、さらに脚支持部に支えられる脚の膝部を上側に移動させることにより、脚に対し脚裏の筋肉が伸びる側への負荷がさらに加わる状態となり、脚裏へのストレッチ効果がさらに向上する。

【0017】

また、本発明に係るマッサージ機は必要に応じて、少なくとも前記脚裏部へのストレッチ施療時における各アクチュエータの作動状態を制御する制御部を備え、前記制御部が、前記脚裏部へのストレッチ施療での脚受部の座部から離れる向きへの移動における、ストレッチの施療強度に応じて前記第1アクチュエータに加わる負荷の変化と、第1アクチュエータの作動に係る所定の物理量の変化との対応関係をあらかじめ把握して、所定の目安とする施療強度に対応する前記物理量の目安値を設定し、第1アクチュエータの作動の間、前記物理量を取得して、物理量が前記目安値に達した場合に、所定の制御対象への制御指令を送出する制御を実行するものである。

30

【0018】

このように本発明によれば、ストレッチ施療における施療強度と脚受部を移動させる第1アクチュエータの負荷とは対応しており、また、第1アクチュエータの負荷の変化に応じて変わる、第1アクチュエータの作動に係る所定の物理量が存在することを利用して、制御部で、この物理量の変化と施療強度とを対応付け、あらかじめ設定されたストレッチの施療強度に一对一に対応する、第1アクチュエータの作動に係る前記物理量の値を、目安値として設定し、第1アクチュエータを作動させる間、制御部で取得した物理量を目安値と比較照合して、取得した物理量が目安値に達したら、一又は複数の制御対象、例えば、前記第1アクチュエータや第2アクチュエータ、挟持手段、座部調整手段、位置調整手段等、に対し、制御部から所定の制御指令を送出するようにすることにより、第1アクチュエータの負荷変化に応じた物理量の変化から制御部が施療強度を把握し、施療強度の変化に対応しつつ制御対象を適切に制御でき、例えば制御対象を第2アクチュエータとする場合、設定された施療強度に適合するように第2アクチュエータを作動させて脚支持部を傾動させることができるなど、常に適切な施療強度でのストレッチが可能となる。

40

【0019】

50

また、本発明に係るマッサージ機は必要に応じて、少なくとも前記脚裏部へのストレッチ施療時における各アクチュエータの作動状態を制御する制御部を備え、前記制御部が、前記脚裏部へのストレッチ施療での脚受部の座部から離れる向きへの移動における、ストレッチの施療強度に応じて第1アクチュエータに加わる負荷の変化と、第1アクチュエータの作動に係る所定の物理量の変化との対応関係をあらかじめ把握して、所定の目安とする施療強度に対応する前記物理量の目安値を設定し、第1アクチュエータの作動の間、前記物理量を取得して、物理量が前記目安値に達した際に、第1アクチュエータ及び／又は脚受部の状態に応じた制御指令を、所定の制御対象へ送出する制御を実行するものである。

【0020】

このように本発明によれば、ストレッチ施療における施療強度と脚受部を移動させる第1アクチュエータの負荷とは対応しており、また、第1アクチュエータの負荷の変化に応じて変わる、第1アクチュエータの作動に係る所定の物理量が存在することを利用して、制御部で、この物理量の変化と施療強度とを対応付け、あらかじめ設定されたストレッチの施療強度に一对一に対応する、第1アクチュエータの作動に係る前記物理量の値を、目安値として設定し、第1アクチュエータを作動させる間、制御部で取得した物理量を目安値と比較照合して、取得した物理量が目安値に達したら、一又は複数の制御対象、例えば、前記第1アクチュエータや第2アクチュエータ、挟持手段、座部調整手段、位置調整手段等、に対し、物理量が目安値に達した際の第1アクチュエータ及び／又は脚受部の状態に応じた制御指令を制御部から送出するようにすることにより、第1アクチュエータの負荷変化に応じた物理量の変化から制御部が施療強度を把握し、施療強度の変化に対応しつつ、第1アクチュエータの作動に伴い変化した第1アクチュエータ及び／又は脚受部の状態に応じて制御対象を適切に制御でき、例えば、制御対象を第2アクチュエータとする場合、物理量が目安値に達した際の第1アクチュエータにおける伸長状態など、に適合するように第2アクチュエータを作動させて脚支持部を傾動させることができるなど、常に各機構が適切に連係して無理のないスムーズなストレッチ施療を実行できる。

【0021】

また、本発明に係るマッサージ機は必要に応じて、前記制御部が、前記脚裏部へのストレッチ施療における施療強度を、使用者に選択可能としてあらかじめ複数段階設定し、複数段階の強度の中から使用者に選択されたものを目安とする施療強度として、当該強度に対応する前記物理量の目安値を設定するものである。

【0022】

このように本発明によれば、ストレッチの施療強度が複数段階設定され、使用者に選択された施療強度に対応する物理量を目安値として、目安値に応じた制御指令送出が実行されることにより、施療強度の選択調整を経て所望の強度とされたストレッチの施療を、その施療強度に対応する目安の物理量に、随時取得している物理量が達した際に、制御部が例えば制御対象の動作を停止させるなどの、強度に対応する作動制御で実現することとなり、被施療者の状態により適切に対応したストレッチの施療が行える。

【0023】

また、本発明に係るマッサージ機は必要に応じて、前記制御部が、前記脚裏部へのストレッチ施療における施療強度を、使用者に選択可能としてあらかじめ複数段階設定し、当該複数段階の強度の中から使用者に選択されたものを目標施療強度として、前記物理量が前記目安値に達したら、前記制御対象が前記目標施療強度を実現するように作動する制御指令を送出するものである。

【0024】

このように本発明によれば、ストレッチの施療強度が複数段階設定され、使用者に選択された施療強度を目標として制御対象の作動を制御するための制御指令が送出されることにより、施療強度の選択調整を経て所望の強度とされたストレッチの施療を、制御部が、随時取得している物理量が目安値に達した場合に、例えば目標施療強度が得られるタイミングで制御対象の作動を停止させるなどの制御を実行できることとなり、被施療者の意向

により適切に対応したストレッチの施療が行える。

【0025】

また、本発明に係るマッサージ機は必要に応じて、前記第1アクチュエータの可動部分の変位又は脚受部の移動変位を、所定の単位量の変位ごとの信号出力に基づき検出する変位検出手段を備え、前記制御部が、前記変位検出手段より得られる、変位と当該変位の検出間隔とからの速度算出により取得した、第1アクチュエータの作動速度、又は脚受部の移動の速度を、前記物理量として取扱うものである。

【0026】

このように本発明によれば、第1アクチュエータの作動に係る物理量として、第1アクチュエータの作動速度又は脚受部の移動の速度を制御部で取得すると共に、こうした速度を、第1アクチュエータ又は脚受部の変位検出手段における変位の検出間隔を用いて求めるようにすることで、第1アクチュエータの負荷変化に対応した変化を示す速度の値を、専用のセンサを用いることなく適切に取得でき、物理量が目安値に達した時点での制御指令送出に係るシステム構成を簡略化できると共に、例えば、設定された施療強度に対応する目安の速度に、随時取得している速度が低下した際に、第2アクチュエータを停止させるといった制御指令送出を実行するようにして、いずれの被施療者に対しても適切にストレッチを実行できる。

【図面の簡単な説明】

【0027】

【図1】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機の斜視図である。

【図2】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機のブロック図である。

【図3】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機におけるメカユニットの背面図である。

【図4】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機におけるメカユニットの左側面図である。

【図5】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機における脚支持部の傾動開始状態説明図である。

【図6】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機における脚支持部の傾動状態説明図である。

【図7】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機における脚裏ストレッチ施療のフローチャートである。

【図8】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機における脚の大腿部及びふくらはぎ部の挟持状態説明図である。

【図9】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療時における各機構部分の作動タイミング説明図である。

【図10】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療時における各機構部分の他の作動タイミングの第一例及び第二例の説明図である。

【図11】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療時における各機構部分の他の作動タイミングの第三例及び第四例の説明図である。

【図12】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療時における各機構部分の他の作動タイミングの第五例及び第六例の説明図である。

【図13】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機における座部先端部エアセル膨張状態説明図である。

【図14】本発明の第1の実施形態に係るマッサージ機における脚支持部傾動中心軸の移動状態説明図である。

【図15】本発明の第2の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療時における各機構部分の作動タイミング説明図である。

【図16】本発明の第2の実施形態に係るマッサージ機における脚裏ストレッチ施療のフローチャートである。

【図17】本発明の第3の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療時における

10

20

30

40

50

各機構部分の作動タイミング説明図である。

【図１８】本発明の第４の実施形態に係るマッサージ機におけるエンコーダからのパルス信号出力例説明図である。

【図１９】本発明の第４の実施形態に係るマッサージ機における揉み施療時の強度調整のフローチャートである。

【図２０】本発明の第４の実施形態に係るマッサージ機における揉み施療時の揉み玉及び駆動機構部の傾動状態説明図である。

【図２１】本発明の第５の実施形態に係るマッサージ機における揉み施療時の強度調整のフローチャートである。

【発明を実施するための形態】

10

【００２８】

（本発明の第１の実施形態）

以下、本発明の第１の実施形態に係るマッサージ機を前記図１ないし図９に基づいて説明する。

前記各図において本実施形態に係るマッサージ機１は、着座した被施療者を支える椅子状のものであり、詳細には、床面上に載置されて椅子全体を安定的に支持する基台部１１と、この基台部１１の上方で被施療者の臀部を支える座部１２と、この座部１２の後側で被施療者の背中を支える背もたれ部１３と、座部１２の左右両側で被施療者の肘や前腕部を支える肘掛部１４と、座部１２の前側で被施療者の脚を支える脚支持部１５と、マッサージ動作に係る各種操作入力を受付けるリモコン３０と、搭載されている複数の施療機構によるマッサージ動作を操作入力や記録情報等の内容に基づいて制御する制御部４０とを備える構成である。

20

【００２９】

前記基台部１１は、椅子各部をなす前記座部１２、背もたれ部１３、肘掛部１４、及び脚支持部１５を一体に取付けられてこれらを支持するものである。また、前記座部１２は、基台部１１に対し座面の傾斜角度を調整可能として取付けられ、座面にて被施療者の臀部や太腿部を支えつつ内蔵の施療機構でマッサージを実行するものであり、この施療機構として、空気の給排で動作する臀部用エアセル７１、及び太腿部用エアセル７２を備える構成である。これらエアセルを空気の給排で動作させるエアポンプ７０が座部１２下側のスペースに配設される。

30

臀部用エアセル７１や太腿用エアセル７２は、マッサージ機能以外にも、被施療者の体を昇降させたりクッションとしての機能を有する。

【００３０】

前記背もたれ部１３は、人の背中形状に合せた表面形状とされて前記基台部１１及び座部１２に対し傾斜角度を調整可能として配設され、その内部に、マッサージを実行する施療機構を備える構成である。

【００３１】

背もたれ部１３内部には、施療子としての左右一対の揉み玉５１とこれを動作させる駆動機構部６０が一体となったメカユニット５０と、このメカユニット５０を背もたれ部１３上下方向に移動可能とし且つ他方向への動きは拘束して支持する左右一対のガイドレール２０と、前記エアポンプ７０による空気の給排で動作する背中用エアセル７３及び腰用エアセル７４と、この背もたれ部１３の形状を内部から維持する枠状のフレーム１７とがそれぞれ配設される構成である。このうちメカユニット５０、背中用エアセル７３、及び腰用エアセル７４が、それぞれマッサージを実行する施療機構をなす。

40

【００３２】

なお、この背もたれ部１３の左右両側部には、被施療者に面する内面側にエアセル等の施療機構を設けた一対の側壁部を突出配設して、被施療者の上腕部等に対して側方からマッサージを行えるようにすることもできる。

【００３３】

前記メカユニット５０は、揉み、叩き等の刺激を被施療者に与える施療子としての左右

50

一对の揉み玉 5 1 と、これら揉み玉 5 1 をそれぞれ突出状態で支持する左右一对の揉み玉支持アーム 5 2 と、この揉み玉支持アーム 5 2 を介して揉み玉 5 1 を揉み、叩き等のマッサージ動作に対応させて駆動する駆動機構部 6 0 と、背もたれ部上下方向に直交する軸線を中心として駆動機構部 6 0 を傾動可能に支持するベース部 5 4 とを備える構成である。

【0034】

前記駆動機構部 6 0 は、ベース部 5 4 に対し傾動可能に支持されるハウジング 6 1 と、このハウジング 6 1 と一体に配設され、制御部 4 0 の制御に基づいて揉み玉 5 1 に揉み動作を行わせるための駆動力を発生させる揉みモータ 6 2 と、同じくハウジング 6 1 と一体に配設され、制御部 4 0 の制御に基づいて揉み玉 5 1 に叩き動作を行わせるための駆動力を発生させる叩きモータ 6 4 と、ハウジング 6 1 に内蔵されて、各モータからの運動を揉み玉支持アーム 5 2 を介して揉み玉 5 1 に伝達する揉み機構及び叩き機構（図示を省略）とを備える、公知のマッサージ機に用いられるものと同様の機構である。

10

【0035】

なお、揉み機構は、制御部 4 0 の制御に基づく揉みモータ 6 2 の回転で揉み玉支持アーム 5 2 が連続して揺れる状態を生じさせるものである。揉み玉支持アーム 5 2 の一端部に取付けられた揉み玉 5 1 は、揉み玉支持アーム 5 2 の動きに伴い、連続する軌跡を描きつつ上下、左右及び前後に揺動することで、施療動作としての揉みを実現できる。

【0036】

揉みの施療における揉み玉 5 1 の被施療者に対する揺動の変位は、揉みモータ 6 2 の回転作動の結果としての、揉み機構で揉み玉支持アーム 5 2 を駆動する駆動軸（図示を省略）の回転角度変位と一対一に対応していることから、駆動軸の変位を変位検出手段としてのエンコーダ 6 5 を用いて検出することで、制御部 4 0 で揉み玉 5 1 の揺動状態、すなわち揉み玉位置の変化を把握することができる。エンコーダ 6 5 は、駆動機構部 6 0 のハウジング 6 1 に内蔵され、ハウジング 6 1 側に固定されるセンサ部と、駆動軸側に取付けられるスケール部との組合せで構成され、センサ部で駆動軸と共に動くスケール部の回転角度変位を検出する、公知のロータリーエンコーダであり、制御部 4 0 に駆動軸の変位に係る信号を出力する。

20

【0037】

また、叩き機構は、叩きモータ 6 4 の回転により、揉み玉支持アーム 5 2 を所定位置を中心に揺動させるものであり、揉み玉支持アーム 5 2 の揺動でアーム一端部の揉み玉 5 1 も前後に揺動（往復動）して、施療動作としての叩きを実現する仕組みである。

30

【0038】

前記ベース部 5 4 は、駆動機構部 6 0 を傾動可能に支持するものであり、この他、制御部 4 0 の制御に基づいて、メカユニット昇降用の駆動力を発生させる昇降モータ 5 7 と、駆動機構部 6 0 を傾動させる駆動力を発生させる進退モータ 5 8 とを備える構成である。

【0039】

進退モータ 5 8 は、制御部 4 0 の制御に基づいて、連動する小歯車 5 8 a を回転させ、この小歯車 5 8 a と噛合している駆動機構部 6 0 側の歯部 6 7 を移動させることで、駆動機構部 6 0 をベース部 5 4 に対し傾動させ、これにより揉み玉 5 1 位置を被施療者に対し進退させ、揉み玉 5 1 の被施療者側への突出量を調整するものである。

40

【0040】

揉み玉 5 1 の被施療者に対する進退方向の変位は、進退モータ 5 8 の回転作動の結果としての駆動機構部 6 0 の傾動に係る角度変位と一対一に対応していることから、駆動機構部 6 0 の角度変位を変位検出手段としてのエンコーダ 5 5 を用いて検出することで、制御部 4 0 で駆動機構部 6 0 の傾動状態変化と共に、揉み玉 5 1 の進退状態、すなわち突出量の変化を把握することができる。エンコーダ 5 5 は、ベース部 5 4 に固定されるセンサ部 5 5 a と、駆動機構部 6 0 のハウジング 6 1 に取付けられるスケール部 5 5 b との組合せで構成され、センサ部 5 5 a で駆動機構部 6 0 と共に動くスケール部 5 5 b の傾動変位を検出する、一種のロータリーエンコーダであり、制御部 4 0 に駆動機構部 6 0 の角度変位に係る信号を出力する。

50

【0041】

メカユニット50は、ベース部54の側端部を一对のガイドレール20にそれぞれ上下走行可能に支持されることで、ガイドレール20に挟まれる配置状態となり、メカユニット50全体としてガイドレール20に沿って移動可能とされる構成である。そして、制御部40による制御に基づき、昇降モータ57が作動してベース部54がガイドフレーム20を走行する状態となることで、ベース部54を含むメカユニット50全体が、ガイドフレーム20に沿って背もたれ部13の上下に移動することとなり、背もたれ部13における揉み玉51の位置（揉み玉による施療対象部位）を上下に変えられる仕組みである。

【0042】

そして、メカユニット50は、設定されたマッサージの内容に応じて、制御部40による制御で、上記のように背もたれ部13の上下に移動し、揉み玉51の上下位置を調整されると共に、進退モータ58の作動による揉み玉51と駆動機構部60の傾動で、揉み玉51の被施療者側への突出量を調整されて、揉み玉51をマッサージの対象箇所に位置させる。揉み玉51の移動後、又はこうした揉み玉51の移動と並行して、制御部40が、マッサージの種類に応じて、メカユニット50における駆動機構部60の揉み、叩き用のモータを作動させ、揉み玉51に設定された揉みや叩き等のマッサージに対応した動きを行わせることとなる。

10

【0043】

前記肘掛部14は、座部12の両側に位置して基台部11と一体に連結し、背もたれ部13がリクライニング角度を変化させたり、座部12が傾動しても、被施療者の前腕を安定的に支持するよう形成される構成である。この肘掛部14にも、前記エアポンプ70による空気の給排で動作するエアセルを配設して、被施療者の前腕部に対しマッサージを行える構成としてかまわない。

20

【0044】

前記脚支持部15は、座部12の前側に位置し、座部12前端付近を中心として傾動可能に配設され、座部下側の第2アクチュエータ19により傾斜角度を調整されるものである。詳細には、脚支持部15は、座部12に対し傾動可能に取付けられる基礎部15aと、この基礎部15aの表面側部分に脚長手方向へ移動可能として配設され、脚に接する脚受部15bと、この脚受部15bに内蔵され、前記エアポンプ70による空気の給排で膨縮動作する施療機構としての脚用エアセル75、76、77、78とを備える構成である。

30

【0045】

前記第2アクチュエータ19は、固定部分に対し可動部分を直線移動させることで全体として所定範囲内で伸縮して長さを変化させる機構を有してなり、座部12の下側で一端部の位置を固定状態とされる一方、他端部が脚支持部15の裏面側に当接可能とされ、伸縮による他端部の位置変化に伴って、脚支持部を傾動させる構成である。この第2アクチュエータ19と一体に、第2アクチュエータ19の可動部分の変位、すなわち伸縮の変位を、所定の単位量の変位ごとの信号出力に基づき検出する、変位検出手段としてのリニアエンコーダが配設される。

【0046】

40

脚支持部15は、この第2アクチュエータ19の伸縮動作により、脚支持部15の裏面側に当接する第2アクチュエータ19他端部の位置が変ることで、座部12前端的軸部を中心として傾動し、傾斜角度を変化させる仕組みである。脚支持部15の傾動に係る変位は、第2アクチュエータ19の伸縮による変位と一対一に対応していることから、第2アクチュエータ19の伸縮変位を変位検出手段としてのリニアエンコーダを用いて検出することで、制御部40で第2アクチュエータ19の伸縮状態変化と共に、脚支持部15の傾動状態変化を把握することができる。なお、脚支持部15の傾動状態の把握にあたっては、直接脚支持部の傾斜角度変化をロータリーエンコーダ等の変位検出手段で取得するようにしてもよい。

【0047】

50

脚支持部 15 のうち脚受部 15 b は、被施療者の脚が入る凹状部分を生じさせた略半円筒状に形成され、座部 12 前端に取付けられた基礎部 15 a に対し脚長手方向へ移動可能に配設される構成である。脚受部 15 b の凹状部分を挟んで対向する側面部には、脚用エアセル 75、76、77、78 が、膨張状態で左右の脚のふくらはぎ部分をそれぞれ押圧してマッサージが行えるように、左右各々で対をなす配置として内蔵される。

この脚支持部 15 には、脚用エアセル 75、76、77、78 の他、脚長手方向に移動しつつ脚を押圧するローラ等の他の施療機構を配設するようにしてもかまわない。

【0048】

被施療者は、左右の脚受部 15 b にそれぞれ左右の脚をふくらはぎ部分を中心として支持させることとなる。この支持状態で、左右でそれぞれ脚を挟んで対向する脚用エアセル 75、76、77、78 をいずれも膨張させると、脚のふくらはぎ部分を両側から押圧して挟持できる仕組みである。

10

【0049】

すなわち、脚用エアセル 75、76、77、78 は、空気吸排に伴う膨張、収縮による直接的なマッサージ機能以外に、膨張状態の押圧力を利用して脚を挟持し、脚の想定外の動きを抑える挟持手段としての機能も有する。なお、この挟持する手段としては、エアセルの膨張収縮を利用するもの以外に、押圧片を機械的に移動させて脚を挟持する機構等でもよく、エアセルに限られるものではない。

【0050】

また、必ずしも脚の両側から脚用エアセル等の挟持手段を動作させて脚を挟持する構成に限らず、脚を挟んで対向する脚受部の左右の側壁のいずれか片側のみから脚を押圧し、脚受部の反対側の側壁に脚を押付けるようにして、挟持状態を得る構成としてもかまわない。

20

【0051】

脚用エアセル 75、76、77、78 が被施療者の脚を挟持して、脚を脚支持部 15 上に保持固定した状態で、第 2 アクチュエータ 19 を伸長させ、脚支持部 15 を上向きに傾動させ、且つ脚支持部 15 における脚受部 15 b を基礎部 15 a に対し座部 12 から遠ざかる方向に移動させると、脚の裏側部分（脚裏部）に伸びによるストレッチ効果を付与できる。すなわち、脚支持部 15 を用いて脚裏部へのストレッチ施療を行える仕組みとなっている。なお、ここでの脚裏部とは、太腿部の裏、ふくらはぎ、及び膝裏の、一部又は全部を指すものである。

30

【0052】

脚支持部 15 の傾動においては、脚を脚支持部 15 上に拘束するだけでなく、脚を挟持している脚受部 15 b の位置を座部から離れる向きに適宜移動させて、脚の曲り具合を調整することで、膝に無理な力が加わらないようにして膝の浮上りを確実に抑え、脚のストレッチ効果をより高めることができる。

【0053】

こうして、脚支持部 15 の脚受部 15 b を基礎部 15 a に対し脚長手方向に移動させる機構としては、脚受部 15 b の基礎部 15 a に対する位置変化を検出するための変位検出手段 15 d と共に、所定の第 1 アクチュエータ 18 を用い、この第 1 アクチュエータ 18 の作動を制御部 40 で制御するようにしている。この第 1 アクチュエータ 18 は、モータや流体圧シリンダなどの公知のアクチュエータであり、また、変位検出手段 15 d は、公知のリニアエンコーダ等であり、詳細な説明を省略する。

40

【0054】

なお、脚受部 15 b の移動状態の把握にあたっては、直接脚受部 15 b の位置変化を変位検出手段 15 d で取得する他に、第 1 アクチュエータ 18 の可動部分の変位を、これと一体に設けられたリニアエンコーダ等の変位検出手段で取得するようにしてもよい。すなわち、脚受部 15 b は、第 1 アクチュエータ 18 の動作により、脚支持部 15 の基礎部 15 a に対して位置を変えることで、座部 12 に対して移動する仕組みであり、脚受部 15 b の移動に係る変位は、第 1 アクチュエータ 18 の作動による伸縮変位と一対一に対応す

50

ることから、第1アクチュエータ18の変位を一体の変位検出手段を用いて検出することで、制御部40で第1アクチュエータ18の状態変化と共に、脚受部15bの移動状態変化を把握することができる。

【0055】

さらに、脚支持部15の上向きの傾動に際し、脚の大腿部を挟持する別の挟持用エアセル79を、座部12の両側に配設する構成とすることもできる（図8参照）。この場合、座部12の両側の挟持用エアセル79で大腿部を挟持した状態で、脚支持部15が上向きに傾動して、脚を伸張させることで、エアセル79で挟持された太腿部が座部12の座面から浮き上がるのを抑えられ、脚支持部15の傾動による脚の伸張がより一層促されて、脚裏のストレッチ効果をより高めることができる。

10

一方、脚用エアセルによる脚の挟持状態で、脚支持部15を上方から下方に傾動させることもでき、この場合には、脚の他部分に対して伸びによるストレッチ効果を与えられる。

【0056】

前記リモコン30は、マッサージ機に対する各種操作入力を受付ける多数のスイッチや表示部を備え、マッサージ機1の側部におけるスタンド16に着脱自在に設置され、マッサージに係る操作入力を制御部40に送信するものである。なお、リモコン30のスイッチや表示部の位置を被施療者にとって最適位置とするために、スタンド16の位置は調整可能となっている。

【0057】

20

前記制御部40は、あらかじめ被施療者の身体各部位置検出を実行して得られた検出結果に基づいて、施療機構やマッサージ機の他の各可動部分を被施療者に対応した状態に調整すると共に、施療機構や他の各可動部分に対し、リモコン操作やあらかじめ記録設定された施療内容、また前記検出結果の情報に基づいて、適切な施療の実行のための制御を行うものである。

【0058】

この制御部40は、そのハードウェア構成として、CPUやメモリ、入出力インターフェース等を備えるコンピュータとなっており、メモリ等に格納されるプログラムにより、コンピュータを制御部40として動作させる仕組みである。この制御部40をなすコンピュータは、CPUやメモリ、ROM等を一体的に形成されたマイクロコンピュータとして

30

【0059】

この制御部40をなすコンピュータのユニットは、座部12直下等のマッサージ機1内部の所定のスペースに配設され、リモコン30と通信可能な状態とされると共に、メカユニット50の各種モータや、背もたれ部13や脚支持部15を傾動させるアクチュエータ、エアポンプ70や給排気制御機構とそれぞれ電氣的に接続され、被施療者の身体各部位置検出の際にはあらかじめ設定された位置検出用プログラムに基づく制御信号出力により、また、マッサージ実行の際には設定されたマッサージのデータに基づく制御信号出力により、これらの駆動機構の作動を制御する。

【0060】

40

加えて、制御部40は、メカユニット50や各アクチュエータの変位量を出力するエンコーダ等の信号出力手段とも電氣的に接続されており、メカユニット50の状態や、背もたれ部13及び脚支持部15の傾斜等の状態を把握しつつ、モータやアクチュエータ等の駆動手段の作動制御を行うこととなる。

【0061】

特に、脚支持部15を傾動させる第2アクチュエータ19の作動状態を制御するにあたり、制御部40は、脚裏部へのストレッチ施療としての脚支持部15の傾動と同期した脚受部15bの移動における、ストレッチの施療強度に応じて第1アクチュエータ18に加わる負荷の変化と、この第1アクチュエータ18の作動に係る所定の物理量の変化との対応関係をあらかじめ把握して、制御の目安とする施療強度に対応する前記物理量の目安値

50

を設定し、第1アクチュエータ18の作動の間、前記物理量を取得して、物理量が前記目安値に達した際に、第2アクチュエータ19に作動停止や作動速度低下等の、これまでの作動状態からの変化を起させる制御指令の送出を実行するようにしている。

【0062】

ストレッチ施療において、脚受部15bの移動に基づく施療強度の増大変化と脚受部15bの移動速度の減少変化とが、強い関係性を示すことがわかっており、この脚受部15bの移動の状況を各施療機構の作動制御に利用すれば、所定時点の実際の施療強度を的確に把握して、施療強度に応じた作動制御が見込めることとなる。このため、脚受部15bの移動を生じさせる機構として第1アクチュエータ18を用い、この第1アクチュエータ18の作動に係る物理量を制御の目安としている。

10

【0063】

上記の第1アクチュエータ18の作動に係る所定の物理量としては、変位検出手段15dより得られる、脚受部15bの変位とこの変位の検出間隔とからの速度算出により取得した、脚受部15bの移動の速度を用いている。

【0064】

そして、制御部40は、脚裏部へのストレッチ施療における施療強度を、マッサージ機の使用、具体的には被施療者、に選択可能としてあらかじめ複数段階、例えば、強中弱の三段階設定しており、こうした複数段階の強度の中から使用者に選択されたものを目安とする施療強度として、この目安の強度に対応する前記物理量の目安値、本実施形態では脚受部15bの移動の速度の目安値、を設定することとなる。

20

【0065】

こうして、第1アクチュエータ18の作動による脚受部15bの移動変位を示す変位検出手段15dの信号出力について、制御部40で、脚受部15bの座部12に対する位置関係の把握に用いる他、脚受部15bの変位とこの変位の検出間隔を用いて脚受部15bの移動の速度を求めることで、ストレッチ施療において、実際に施療強度が高い場合など、第1アクチュエータ18の負荷が高くなり脚受部15bの移動の速度、すなわち、第1アクチュエータ18の作動速度が低下した状態を検知できることとなる。こうした速度に基づいて、例えば第2アクチュエータ19の制御を行うようにすれば、設定した施療強度が実際に得られる状態を目安として第2アクチュエータ19を作動させられ、傾動角度など変位そのものに基づいて制御を行う場合のように、個人ごとの脚の長さの差に伴う限界傾動角度の違いによる施療強度のばらつき等を生じさせない。

30

【0066】

この他、制御部40は、公知のマッサージ機と同様に、マッサージに先立つ被施療者の身体各部位位置検出として、メカユニット50を制御し、メカユニット50を背もたれ部13における初期位置からガイドレール20に沿って移動させ、揉み玉51を被施療者に沿って動かす過程で、背もたれ部13にもたれた被施療者側からの揉み玉51に対する圧力の変化や揉み玉51の傾き変化等を順次取得し、この情報に基づいて、被施療者の肩位置、背骨のライン、腰位置を検出することもできる。

【0067】

次に、本実施形態に係るマッサージ機における被施療者の脚裏部ストレッチ施療過程について説明する（図7参照）。前提として、マッサージ機1に被施療者が着座して背中を背もたれ部13にもたれさせた状態で、マッサージ機1の主電源が入とされ、マッサージ機1が起動して、被施療者の体重や体形検出などのマッサージ開始前の準備動作や、背もたれ部13のリクライニング角度調整等が完了し、さらに、被施療者によりマッサージコース等の動作状態指示が入力されて、種々のマッサージ動作を実行する中で、制御部40が脚に対するストレッチ施療を実行しようとしているものとする。

40

【0068】

そして、制御部40は、ストレッチ施療に係る各部の作動制御開始前に、脚支持部15がその初期位置としての最も下部に下がった状態にない場合は、第2アクチュエータ19を縮方向に作動させ、脚支持部15を初期位置まで傾動させる。合わせて、脚支持部の脚

50

受部 15b が最も座部寄りの位置となっていない場合には、第 1 アクチュエータ 18 を動作させて脚受部 15b を座部 12 に近づく向きに移動させておく。

【0069】

制御部 40 は、ストレッチ施療における初期位置にある脚支持部 15 の、各機構部分の作動を開始させるにあたり、まず、あらかじめ設定されたストレッチの複数段階の施療強度、例えば、強、中、弱の三段階の施療強度のうち、被施療者が施療前に入力指示したか、マッサージコースの一部として選択設定されている施療強度を読み出し、この施療強度にあらかじめ対応付けられて記録されている脚受部 15b の移動の速度の値を、制御の目安値として登録する（ステップ S001）。

【0070】

この後、制御部 40 は、脚支持部 15 で脚の両側に位置する各脚用エアセルへの給気を実行してエアセルを膨張させる（ステップ S002）（図 5（B）、図 8 参照）。この脚用エアセルの膨張に伴い、脚のふくらはぎ部分がエアセルで両側から挟持され、脚受部 15b に拘束されることとなる。

【0071】

脚用エアセルが十分に膨張して、ふくらはぎ部分が挟持、拘束された状態で、制御部 40 は最下部の初期位置にある脚支持部 15 に対し、第 2 アクチュエータ 19 を伸長させ、第 2 アクチュエータ 19 一端部で脚支持部 15 の裏面側を押して脚支持部 15 を上向きに傾動させる（ステップ S003）。

【0072】

なお、座部 12 の両側に脚の大腿部を挟持する別のエアセルを配設している場合、制御部 40 は、この第 2 アクチュエータ 19 による脚支持部 15 の傾動開始前後、あるいは傾動開始と同時に、大腿部の挟持用エアセル 79 への給気を行い、これを膨張させ、大腿部の挟持を実行する（図 8 参照）。

【0073】

第 2 アクチュエータ 19 による脚支持部 15 の傾動を開始させ、脚支持部 15 の端部が床からある程度離れた後、制御部 40 は脚支持部 15 の第 1 アクチュエータ 18 を作動させ、脚支持部 15 の脚受部 15b を基礎部 15a に対し座部 12 から離れる側となる脚先端側へ少しずつ移動させていく（ステップ S004）（図 6（A）参照）。

【0074】

こうして、仮に脚受部 15b が基礎部 15a に対し動かない場合、脚支持部 15 の傾動に伴って脚支持部 15 前面部分と座部 12 上面との距離が縮まり、座部 12 及び脚支持部 15 上の脚の長さに対応しない状態となって、脚支持部 15 に拘束された関係で長手方向に動けない脚で、その膝部分が、余長を調整するように座部 12 先端部及び脚支持部 15 上端部から離れて脚裏の伸張が阻害される状態となったり、膝に負担（無理な力）が加わる状態となる問題点を、脚受部 15b を脚先端側へ移動させることで解消でき、脚を座部 12 や脚支持部 15 に付けて脚裏の伸張が適切に生じる状態のままで、脚支持部 15 の上向きの傾動を継続できる状態が得られる（図 6 参照）。

【0075】

この脚受部 15b の脚先端側への移動は、脚支持部 15 の傾動状態に対応して、被施療者の足や脚支持部 15 の端部が床面に当接しない程度に移動量を調整しつつ実行される。

一方、制御部 40 は、脚受部 15b の移動開始と共に、変位検出手段 15d の出力を受取り、脚受部 15b の移動変位を把握すると共に、変位検出手段 15d から得られる、脚受部 15b の変位とこの変位の検出間隔とから、脚受部 15b の移動の速度を継続的に算出し、第 2 アクチュエータ 19 の作動制御の目安の情報として取得する（ステップ S005）。

【0076】

制御部 40 の制御に基づき、第 2 アクチュエータ 19 を伸長させて、脚支持部 15 を上向きに傾動させ、被施療者の脚における膝より下の部分を持上げていく状態では、脚用エアセルで脚のふくらはぎ部分を拘束すると共に、脚受部 15b を脚先端側に移動させて脚

10

20

30

40

50

が座部と脚支持部上に接した状態を維持していることで、脚が適切な姿勢をとりつつ前方へ引張られる形となって、脚にストレッチ運動のような負荷が加わる状態となり、脚裏、特に大腿部裏側から膝裏にかけての部位が伸される状態となる。

【0077】

この脚支持部15の傾動の際には、必要に応じて背もたれ部13を起こす動作を連動させることもでき、背もたれ部13が起きて被施療者が上体を起こした姿勢を強いられることで、脚裏が伸びる向きの負荷がさらに加わる状態となり、脚裏へのストレッチ効果がさらに向上する。

【0078】

この後、脚支持部15の傾動の進行で、脚支持部15の前面側が座部12の高さに達し、脚支持部15の傾動角度が被施療者の脚の可動範囲の限界に近づく（図6（B）参照）と共に、被施療者の脚の膝から下部分が座部12に対し移動しにくくなり、脚受部15bの座部12から離れる向きの移動において抵抗が加わる状態となる。これに伴い、脚受部15bを移動させる第1アクチュエータ18の負荷が急増し、脚受部15bの移動の速度及びこれに係る第1アクチュエータ18の作動速度も大幅に低下する。

【0079】

制御部40は、脚受部15bの移動開始から、脚受部15bの移動の速度を継続的に取得しており、この低下状態にある速度が、先に登録された目安値に達したか否かを判定する（ステップS006）。

【0080】

ストレッチの施療強度が強くなるほど、第1アクチュエータ18の負荷も大となるなど、ストレッチ施療における施療強度と第1アクチュエータ18の負荷とは対応しており、また、第1アクチュエータ18の負荷上昇と脚受部15bの移動の速度の低下度合も一定の関係性を有することがわかっていることから、制御部40では、あらかじめ設定されたストレッチの施療強度に対応する脚受部15bの移動の速度を制御の目安値とし、第1アクチュエータ18を作動させる間、取得した脚受部15bの移動の速度をこの目安値と比較照合する。

【0081】

制御部40は、取得した脚受部15bの移動の速度が目安値に達したと判定すると、第2アクチュエータ19と脚用エアセルの給排制御機構に対し作動停止の制御指令を送出する。この後、第2アクチュエータ19は停止状態となり、脚支持部15の傾動が停止する（ステップS007）。これにより、あらかじめ選択、設定されたストレッチの施療強度を超えることなく脚支持部15の傾動が停止され、過剰なストレッチ施療が行われることはない。一方、前記ステップS006で速度が目安値に達していない場合には、前記ステップS003に戻って第2アクチュエータ19による脚支持部15の傾動を続行し、以降の過程を繰り返す。

【0082】

こうして脚受部15bの移動の速度から施療強度を判断し、脚支持部15の傾動に係る第2アクチュエータ19の作動を制御しているので、脚の長さの個人差による傾動角度とストレッチの強度との関係の変化に影響を受けることなく、適切な施療強度でのストレッチが可能となる。

【0083】

制御部40は、第2アクチュエータ19を停止させると共に、脚用エアセルを空気の排出により収縮させて脚を挟持状態から解放し（ステップS008）、また、別のエアセル79で大腿部を挟持している場合は、これについても空気排出により挟持状態から解放すると、脚が自由に動かせる状態に戻る。

【0084】

この後、脚受部15bは、基礎部15aとの関係で座部12から離れる向きの移動限界に達し、これに応じて制御部40は第1アクチュエータ18を作動停止状態として（ステップS009）、一連のストレッチ施療が終了となる。

【0085】

これ以降は、他のマッサージ等に移行し、制御部40は、脚支持部15の位置が次の施療に適さない場合、第2アクチュエータ19を縮方向に作動させて、脚支持部15を下向きに傾動させると共に、第1アクチュエータ18を動作させて脚受部15bを座部12に近づく向きに移動させるなど、脚支持部15を施療に適した位置となるよう調整することとなる。

【0086】

なお、ストレッチの施療に係る各機構部分の作動のタイミングについては、上記のように、エアセルの膨張開始後、第2アクチュエータ19による脚支持部15の傾動を開始し、その後に第1アクチュエータ18を用いた脚受部15bの移動を開始するようにしている（図9参照）が、これに限られるものではなく、脚支持部15の傾動開始位置で脚受部15bが移動しても、脚受部15や被施療者の足が床に付くおそれがない場合には、脚支持部15の傾動と脚受部15bの移動を同時に開始するようにすることもできる。

【0087】

また、大腿部を挟持する別のエアセル79を用いる際の、その膨張開始のタイミングは、図10ないし図12の各タイミング例に示すように、制御部40が脚支持部15の傾動開始後に脚受部15bの移動を開始させる場合と、脚支持部15の傾動と脚受部15bの移動を同時に開始する場合のいずれでも、第2アクチュエータ19による脚支持部15の傾動開始と同時、あるいは傾動開始の前又は後、のいずれの時点でもかまわない。

【0088】

このように、本実施形態に係るマッサージ機は、座部12の前側で傾動可能に脚を支持する脚支持部15を、座部12に取付けられる基礎部15aとこれに対し移動可能な脚受部15bとの組合せ構造とし、脚へのストレッチの施療として脚支持部15を上向きに傾動させる際に、あらかじめ脚部エアセルで脚を挟持して脚受部15b上に保持固定した状態とし、さらに傾動の進行に合わせて、脚受部15bを座部12から離れる向きに少しずつ移動させることから、脚を脚支持部15や座部12から浮かせることなく脚支持部15を上向きに傾動させて脚を伸して、膝に負担をかけることなく、効率よく脚裏部分の筋肉のストレッチを行う状態が得られることとなり、脚のストレッチに係る施療をスムーズ且つ適切に実行でき、被施療者に対し優れた施療効果を付与できる。

【0089】

また、ストレッチ施療における施療強度と脚受部15bを移動させる第1アクチュエータ18の負荷とが対応し、且つ、脚受部15bの移動の速度が第1アクチュエータ18の負荷の変化に応じて変わることを利用して、制御部40で、この速度の変化と施療強度とを対応付け、あらかじめ設定されたストレッチの施療強度に一对一に対応する脚受部15bの移動の速度の値を、制御の目安値として設定し、第1アクチュエータ18を作動させる間、制御部40で取得した速度を目安値と比較照合しつつ、取得した速度が目安値に達すると、第2アクチュエータ19等に制御指令を送出するようにしている。これにより、第1アクチュエータ18の負荷変化に応じた速度の変化から、制御部40が施療強度を把握して、制御対象である第2アクチュエータ19を適切に制御でき、設定された施療強度に適合するように第2アクチュエータ19を作動させて脚支持部15を傾動させられ、適切な施療強度でストレッチを実行でき、結果として、脚の長さの個人差に伴う、脚支持部の傾動角度とストレッチの強度との関係が被施療者ごとに変化する状況に、第2アクチュエータ19の作動制御が影響を受けることはなく、被施療者が代っても常に適切な施療強度でのストレッチが可能となる。

【0090】

なお、前記実施形態に係るマッサージ機においては、脚受部15bの移動状態の把握にあたり、脚受部15bの位置変化をリニアエンコーダ等の変位検出手段15dで取得するようにし、制御部40が変位検出手段の出力から得られる、変位とこの変位の検出間隔とからの速度算出により取得した、脚受部15bの移動の速度を、ストレッチの施療強度と対応付けて第2アクチュエータ19の作動制御に用いる構成としているが、この他、第1

アクチュエータが可動部分を固定部分に対し直線的に移動させて伸縮するタイプとされると共に、変位検出手段としてのリニアエンコーダ等が一体に配設されるものとされ、制御部が第1アクチュエータの変位検出手段の出力より得られる、変位とこの変位の検出間隔とからの速度算出により取得した、第1アクチュエータの作動速度、詳細にはアクチュエータの伸長する速度を、ストレッチの施療強度と対応付けて、前記同様に第2アクチュエータの作動制御に用いる構成とすることもできる。すなわち、アクチュエータの作動の結果としてあらわれる速度であれば、アクチュエータに対し被動側である脚受部について取得した速度に限らず、アクチュエータの変化を直接検出して取得した速度でもかまわない。

【0091】

また、前記実施形態に係るマッサージ機においては、制御部40が脚受部15bの移動の速度を、ストレッチの施療強度と対応付けて第2アクチュエータ19の作動制御に用いる構成としているが、この他、第2アクチュエータの作動速度を、ストレッチの施療強度と対応付けてそのまま第2アクチュエータの作動制御に用いる構成とすることもできる。この場合、制御部は、第2アクチュエータの変位検出手段としてのリニアエンコーダの出力から取得した、第2アクチュエータの作動速度、詳細には伸縮するタイプのアクチュエータの伸長する速度を、ストレッチの施療強度と対応付けて第2アクチュエータの作動制御に用いることとなる。さらに、脚支持部の傾動状態の把握にあたり、脚支持部の傾斜角度変化をロータリーエンコーダ等の変位検出手段で取得するようにし、制御部が、こうした変位検出手段より得られる、変位とこの変位の検出間隔とからの速度算出により取得した、脚支持部の傾動の速度を、前記同様に第2アクチュエータの作動制御に用いる構成とすることもできる。

【0092】

また、こうしたアクチュエータの作動に係る物理量である速度を、制御部による他のアクチュエータ等の制御の目安に用いているが、この他、アクチュエータの負荷の変化に応じて変わるものであれば、速度以外の例えば電流など、アクチュエータの作動に係る他の物理量を制御の目安として用いるようにしてもよい。さらに、アクチュエータの動作速度を一定に保つようにアクチュエータのPWM制御を行うなど、制御部でアクチュエータのフィードバック制御を行うものの場合には、PWM値の増加量といった、フィードバック値の変化量あるいは変化割合を、物理量とすることもできる。こうした物理量として速度を用いない場合、速度が低下する影響をほとんど受けることなく、確実な施療の動作を維持しつつ、前記同様のアクチュエータ等施療機構の制御が行える。

【0093】

このような場合、脚裏部へのストレッチ施療として、脚支持部を上向きに傾動させる中、制御対象としての各機構部分の作動状態を制御する制御部が、脚受部の座部から離れる向きへの移動における、ストレッチの施療強度に応じてアクチュエータに加わる負荷の変化と、このアクチュエータの作動に係る所定の物理量の変化との対応関係をあらかじめ把握して、所定の目安とする施療強度に対応する前記物理量の目安値を設定し、アクチュエータの作動の間、前記物理量を取得して、物理量が前記目安値に達した際に所定の制御対象への制御指令を送出する制御を実行する、といえる。

【0094】

こうした制御部による制御の対象は、例示した脚支持部を押圧するアクチュエータやエアセルの給排気制御機構に限られるものではなく、アクチュエータに代えて、減速機構等を介して脚支持部を傾動させるモータなど他の駆動手段を用いる場合には、前記同様にこうした駆動手段を制御対象とすることができる。制御部は、脚支持部の上向きの傾動における、ストレッチの施療強度に応じて駆動手段に加わる負荷の変化と、駆動手段の作動に係る所定の物理量の変化との対応関係をあらかじめ把握して、目安とする施療強度に対応する前記物理量の目安値を設定し、駆動手段の作動の間、前記物理量を取得して、物理量が前記目安値に達した際に駆動手段への制御指令を送出する制御を行うこととなる。

【0095】

また、前記実施形態に係るマッサージ機においては、第2アクチュエータ19で脚支持部15を上向きに傾動させ、脚裏部分のストレッチ施療を行う構成としているが、これに加えて、脚支持部15の傾動時の脚裏部分の伸びを促すために、図13に示すように、座部12の前側上部位置で、被施療者の大腿部下部を持ち上げることのできるエアセルを設けるようにしてもよい。この場合、エアセルは、膨張して座部12前部を隆起させ、座部12の表面を大腿部下部の裏側に当接させ、大腿部をやや持ち上げた状態で保持する。これにより、脚を伸ばしたままでその膝部が上側に移動して、脚裏をより伸張させるように作用することとなる。こうした座部12前部の隆起状態は、アクチュエータ等で座部12前部を下から押して持上げるなど、機械的に形成するようにしてもよい。

【0096】

この他、同様に脚裏部分の伸びを促すために、図14に示すように、脚支持部15の傾動中心となる座部12前端の軸部15cを上昇させる、位置調整手段81を設けることもできる。脚支持部15の上向きの傾動の際に、この位置調整手段81で脚支持部15の軸部15cを上昇させる場合、脚支持部15の傾動の中心位置が変わることで、脚の膝より下部分がより上側に移動させられる状態となり、座部12前部を隆起させる場合同様、脚裏をより伸張させるように作用することとなる。また、脚支持部15を大きく傾動させなくても、代りに軸部15cを上げることで脚支持部15の位置を上げられることから、脚裏のストレッチ効果を確保しつつ、脚支持部15の傾動範囲を小さく設定できる。この傾動中心の軸部15cを上昇させる位置調整手段は、前記座部12前部を隆起させる座部調整手段のエアセル等が兼ねるようにしてもかまわない。

【0097】

(本発明の第2の実施形態)

前記第1の実施形態に係るマッサージ機においては、制御部40が、脚裏部へのストレッチ施療における複数段階の施療強度のうち使用者に選択された施療強度に対応する脚受部15bの移動の速度を目安値として、この目安値に随時取得している速度が達した際に、制御指令を送出して第2アクチュエータ19の作動停止等、これまでの作動状態からの変化を起させる制御を行う構成としているが、この他、第2の実施形態として、図15に示すように、制御部40が、制御における目安値を、使用者の選択可能な複数段階の施療強度とは別の、これらの施療強度に近いがより小さい、所定の目安の施療強度に対応した物理量とする一方、複数段階の施療強度の中から使用者に選択されたものを目標施療強度とし、第1アクチュエータ18の作動速度や脚受部15bの移動の速度などの物理量が目安値に達したら、第2アクチュエータ19等の制御対象が前記目標施療強度を実現するように作動する制御指令を送出する、例えば、制御部40が第2アクチュエータ19に対し、前記速度が目安値に達した後、第2アクチュエータ19は実際の施療強度が目標施療強度に達すると予想される所定のタイミングで作動停止する、との制御指令を送出する、といった制御を実行する構成とすることもできる。

【0098】

この場合、制御部40は、使用者による施療強度の選択に関わりなく、ストレッチ施療の制御における目安値を常に一定とすることができ、目安値に達した状況から、選択された施療強度が実際に生じ得るまでの、各機構の残りの作動量が既知である場合は、制御を簡略化でき、また、目安値に達した時点の各部の状態（例えば、脚受部の移動量）を参照して、これらを考慮した制御を行うようにすることもでき、制御面で都合がよい。

【0099】

この第2の実施形態に係るマッサージ機における被施療者の脚裏部ストレッチ施療過程について、図16のフローチャートを用いて説明する。前提として、前記第1の実施形態と同様に、マッサージ機1に被施療者が着座して背中を背もたれ部13にもたれさせた状態で、制御部40が脚に対するストレッチ施療を実行しようとしているものとする。

【0100】

制御部40は、ストレッチ施療における初期位置にある脚支持部15の、各機構部分の作動を開始させるにあたり、まず、あらかじめ設定されたストレッチの複数段階の施療強

10

20

30

40

50

度、例えば、強、中、弱の三段階の施療強度のうち、被施療者が施療前に入力指示したか、マッサージコースの一部として選択設定されている施療強度を読み出し、この施療強度を目標施療強度として登録する（ステップS101）。

【0101】

この後、制御部40は、脚支持部15で脚の両側に位置する各脚用エアセルへの給気を実行してエアセルを膨張させる（ステップS102）。この脚用エアセルの膨張に伴い、脚のふくらはぎ部分がエアセルで両側から挟持され、脚受部15bに拘束される。

脚が挟持、拘束された状態で、制御部40は最下部の初期位置にある脚支持部15に対し、第2アクチュエータ19を伸長させ、脚支持部15を上向きに傾動させる（ステップS103）。

10

【0102】

なお、座部12の両側に脚の大腿部を挟持する別のエアセルを配設している場合、制御部40は、この第2アクチュエータ19による脚支持部15の傾動開始前後、あるいは傾動開始と同時に、大腿部の挟持用エアセル79への給気を行い、これを膨張させ、大腿部の挟持を実行する。

【0103】

第2アクチュエータ19による脚支持部15の傾動を開始させ、脚支持部15の端部が床からある程度離れた後、制御部40は第1アクチュエータ18を作動させ、脚支持部15の脚受部15bを基礎部15aに対し座部12から離れる向きへ少しずつ移動させていく（ステップS104）。

20

【0104】

一方、制御部40は、脚受部15bの移動開始と共に、変位検出手段15dの出力を受取り、脚受部15bの移動変位を把握すると共に、変位検出手段15dから得られる脚受部15bの変位とこの変位の検出間隔とから、脚受部15bの移動の速度を継続的に算出し、第2アクチュエータ19の作動制御のための情報として取得する（ステップS105）。

【0105】

制御部40の制御に基づき、第2アクチュエータ19を伸長させて、脚支持部15を上向きに傾動させ、被施療者の脚における膝より下の部分を持上げると共に、脚受部15bを脚先端側に移動させることで、脚にはストレッチ運動のような負荷が加わる状態となり、脚裏が伸される状態となる。

30

【0106】

この後、脚受部15bの移動量が被施療者の脚の可動範囲の限界に近づき、被施療者の脚の膝から下部分が移動しにくくなり、脚受部15bの座部12から離れる向きの移動において抵抗が加わる状態となる。これに伴い、脚受部15bを傾動させる第1アクチュエータ18の負荷が急増し、脚受部15bの移動の速度及びこれに係る第1アクチュエータ18の作動速度も大幅に低下する。

【0107】

制御部40は、あらかじめ設定されたストレッチの基準となる施療強度に対応する脚受部15bの移動の速度を制御の目安値とすると共に、脚受部15bの移動開始から、脚受部15bの移動の速度を継続的に取得し、取得した脚受部15bの移動の速度をこの目安値と比較照合しており、低下状態にある脚受部15bの移動の速度が、あらかじめ設定された目安値に達したか否かを判定する（ステップS106）。

40

【0108】

制御部40は、取得した脚受部15bの移動の速度が目安値に達したと判定すると、第2アクチュエータ19と脚用エアセルの給排制御機構に対し、登録された目標施療強度を生じさせるようにこれらが作動する制御指令を送出する。

【0109】

この制御指令を受けて、第2アクチュエータ19は、前記速度が目安値に達した後の適切なタイミングで作動停止状態となり、脚支持部15の傾動が停止する（ステップS10

50

7)。これにより、あらかじめ選択、設定されたストレッチの施療強度を生じさせるような脚支持部15の傾動状態が得られる。一方、前記ステップS106で速度が目安値に達していない場合には、前記ステップS103に戻って第2アクチュエータ19による脚支持部15の傾動を続行し、以降の過程を繰返す。

【0110】

制御部40は、第2アクチュエータ19を停止させると共に、第1アクチュエータ18の作動も停止させ、脚受部15bの移動を止める(ステップS108)。この後、制御部40は、脚用エアセルを空気の排出により収縮させて脚を挟持状態から解放し(ステップS109)、また、別のエアセル79で大腿部を挟持している場合は、これについても空気が排出により挟持状態から解放すると、脚が自由に動かせる状態に戻り、一連のストレッチ施療が終了となる。

10

【0111】

(本発明の第3の実施形態)

また、前記第1の実施形態に係るマッサージ機において、制御部40は、脚裏部へのストレッチ施療における脚受部15bの移動の速度を目安値として、この目安値に随時取得している速度が達した際に、制御対象としての第2アクチュエータ19等に制御指令を送出する制御を行う構成としているが、この他、第3の実施形態として、制御部40が、取得している第1アクチュエータ18の作動速度や脚受部15bの移動の速度などの物理量が目安値に達したら、ここまでの第1アクチュエータの作動により所定の変化が生じている第1アクチュエータ及び/又は脚受部15bの状態を把握し、この状態に応じた制御指令を、第2アクチュエータ19等の制御対象へ送出的る制御を実行する構成とすることもできる。

20

【0112】

この場合、制御部40は、第1アクチュエータの作動に伴い変化した第1アクチュエータ及び/又は脚受部の状態、例えば、図17に示すように、脚受部15bの移動の速度が目安値に達した際の脚受部15bの移動量、に適合するように第2アクチュエータ19を作動させる制御指令を第2アクチュエータ19に送出的ることとなり、制御対象としての第2アクチュエータ19を適切に作動させて脚支持部15を被施療者に合わせて傾動させられる。すなわち、脚受部15bの移動量は、被施療者の脚が長いほど大きくなるなど、脚の長さに対応する大きさとなることから、被施療者の脚長、すなわち体格を示す情報として用いることができ、脚受部15bの移動量に合わせて第2アクチュエータ19の作動を制御することで、同じ強さ段階の施療強度を生じさせるものながら、被施療者の体格に応じて異なる最適傾動量を与えられるなど、各機構を適切に連係させて無理のないスムーズなストレッチ施療を実行できる。

30

【0113】

(本発明の第4の実施形態)

本発明の第4の実施形態に係るマッサージ機を前記図18ないし図20に基づいて説明する。

前記各図において本実施形態に係るマッサージ機は、前記第1の実施形態同様、各種の施療機構と共に脚のストレッチ施療を実行可能な制御構成を備える一方、異なる点として、揉み玉51による施療対象部位への揉み施療の際の施療強度調整において、制御部40が、目安とする揉みの施療強度に対応する、揉み施療に係る揉み玉51の作動速度の目安値を設定し、揉み玉51を動かす揉みモータ62の作動の間、揉み玉51の作動速度を取得しつつ、この速度が前記目安値に達した際に、制御対象としての進退モータ58に制御指令を送出し、強度調整に係る進退モータ58の作動状態を変化させる、前記第1の実施形態での脚のストレッチ施療における制御の場合と類似する制御を実行する構成を有するものである。

40

【0114】

なお、揉み玉51による揉み施療における強度調整に係る制御以外の点については、前記第1の実施形態の場合と同じであり、詳細な説明を省略する。

50

【0115】

前記制御部40は、前記第1の実施形態同様の制御に加えて、特に、揉み施療の際の施療強度調整として、メカユニット50において揉み玉51と駆動機構部60をベース部54に対し傾動させて揉み玉51の被施療者側への突出量を変化させる進退モータ58の作動状態を制御するにあたり、背中の施療対象部位への揉み施療としての揉み玉51の揺動における、揉みの施療強度に応じて揉みモータ62に加わる負荷の変化と、揉みモータ62の作動に係る所定の物理量の変化との対応関係をあらかじめ把握して、目安とする施療強度に対応する前記物理量の目安値を設定し、揉みモータ62の作動の間、前記物理量を取得して、物理量が前記目安値に達したら、進退モータ58に対し所定の制御指令を送出するようにしている。

10

【0116】

上記の揉みモータ62の作動に係る所定の物理量としては、駆動機構部60のハウジング61に内蔵された変位検出手段としてのエンコーダ65より得られる、揉み玉支持アーム52を駆動する駆動軸（図示を省略）の回転角度変位とこの変位の検出間隔とからの速度算出により取得した、揉み玉51の作動速度、より詳細には、揉み玉51が駆動機構部60に対し被施療者に近づく向きに移動する速度、を用いている。このように、速度は、揉みモータ62から直接検出した変化に基づくものではなく、揉みモータ62の作動の結果として揉みモータ62の被動側である揉み機構の駆動軸にあらわれるものを制御に用いることで、制御の精度を確保しつつ速度の取得を揉み玉位置把握用の簡略な検出機構で容易に行えるようにしている。

20

【0117】

そして、制御部40は、揉み施療における施療強度を、マッサージ機の利用者、具体的には被施療者、に選択可能としてあらかじめ複数段階、例えば、五段階に設定しており、こうした複数段階の強度の中から利用者を選択されたものを目安とする施療強度として、この目安の強度に対応する前記物理量の目安値、本実施形態では揉み玉51の作動速度の目安値、を設定することとなる。

【0118】

より具体的には、前記揉み玉51の作動速度は、揉みモータ62の作動で、揉み玉51が駆動機構部60に対し被施療者に近づく向きに移動する際に、揉み玉支持アーム52を駆動する駆動軸の回転角度変位が、エンコーダ65から出力されるパルス信号の数として得られると共に、このパルス数分の時間が角度変位の検出間隔に相当することで、パルス信号の数に応じた角度変位とこのパルス数に対応した時間とから算出できる仕組みである。

30

【0119】

ただし、現実的な処理としては、制御部40で、単位角度変位、すなわち一つのパルス信号が生じた際に、その変位にかかった時間に相当する、前記パルス信号の幅を検出し（図18参照）、これが速度と一対一に対応していることから、このパルス信号幅の値を速度に代えてそのまま制御に用いて、制御処理を簡略化するのが好ましい。この場合、前記パルス信号幅も、揉みモータ62の作動に係る物理量といえ、制御部40は、複数段階、例えば、五段階に設定した揉み施療の施療強度に、速度に代るパルス信号幅の値をそれぞれ対応付けた上で（表1参照）、五段階の強度の中から利用者を選択されたものを目安とする施療強度とし、この目安の強度に対応するパルス信号幅の値を目安値に設定して、モータの作動制御を実行することとなる。

40

【0120】

前記五段階の施療強度とパルス信号幅の値との対応の例を下記表1に示す。表1には、表中の下段ほど大となる施療強度ごとに、対応するパルス信号幅、及び、対応する作動速度の変化量（無負荷時に対する割合）を示している。

【0121】

【表 1】

	パルス幅 [m s]	変化量
(無負荷時)	8 0	—
強さ 1	9 0	9 0 %
強さ 2	1 0 0	8 0 %
強さ 3	1 1 5	7 0 %
強さ 4	1 3 0	6 0 %
強さ 5	1 6 0	5 0 %

10

【0 1 2 2】

こうして、制御部 4 0 では、揉み機構の駆動軸の回転角度変位を示すエンコーダ 6 5 の信号出力について、揉み玉 5 1 の位置の把握に用いる他、回転角度変位とこの変位の検出間隔を用いて、揉み玉 5 1 の作動速度を求め、この速度を、駆動機構部 6 0 を傾動させて施療強度を調整する進退モータ 5 8 の制御の目安とする情報として用いている。これにより、揉み施療において施療強度を調整する際、設定強度に対応して実際に施療強度が高まった場合など、揉みモータ 6 2 の負荷が高くなり、揉み玉 5 1 の作動速度が低下した状態を、制御部 4 0 で検知できる。制御部 4 0 はこうした作動速度に基づいて進退モータ 5 8 の制御を行うことで、設定した施療強度が実際に得られる状態を目安としてモータの作動を制御でき、駆動機構部の傾動した角度など変位そのものに基づいて進退モータ 5 8 の制御を行う場合のように、個人ごとの体格の差に伴う限界傾動角度の違いによる実施療強度のばらつき等を生じさせないと共に、背もたれ部 1 3 上で被施療者が動いて、施療対象部位の背もたれ部 1 3 における位置が変化した場合にも、追隨して適切な施療強度で施療が行える状態に調整設定できる。

20

30

【0 1 2 3】

次に、本実施形態に係るマッサージ機における被施療者への揉み施療での施療強度調整過程について説明する（図 1 9 参照）。前提として、前記第 1 の実施形態における脚裏部のストレッチ施療の場合と同様、マッサージ機 9 0 に被施療者が着座して背中を背もたれ部 1 3 にもたれさせた状態で、マッサージ機 9 0 が起動して施療可能な状態に移行した上で、被施療者によりマッサージコース等の動作状態指示が入力され、制御部 4 0 が被施療者の背中における施療対象部位に対する揉み施療を実行する中、マッサージ機のリモコン 3 0 に対し被施療者から揉みの施療強度のより強くする調整を入力指示されたものとする。

【0 1 2 4】

制御部 4 0 は、被施療者の施療強度調整の入力指示を受けて、揉み施療における施療強度調整に係る進退モータ 5 8 の作動を開始させるにあたり、まず、あらかじめ設定された揉みの複数段階の施療強度のうち、被施療者が入力指示した施療強度に、あらかじめ対応付けられて記録されている揉み玉 5 1 の作動速度の値を、制御の目安値として登録する（ステップ S 2 0 1）。

40

【0 1 2 5】

そして、制御部 4 0 は、メカユニット 5 0 の進退モータ 5 8 を作動させて揉み玉 5 1 と駆動機構部 6 0 を傾動させ（ステップ S 2 0 2）、揉みに係る作動中の揉み玉 5 1 を、背もたれ部 1 3 にもたれた被施療者の背面の施療対象部位にさらに押し付けるように被施療者側へ突出させる（図 2 0 参照）。

50

【0126】

一方、制御部40は、進退モータ58の作動開始と共に、揉み機構における変位検出手段としてのエンコーダ65の出力を受取り、駆動軸の回転角度変位及びこれより求められる揉み玉51の位置を把握する。加えて、制御部40は、エンコーダ65から得られる、駆動軸の回転角度変位とこの変位の検出間隔とから、揉み玉51の作動速度を継続的に算出し、進退モータ58の作動制御のための目安情報として取得する（ステップS203）。

【0127】

揉み施療に係る揺動と共に、駆動機構部60ごとの傾動による揉み玉51の被施療者側への進行で、揉み玉51が被施療者の背部を押圧しながら揉み施療を行う状態が得られる。この時、進退モータ58の作動による揉み玉51の進行に伴い、揉み玉51は被施療者の施療対象部位の押圧強度を大きくしていく中で、揉み玉51の揉みに係る動きにおいて抵抗が増大する状態となる。これに伴い、揉みモータ62で駆動される揉み玉51の作動速度、すなわち、揉み玉51の被施療者側へ近づく向きに移動する速度が大幅に低下する。

10

【0128】

制御部40は、進退モータ58の作動開始から、揉み玉51の揉みに係る作動速度を継続して取得しており、この低下状態にある速度が、先に登録された目安値に達したか否かを判定する（ステップS204）。

【0129】

進退モータ58による傾動を伴って、揉みの施療強度が強くなるほど、揉みモータ62の負荷も大となるなど、揉み施療における強度調整時の施療強度と揉みモータ62の負荷とは対応しており、また、揉みモータ62の負荷上昇と揉みモータ62により駆動される揉み玉51の作動速度の低下度合も一定の関係性を有することがわかっていることから、制御部40では、あらかじめ設定された揉みの施療強度に対応する揉み玉51の作動速度をそれぞれ目安値とし、揉み施療として揉みモータ62を作動させ、揉み玉51を作動させる間、取得した作動速度をこの目安値と比較照合する。

20

【0130】

制御部40は、取得した揉み玉51の作動速度が低下して目安値に達したと判定すると、制御部40は進退モータ58に対し作動停止の制御指令を送出する。この後、進退モータ58は停止状態となり、揉み玉51と駆動機構部60のベース部54に対する傾動が停止する（ステップS205）。これにより、あらかじめ選択、設定された揉みの施療強度を超えないよう揉み玉51の突出が抑えられ、揉み玉51による揉み施療の強度が設定に対応したものとなる。

30

【0131】

一方、前記ステップS104で速度が目安値に達していない場合には、前記ステップS102に戻って進退モータ58による揉み玉51及び駆動機構部60の傾動を続行し、以降の過程を繰返す。

【0132】

揉みに係る揉み玉51の作動速度から施療強度を判断し、揉み玉51及び駆動機構部60の傾動に係る進退モータ58の作動を制御しているので、体形の個人差や被施療者の動きによる揉み玉の突出量と揉みの強度との関係の変化に影響を受けることなく、適切な施療強度での揉み施療が可能となる。

40

【0133】

制御部40が進退モータ58を停止させると、一連の揉み施療における強度調整は終了となる。この後、制御部40は進退モータ58の停止状態を維持して、施療時間としてあらかじめ規定された所定時間、揉み施療状態を継続させる。その後、揉みの施療が終了し、他のマッサージ等に移行する場合には、制御部40は、揉み玉51及び駆動機構部60の位置が次の施療に適さない場合、進退モータ58を揉み玉51及び駆動機構部60が被施療者から離れる側に傾動させる回転方向に回転させると共に、メカユニット50を上又

50

は下に移動させるなど、揉み玉 5 1 を施療に適した位置となるよう調整することとなる。

【0134】

以上のように、本実施形態に係るマッサージ機は、揉み施療の際の施療強度調整において、揉み施療としての揉み玉 5 1 の作動における、揉みの施療強度に応じて揉みモータ 6 2 に加わる負荷の変化と、揉み玉 5 1 の作動速度の変化との対応関係を制御部 4 0 があらかじめ把握して、目安とする施療強度に対応する揉み玉 5 1 の作動速度の目安値を設定し、揉みモータ 6 2 の作動の間、制御部 4 0 が揉み玉 5 1 の作動速度を取得して、この揉み玉 5 1 の作動速度が前記目安値に達した際に、進退モータ 5 8 に制御指令を送出する制御を実行するものである。

【0135】

このように本実施形態に係るマッサージ機においては、揉み施療における施療強度と揉み玉 5 1 を動かす揉みモータ 6 2 の負荷とは対応しており、また、揉みモータ 6 2 の負荷の変化に応じて変わる、揉み玉 5 1 の作動速度など、揉みモータ 6 2 の作動に係る所定の物理量が存在することを利用して、制御部 4 0 で、この物理量の変化と施療強度とを対応付け、あらかじめ設定された揉みの施療強度に一对一に対応する、前記物理量の値を、目安値として設定し、揉みモータ 6 2 を作動させる間、制御部 4 0 で取得した物理量を目安値と比較照合して、取得した物理量が目安値に達したら、制御部 4 0 から進退モータ 5 8 に制御指令を送出するようにしている。これにより、揉みモータ 6 2 の負荷変化に応じた物理量の変化から施療強度を把握して、進退モータ 5 8 を適切に制御でき、設定された施療強度に適合するように進退モータ 5 8 を作動させて揉み玉 5 1 を移動させることができ、結果として、体格の個人差や被施療者の動きに伴う、揉み玉 5 1 及び駆動機構部 6 0 の傾動の角度と揉み施療の強度との関係が変化する状況に、進退モータ 5 8 の作動制御が影響を受けることはなく、背もたれ部 1 3 上の被施療者の状態が変わっても、常に適切な施療強度に調整した上で揉み施療が可能となる。

【0136】

(本発明の第 5 の実施形態)

前記第 4 の実施形態に係るマッサージ機において、制御部 4 0 は、揉み施療の際の施療強度調整で、目安とする揉みの施療強度に対応する、揉み施療に係る揉み玉 5 1 の作動速度の目安値を設定し、揉みモータ 6 2 の作動の間、揉み玉 5 1 の作動速度を取得しつつ、この速度が前記目安値に達した際に、制御対象としての進退モータ 5 8 に制御指令を送出し、進退モータ 5 8 の作動状態をそれまでと変化させる構成としているが、この他、第 5 の実施形態として、制御部 4 0 が、揉みモータ 6 2 の作動に係る物理量に代えて、揉み玉 5 1 及び駆動機構部 6 0 を傾動させる進退モータ 5 8 の作動の間、進退モータ 5 8 の作動に係る物理量を取得し、これがあらかじめ設定された目安値に達したら、所定の制御指令を進退モータ 5 8 に送出し、進退モータ 5 8 の作動状態を変化させる構成とすることもできる。

【0137】

なお、進退モータ 5 8 の作動に係る物理量としては、メカユニット 5 0 に設けた変位検出手段としてのエンコーダ 5 5 より得られる、駆動機構部 6 0 の傾動による角度変位とこの変位の検出間隔とからの速度算出により取得した、揉み玉 5 1 と駆動機構部 6 0 の作動速度、より詳細には、揉み玉 5 1 と駆動機構部 6 0 がベース部 5 4 に対し被施療者に近づく向きに傾動する速度、を用いる。

【0138】

この揉み玉 5 1 と駆動機構部 6 0 の作動速度は、進退モータ 5 8 の作動で、揉み玉 5 1 と駆動機構部 6 0 がベース部 5 4 に対し被施療者に近づく向きに傾動する際に、駆動機構部 6 0 の傾動による角度変位が、エンコーダ 5 5 から出力されるパルス信号の数として得られると共に、このパルス数分の時間が角度変位の検出間隔に相当することで、パルス信号の数に応じた角度変位とこのパルス数に対応した時間とから算出できる仕組みである。

【0139】

このように、速度は、進退モータ 5 8 から直接検出した変化に基づくものではなく、進

10

20

30

40

50

退モータ５８の作動の結果として進退モータ５８の被動側である駆動機構部６０にあらわれるものを制御に用いることで、制御の精度を確保しつつ速度の取得を簡略な機構で容易に行えるようにしている。

【０１４０】

続いて、この第５の実施形態に係るマッサージ機における被施療者への揉み施療での施療強度調整過程について、図２１のフローチャートを用いて説明する。前提として、前記第４の実施形態の場合と同様に、マッサージ機９０に被施療者が着座して背中を背もたれ部１３にもたれさせた状態で、揉み施療を実行する中、被施療者から揉みの施療強度のより強くする調整を入力指示されたものとする。

【０１４１】

制御部４０は、被施療者の施療強度調整の入力指示を受けて、揉み施療における施療強度調整に係る進退モータ５８の作動を開始させるにあたり、まず、あらかじめ設定された揉みの複数段階の施療強度のうち、被施療者が入力指示した施療強度に、あらかじめ対応付けられて記録されている揉み玉５１及び駆動機構部６０の傾動に係る作動速度の値を、制御の目安値として登録する（ステップＳ３０１）。

【０１４２】

そして、制御部４０は、メカユニット５０の進退モータ５８を作動させて揉み玉５１と駆動機構部６０を傾動させ（ステップＳ３０２）、揉みに係る作動中の揉み玉５１を、背もたれ部１３にもたれた被施療者の背面の施療対象部位にさらに押し付けるように被施療者側へ突出させる。

【０１４３】

一方、制御部４０は、揉み玉５１及び駆動機構部６０の傾動開始と共に、変位検出手段としてのエンコーダ５５の出力を受取り、駆動機構部６０の傾動角度変位及びこれより求められる揉み玉５１の突出量を把握する。加えて、制御部４０は、エンコーダ５５から得られる、駆動機構部６０の傾動角度変位とこの変位の検出間隔とから、揉み玉５１及び駆動機構部６０の作動速度を継続的に算出し、進退モータ５８の作動制御のための目安情報として取得する（ステップＳ３０３）。

【０１４４】

揉み施療に係る揺動と共に、駆動機構部６０ごとの傾動による揉み玉５１の被施療者側への進行で、揉み玉５１が被施療者の背部を押圧しながら揉み施療を行う状態が得られる。この時、進退モータ５８の作動による揉み玉５１の進行に伴い、揉み玉５１は被施療者の施療対象部位の押圧強度を大きくしていく中で、揉み玉５１及び駆動機構部６０の傾動において抵抗が増大する状態となる。これに伴い、進退モータ５８で駆動される揉み玉５１及び駆動機構部６０の作動速度、すなわち、揉み玉５１及び駆動機構部６０の被施療者側へ傾動する速度が大幅に低下する。

【０１４５】

制御部４０は、あらかじめ設定された施療強度に対応する揉み玉５１及び駆動機構部６０の作動速度を目安値とすると共に、揉み玉５１及び駆動機構部６０の傾動開始から、その速度を継続して取得し、取得した速度をこの目安値と比較照合しており、低下状態にある速度が、先に登録された目安値に達したか否かを判定する（ステップＳ３０４）。

【０１４６】

制御部４０は、取得した揉み玉５１及び駆動機構部６０の作動速度が低下して目安値に達したと判定すると、制御部４０は選択された揉みの施療強度に対応してあらかじめ設定されている揉み玉５１及び駆動機構部６０の位置データを取得する（ステップＳ３０５）。そして、制御部４０は、この位置データに基づいて、揉み玉５１及び駆動機構部６０を被施療者から離す側へ所定角度分傾動させた後停止させるように、進退モータ５８を作動させる制御指令を、進退モータ５８に対し送出し、進退モータ５８は揉み玉５１及び駆動機構部６０が被施療者から離れる側に前記所定角度分戻した後、停止状態となり、揉み玉５１と駆動機構部６０を停止させる（ステップＳ３０６）。これにより、揉みに際しての揉み玉５１の突出量は適切なものとなり、揉み玉５１による揉み施療の強度は使用者の選

10

20

30

40

50

択した施療強度に正しく対応することとなる。

【0147】

一方、前記ステップS304で速度が目安値に達していない場合には、前記ステップS302に戻って進退モータ58による揉み玉51及び駆動機構部60の傾動を続行し、以降の過程を繰返す。

【0148】

制御部40が進退モータ58を停止させると、一連の揉み施療における強度調整は終了となる。この後、前記第4の実施形態と同様、制御部40は施療時間としてあらかじめ規定された所定時間、揉み施療状態を継続させる。

【0149】

なお、前記第1ないし第5の各実施形態に係るマッサージ機について、施療の具体例としてストレッチや揉みを挙げて、これらの施療の際に、制御部で施療強度とアクチュエータやモータ等の駆動手段の作動に係る所定の物理量とを対応付け、目安とする施療強度に対応する物理量の目安値を設定し、取得した物理量が前記目安値に達すると、制御部が他のアクチュエータ等の制御対象に制御指令を送出する制御を実行する点を説明しているが、こうした制御手法の適用は、ストレッチや揉みに限られず、いずれの施療についても一般化できる。すなわち、所定の施療時における駆動手段の作動状態を制御する制御部が、駆動手段で駆動される施療実行手段の作動状態における、施療強度に応じて駆動手段に加わる負荷の変化と、駆動手段の作動に係る所定の物理量の変化との対応関係をあらかじめ把握して、目安とする施療強度に対応する前記物理量の目安値を設定し、駆動手段の作動の間、前記物理量を取得して、物理量が前記目安値に達した場合に、所定の制御対象への制御指令を送出する制御を実行する、といったものとなる。

【符号の説明】

【0150】

1	マッサージ機
11	基台部
12	座部
13	背もたれ部
14	肘掛部
15	脚支持部
15a	基礎部
15b	脚受部
15c	軸部
15d	変位検出手段
16	スタンド
17	フレーム
18	第1アクチュエータ
19	第2アクチュエータ
20	ガイドレール
30	リモコン
40	制御部
50	メカユニット
51	揉み玉
52	揉み玉支持アーム
54	ベース部
55	エンコーダ
55a	センサ部
55b	スケール部
57	昇降モータ
58	進退モータ

10

20

30


40

50


58a	小歯車
60	駆動機構部
61	ハウジング
62	揉みモータ
64	叩きモータ
65	エンコーダ
67	歯部
70	エアポンプ
71	臀部用エアセル
72	太腿用エアセル
73	背中用エアセル
74	腰用エアセル
75、76	脚用エアセル
77、78	脚用エアセル
79	挟持用エアセル
80	エアセル
81	位置調整手段

10


【図1】

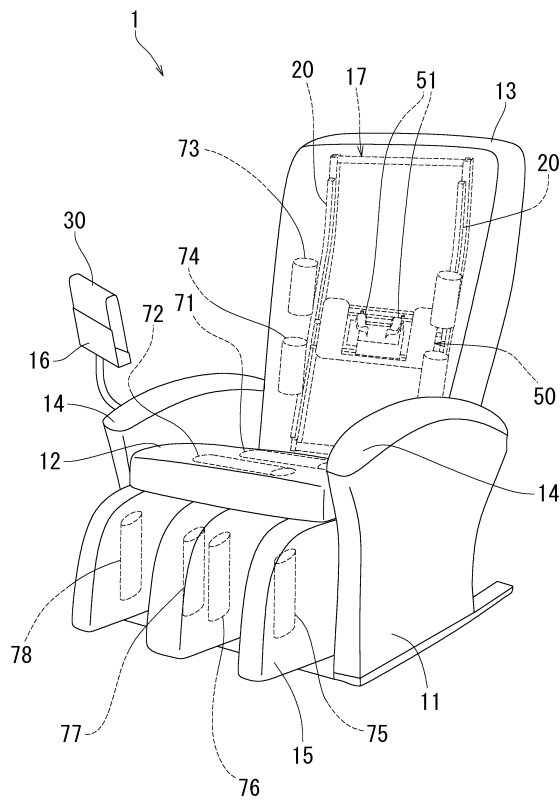


【図2】

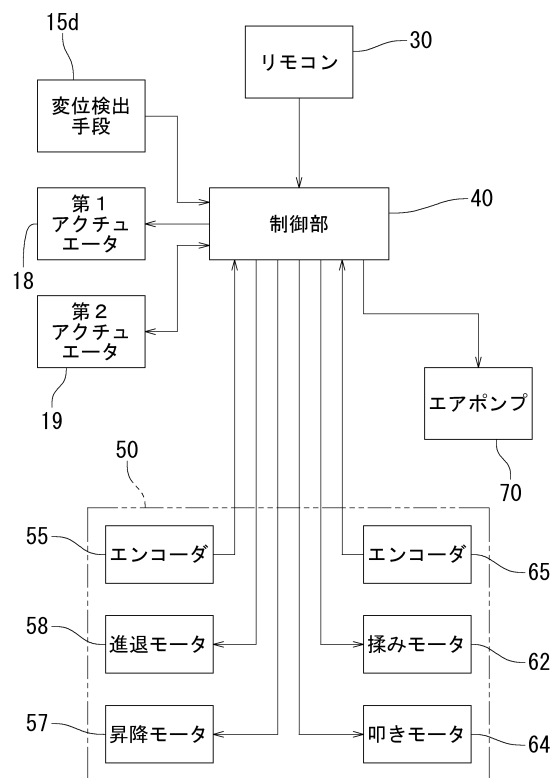

【図 3】

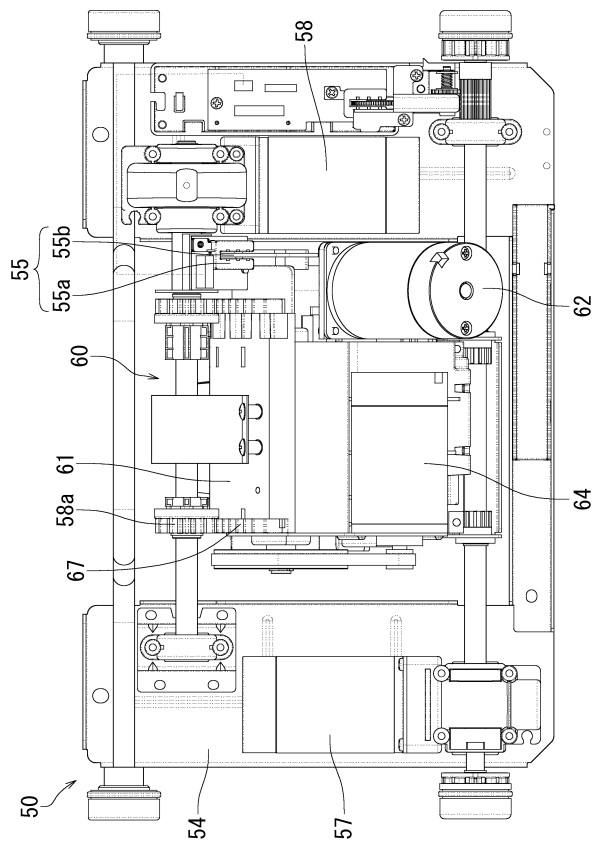


【図 4】

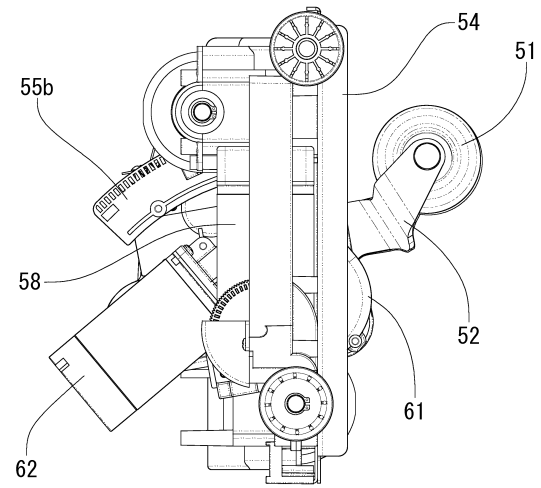


【図 5】

(A)

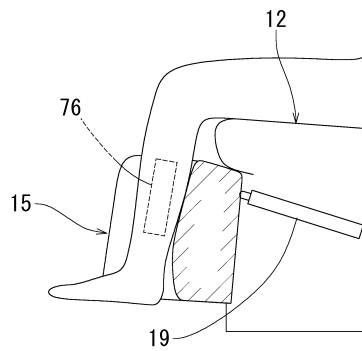


(B)

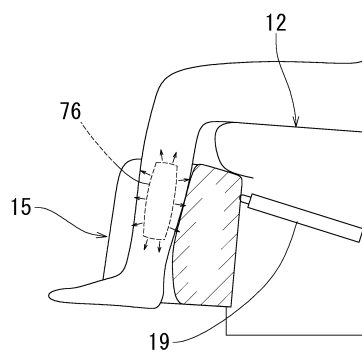


【図 6】


(A)

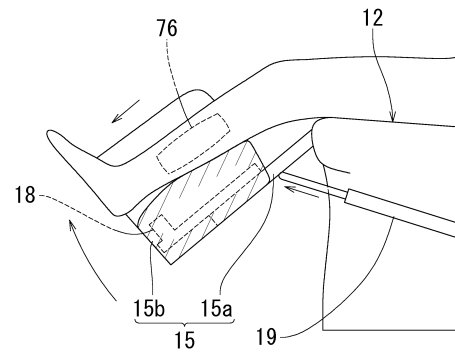


(B)

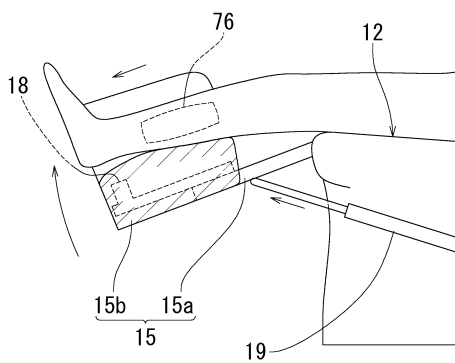


【図 7】

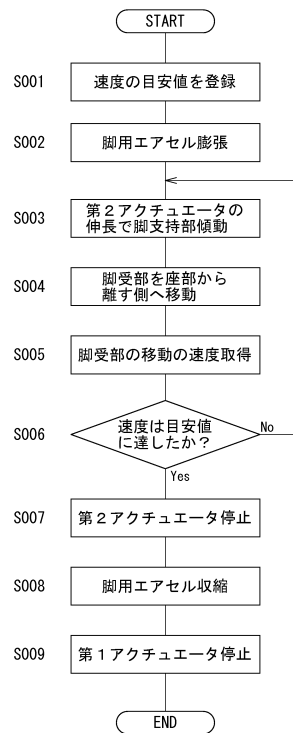

【図 8】

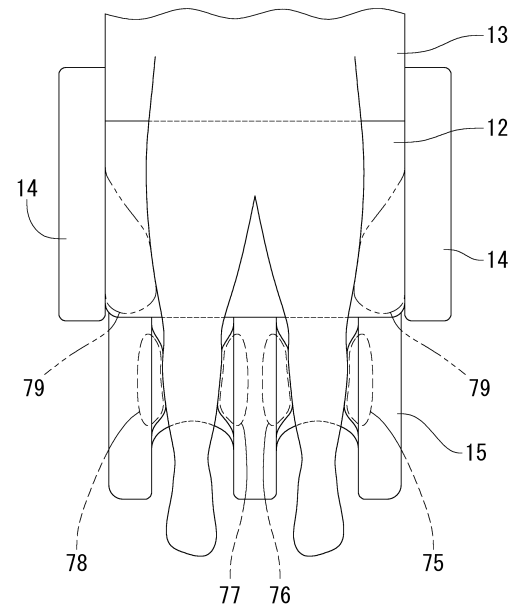


【図 9】

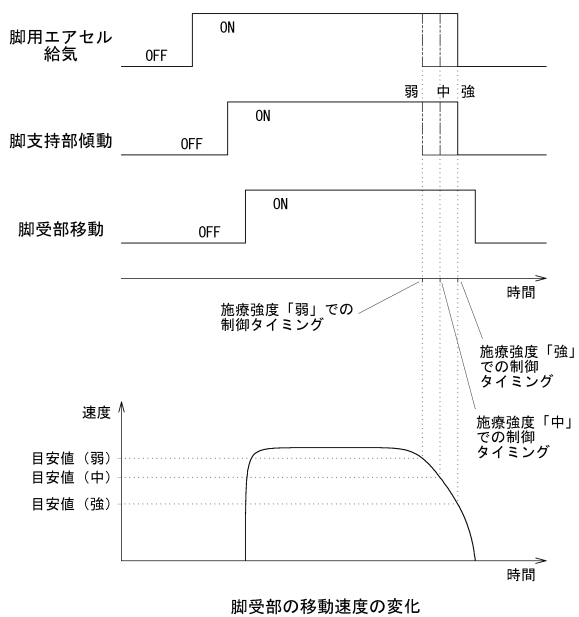


【図 10】

(A)

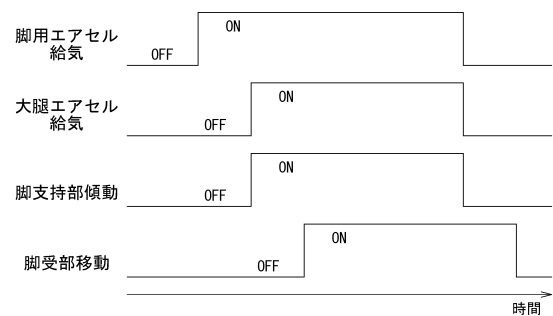


(B)

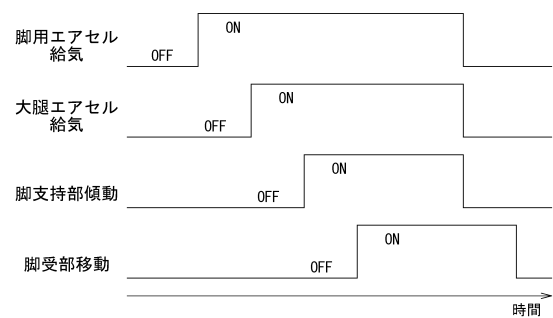


【図 1 1】


(A)

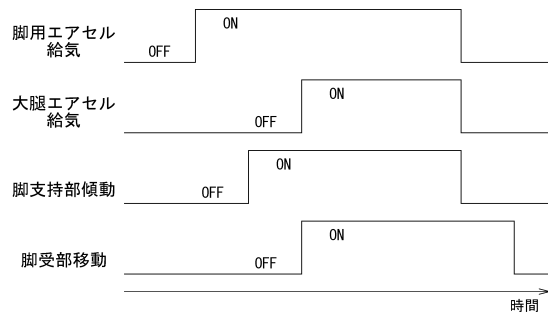

(B)

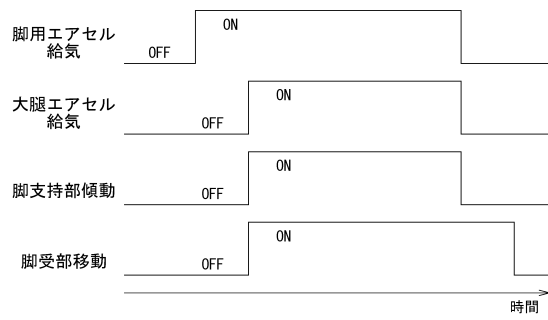


【図 1 3】

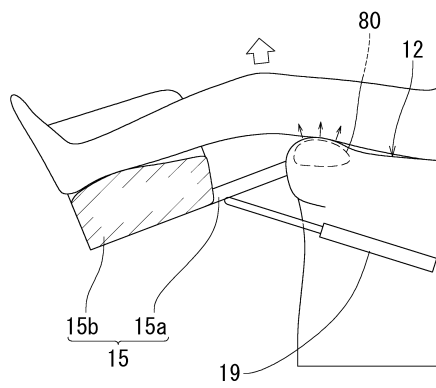


【図 1 2】


(A)

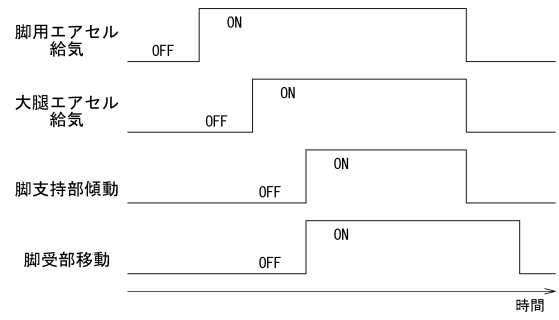


(B)

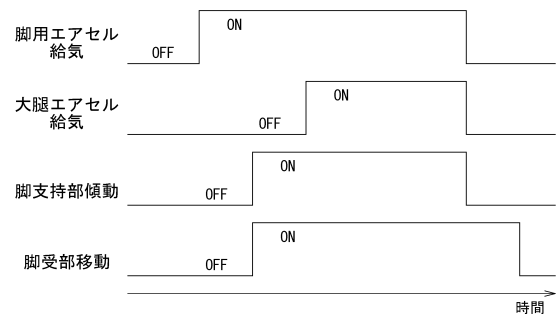


【図 1 4】

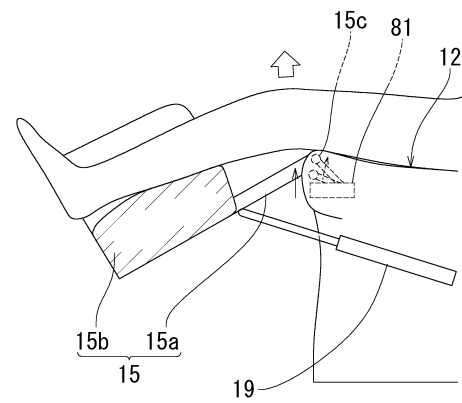


【図 15】

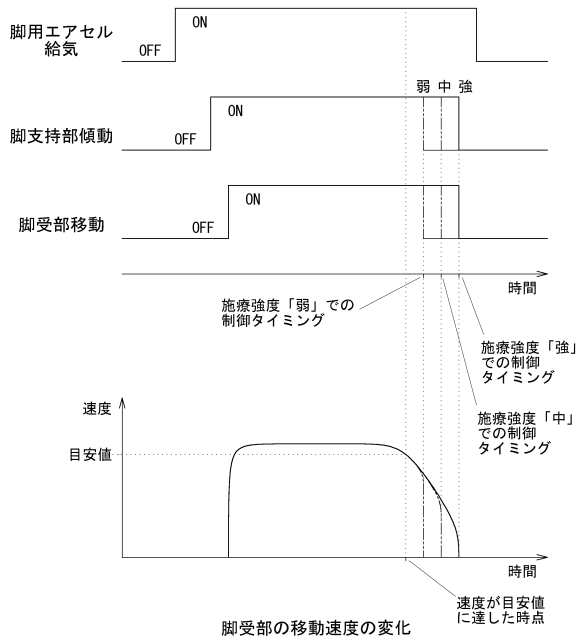


【図 16】

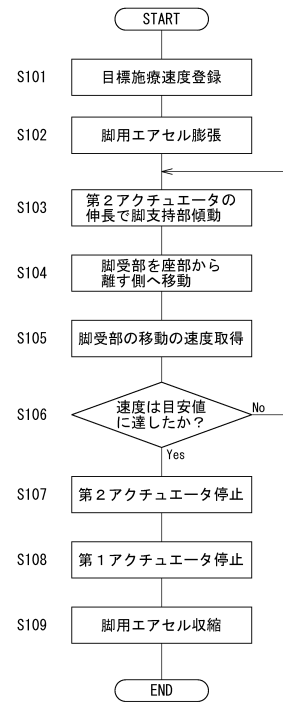


【図 17】

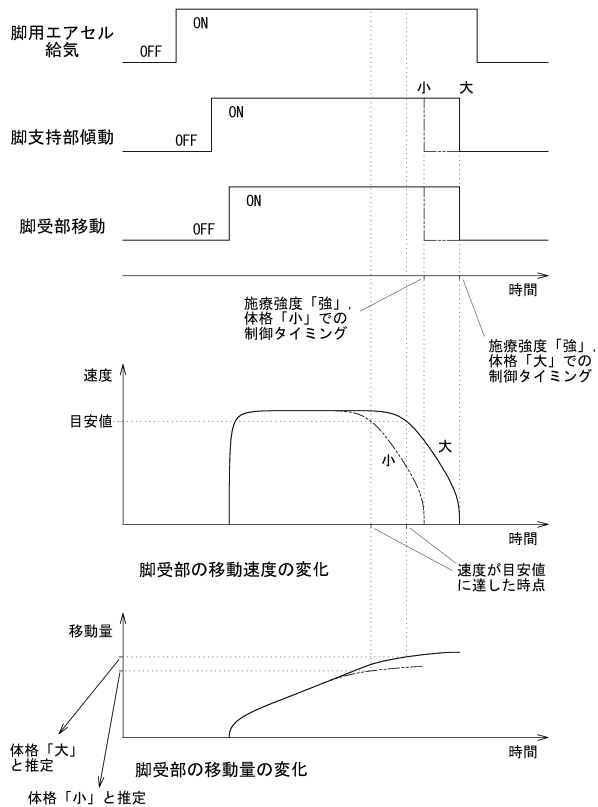

【図 18】

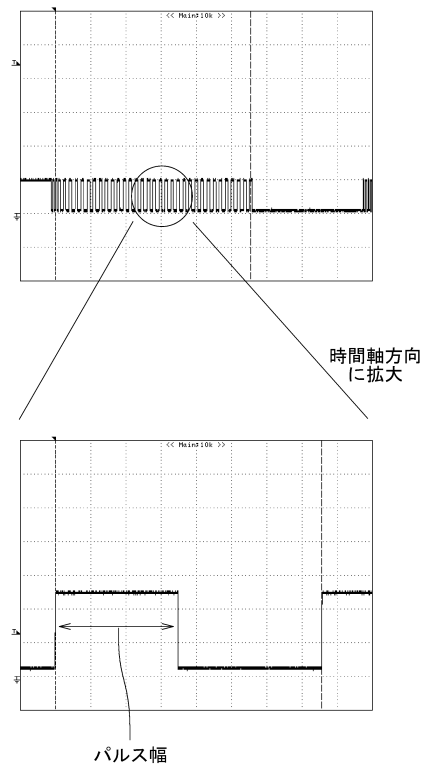


【図 19】

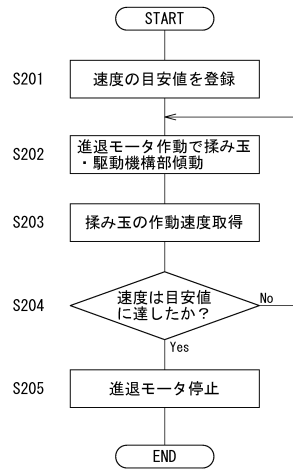


【図 20】


(A)

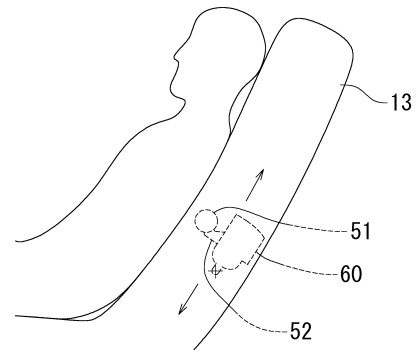

(B)

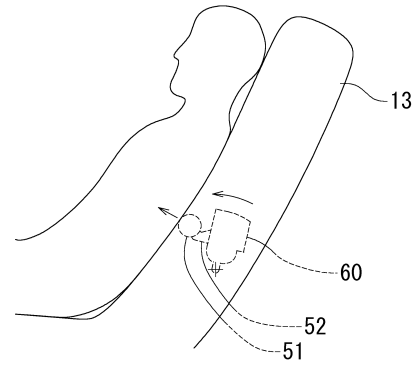

【図 21】

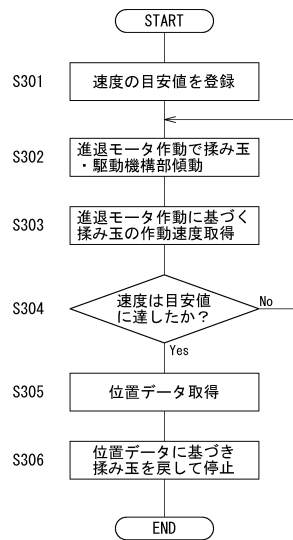

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開2008-092973 (JP, A)
特開2004-041383 (JP, A)
特開2005-334277 (JP, A)
特開平08-322895 (JP, A)
特開2010-082060 (JP, A)
特開2008-295878 (JP, A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A61H 7/00