



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202859738 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 10

(21) 申请号 201220530885. 2

(22) 申请日 2012. 10. 17

(73) 专利权人 兖矿集团有限公司

地址 273500 山东省济宁市邹城市凫山南路
298 号

(72) 发明人 沙海燕 杨瑞林 徐玉枝 王晓慧
谢素华 杨景东 刘小芹

(74) 专利代理机构 济宁众城专利事务所 37106
代理人 李效宁

(51) Int. Cl.

A61M 1/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

吸痰液体瓶固定器

(57) 摘要

一种吸痰液体瓶固定器, 有一个固定器主体, 固定器主体由在上的上圈和在下的下圈通过处于两侧的右立杆和左立杆连接构成, 固定器主体底部配有十字形底架, 固定器主体上部固定挂件, 挂件由挂钩连接两个相对的半圆环构成, 两个半圆环环绕固定器主体外周后尾端通过螺栓组件连接在一起。本实用新型能稳妥放置吸痰用各类液体瓶, 避免液体瓶倾倒, 利于液体瓶的固定, 使用方便。作为吸痰用液体瓶专用固定器具, 可广泛推广使用, 利于提高工作效率, 降低医院感染的发生率。

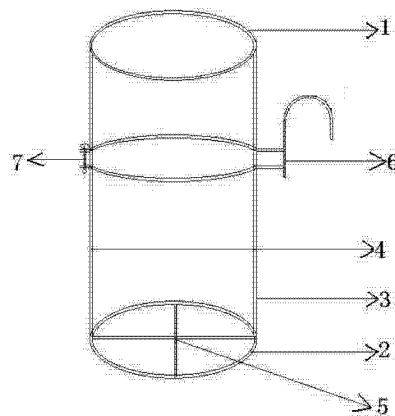

1. 一种吸痰液体瓶固定器,有一个固定器主体,其特征在于:固定器主体由在上的上圈(1)和在下的下圈(2)通过处于两侧的右立杆(3)和左立杆(4)连接构成,固定器主体底部配有十字形底架(5),固定器主体上部固定挂件(6),挂件(6)由挂钩连接两个相对的半圆环构成,两个半圆环环绕固定器主体外周后尾端通过螺栓组件(7)连接在一起。

吸痰液体瓶固定器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种吸痰液体瓶固定器,用于吸痰时生理盐水和消毒液瓶的放置、固定。

背景技术

[0002] 目前,临床护理操作中,吸痰用生理盐水和消毒液瓶放置固定时多采用系带的方法或直接放于床头桌上。上述两种方法存在的问题:一是液体瓶无特制系带凹槽,系带易脱落致液体瓶摔碎,造成环境污染,增加病人经济负担;二是床头桌面积有限,容易倾倒;三是护士使用不方便,容易对液体造成污染,增加了病人医院感染的发生率。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种吸痰液体瓶固定器,可直接将液体瓶放于固定器内固定于床栏上,临床使用方便。

[0004] 本实用新型的目的是以如下方式实现的:有一个固定器主体,固定器主体由在上的上圈和在下的下圈通过处于两侧的右立杆和左立杆连接构成,立杆也可以均布设置为 3 个或 4 个,固定器主体底部配有十字形底架,固定器主体上部固定挂件,挂件由挂钩连接两个相对的半圆环构成,两个半圆环环绕固定器主体外周后尾端通过螺栓组件连接在一起。固定器主体的内径略大于液体瓶瓶身直径,通过挂件直接固定于床栏上。

[0005] 本实用新型能稳妥放置吸痰用各类液体瓶,避免液体瓶倾倒,利于液体瓶的固定,使用方便。作为吸痰用液体瓶专用固定器具,可广泛推广使用,利于提高工作效率,降低医院感染的发生率。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 参照图 1,有一个固定器主体,固定器主体由在上的上圈 1 和在下的下圈 2 通过处于两侧的右立杆 3 和左立杆 4 连接构成,固定器主体底部配有十字形底架 5,固定器主体上部固定挂件 6,挂件 6 由挂钩连接两个相对的半圆环构成,两个半圆环环绕固定器主体外周后尾端通过螺栓组件 7 连接在一起。

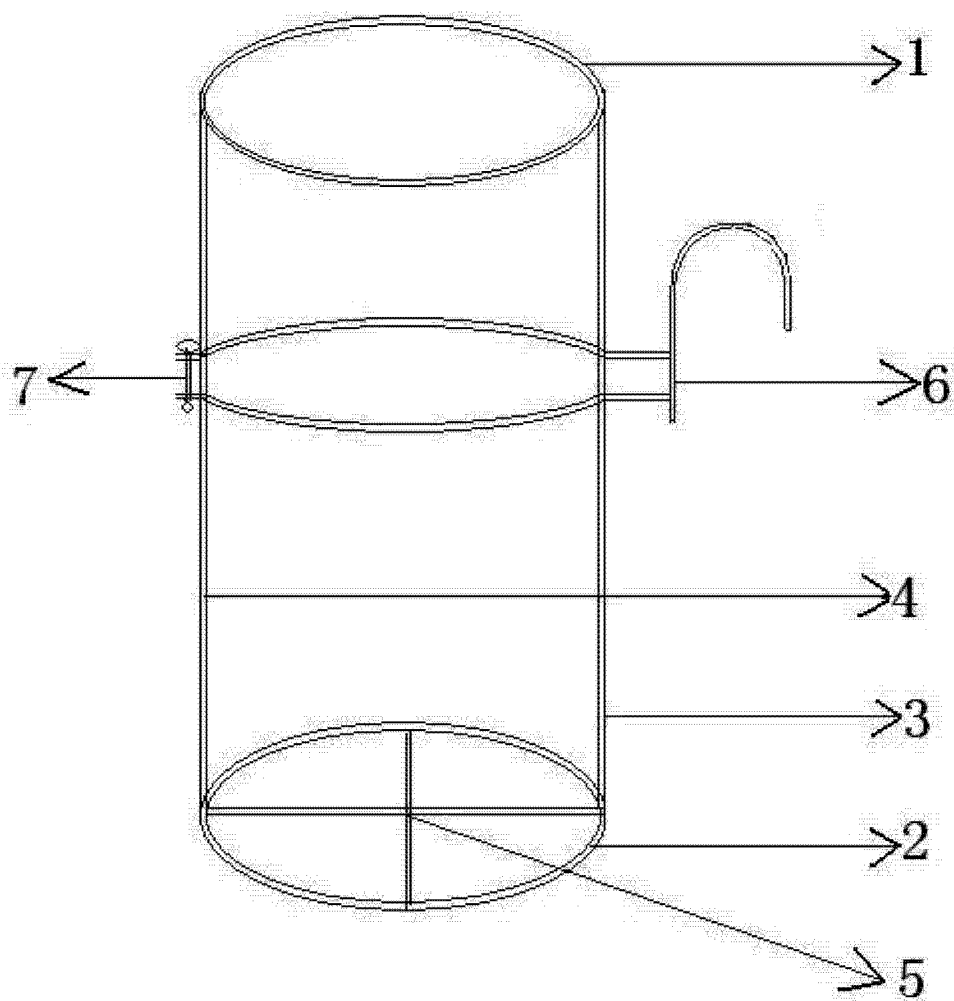


图 1