



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201469412 U

(45) 授权公告日 2010. 05. 19

(21) 申请号 200920168311. 3

(22) 申请日 2009. 07. 24

(73) 专利权人 孙明光

地址 274015 山东省菏泽市牡丹区康庄路
2111 号菏泽市牡丹人民医院脑电图科

(72) 发明人 孙明光

(51) Int. Cl.

A61B 19/00 (2006. 01)

A61B 5/0476 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型脑电图检查头部定位椅

(57) 摘要

新型脑电图检查头部定位椅,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括椅腿、椅座和靠背,其特征是在靠背上固定设有“U”形弹性槽。本实用新型结构简单,使用方便,在给病人做脑电图检查时能够牢固固定病人头部,探头安装定位准确,减轻了医务人员的工作难度。

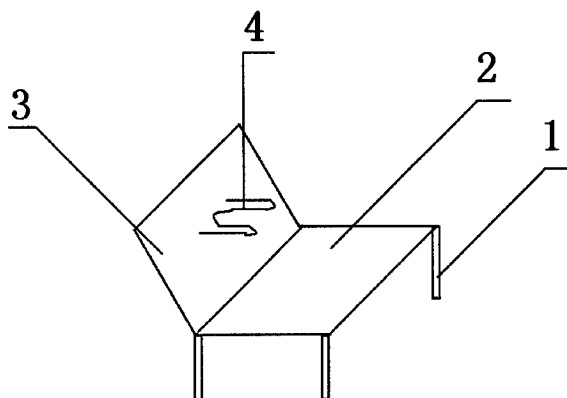

1. 新型脑电图检查头部定位椅,包括椅腿(1)、椅座(2)和靠背(3),其特征是:在靠背(3)上固定设有“U”形弹性槽(4)。

新型脑电图检查头部定位椅

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型脑电图检查头部定位椅。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行脑电图检查时所用的椅子都是普通的椅子，对病人的头部没有固定装置，做脑电图需要在病人头部安装探头，这样病人头部很容易晃动，而导致定位不准确，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人做脑电图检查时能够牢固固定病人头部，探头安装定位准确的新型脑电图检查头部定位椅。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括椅腿、椅座和靠背，其特征是在靠背上固定设有“U”形弹性槽。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在给病人做脑电图检查时能够牢固固定病人头部，探头安装定位准确，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、椅腿，2、椅座，3、靠背，4、“U”形弹性槽。

[0008] 具体实施方式：包括椅腿 1、椅座 2 和靠背 3，其特征是在靠背 3 上固定设有“U”形弹性槽 4。在给病人做脑电图检查时，病人头部置于 U”形弹性槽 4 内即可。

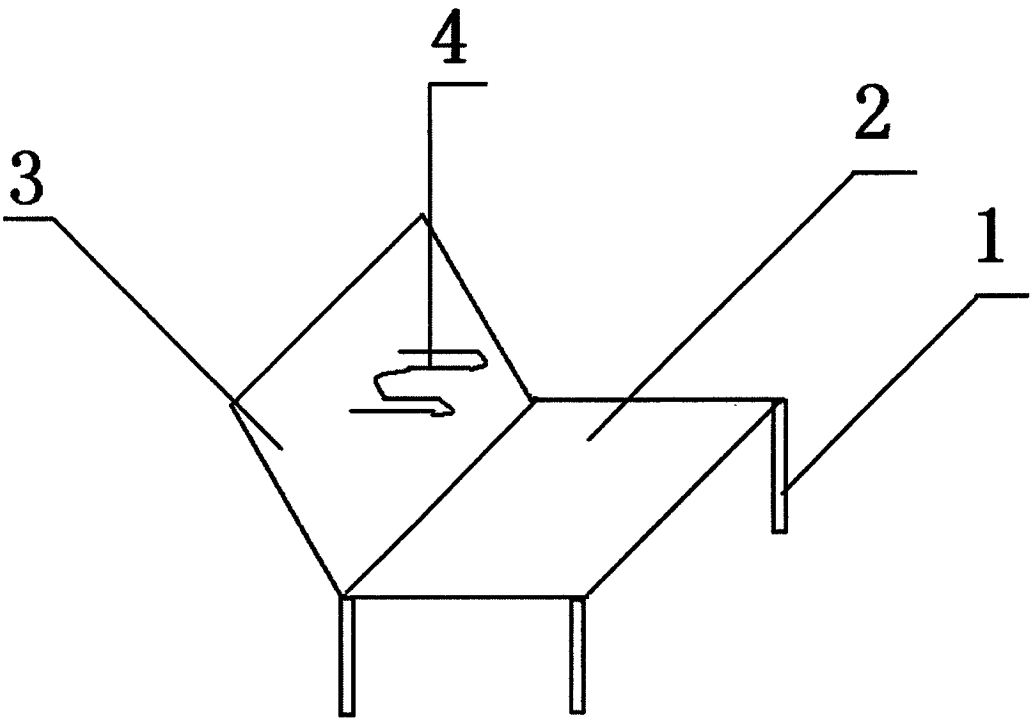


图 1