



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201602792 U

(45) 授权公告日 2010. 10. 13

(21) 申请号 201020117276. 5

(22) 申请日 2010. 02. 12

(73) 专利权人 蔡文利

地址 272051 山东省济宁市任城区李营镇岱
庄山东省安康医院

(72) 发明人 蔡文利

(51) Int. Cl.

A61B 8/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

皮肤表面 B 超耦合剂清除装置

(57) 摘要

皮肤表面 B 超耦合剂清除装置,属于医疗附属用品,是这样实现的:吸筒的两端封闭,在吸筒壁上设有吸液孔,在吸液孔上方,吸筒的中间位置设有与吸筒连通的连接管,导管的一端与连接管连通,导管的另一端与微型自吸泵的抽吸口连通,自吸泵上的出液口与出液管的一端连通,出液管的另一端设置在污物桶内。本实用新型结构简单,使用方便,在 B 超检查玩时,可将皮肤表面的 B 超耦合剂清除掉,不需要再用卫生纸来多次擦除。

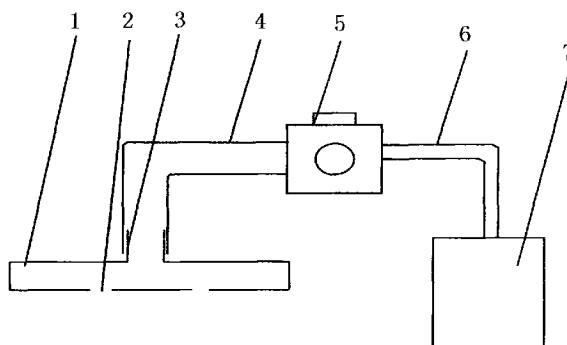

1. 皮肤表面B超耦合剂清除装置,由吸筒(1)、连接管(3)、导管(4)、微型自吸泵(5)、出液管(6)和污物桶(7)组成,其特征是:吸筒(1)的两端封闭,在吸筒壁上设有吸液孔(2),在吸液孔(2)上方,吸筒(1)的中间位置设有与吸筒(1)连通的连接管(3),导管(4)的一端与连接管(3)连通,导管(4)的另一端与微型自吸泵(5)的抽吸口连通,微型自吸泵(5)上的出液口与出液管(6)的一端连通,出液管(6)的另一端设置在污物桶(7)内。

皮肤表面 B 超耦合剂清除装置

技术领域：

[0001] 本实用新型属于医疗附属用品，特别是皮肤表面 B 超耦合剂清除装置。

背景技术：

[0002] 患者做完 B 超检查时，需要将皮肤表面的耦合剂要清除干净，目前大都是用卫生纸将耦合剂擦除掉，然后将擦过的卫生纸扔掉，扔掉的卫生纸如果带有病菌，则增加了病菌传染的可能性，也造成了资源的浪费；另外用卫生纸擦掉耦合剂也非常的麻烦。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型克服上述问题的不足，提供一种皮肤表面 B 超耦合剂清除装置，该装置结构简单，使用方便，在 B 超检查玩时，可将皮肤表面的 B 超耦合剂清除掉，不需要再用卫生纸来多次擦除。本实用新型是这样实现的：吸筒的两端封闭，在吸筒壁上设有吸液孔，在吸液孔上方，吸筒的中间位置设有与吸筒连通的连接管，导管的一端与连接管连通，导管的另一端与微型自吸泵的抽吸口连通，自吸泵上的出液口与出液管的一端连通，出液管的另一端设置在污物桶内。

[0004] 本实用新型结构简单，使用方便，在 B 超检查玩时，可将皮肤表面的 B 超耦合剂清除掉，不需要再用卫生纸来多次擦除。

附图说明：

[0005] 附图 1 是本实用新型的结构示意图；1、吸筒 2、吸液孔 3、连接管 4、导管 5、微型自吸泵 6、出液管 7、污物桶

具体实施方式：

[0006] 结合附图 1 实施例为：皮肤表面 B 超耦合剂清除装置，由吸筒 1、连接管 3、导管 4、微型自吸泵 5、出液管 6 和污物桶 7 组成，是这样实现的：吸筒 1 的两端封闭，在吸筒壁上设有吸液孔 2，在吸液孔 2 上方，吸筒 1 的中间位置设有与吸筒 1 连通的连接管 3，导管 4 的一端与连接管 3 连通，导管 4 的另一端与微型自吸泵 5 的抽吸口连通，微型自吸泵 5 上的出液口与出液管 6 的一端连通，出液管 6 的另一端设置在污物桶 7 内。

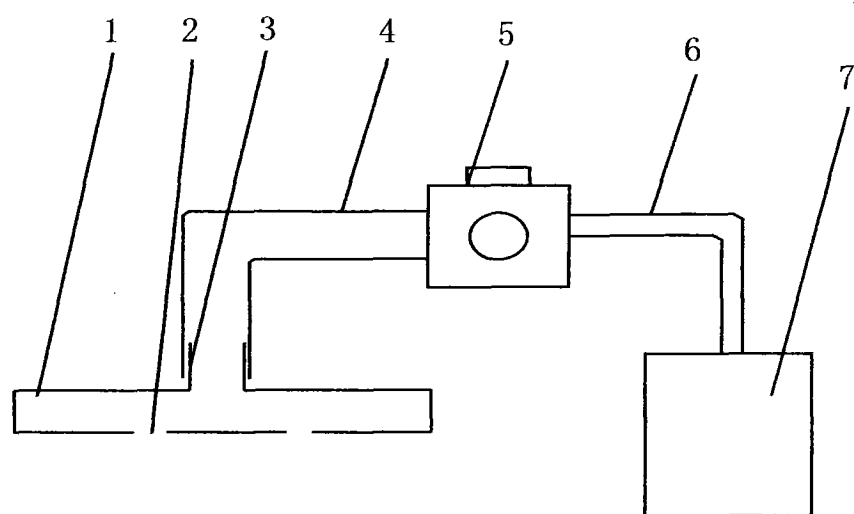


图 1