

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2017年3月23日(23.03.2017)



(10) 国際公開番号

WO 2017/047715 A1

- (51) 国際特許分類:
A61F 2/16 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2016/077328
- (22) 国際出願日: 2016年9月15日(15.09.2016)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2015-182569 2015年9月16日(16.09.2015) JP
- (71) 出願人: H O Y A 株式会社(HOYA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1608347 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 工藤 和徳(KUDO Kazunori); 〒1608347 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 H O Y A 株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 阿仁屋 節雄, 外(ANIYA Setuo et al.); 〒1020072 東京都千代田区飯田橋四丁目6番1号 2 1 東和ビル3 F Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,

BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.


- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: INTRAOCULAR LENS INSERTION TOOL

(54) 発明の名称: 眼内レンズ挿入器具

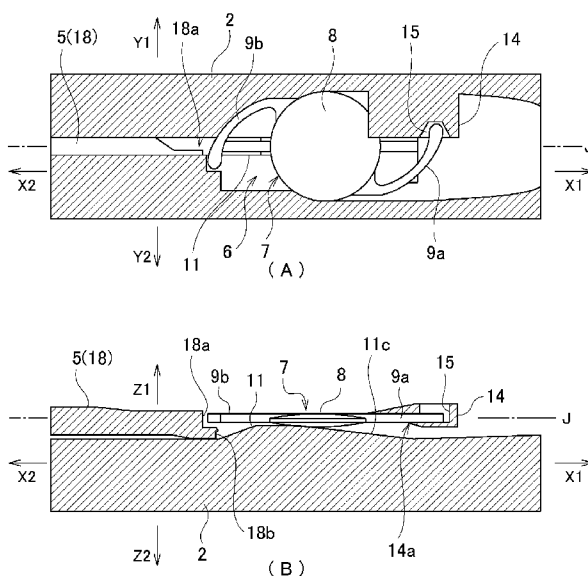

(57) Abstract: Provided is an intraocular lens insertion tool 1 for inserting, into an eye, an intraocular lens 7 that has an optical unit 8 and a pair of support parts 9a, 9b extending from the optical unit 8, wherein the intraocular lens insertion tool 1 is provided with: an insertion tool body 2 provided with a lens arrangement part 6 on which the intraocular lens 7 is arranged; a holding part 14 for holding the distal-end part of a forward support part 9a disposed forward from the lens arrangement part 6 among the pair of support parts 9a, 9b; and guide mechanisms (11c, 14a) for guiding the optical unit 8 such that, when the intraocular lens 7 is extruded by an extrusion member 5, the intraocular lens 7 passes underneath the holding part 14, the guide mechanisms (11c, 14a) causing the optical unit 8 to be displaced downward relative to the forward support part 9a held by the holding part 14.

(57) 要約: 光学部 8 とそこから延在する一対の支持部 9 a, 9 b とを有する眼内レンズ 7 を眼内に挿入する眼内レンズ挿入器具 1 であって、眼内レンズ 7 が設置されるレンズ設置部 6 が設けられた挿入器具本体 2 と、一対の支持部 9 a, 9 b のうちレンズ設置部 6 の前方に配置される前方支持部 9 a の先端部を保持する保持部 1 4 と、この保持部 1 4 に保持された前方支持部 9 a に対して光学部 8 を相対的に下方に変位させるべく、押出部材 5 によって眼内レンズ 7 を押し出す際に、保持部 1 4 の下を通過するように光学部 8 をガイドする

ガイド機構 (1 1 c、1 4 a) と、を備える。

WO 2017/047715 A1

明 細 書

発明の名称：眼内レンズ挿入器具

技術分野

[0001] 本発明は、眼内レンズを眼内に挿入するときに用いられる眼内レンズ挿入器具に関する。

背景技術

[0002] 白内障手術の一つとして、白く濁った水晶体を超音波乳化吸引術によって摘出し、その後で眼内に眼内レンズを挿入することが広く行われている。また近年では、眼への負担が少ない低侵襲の白内障手術を実現するために、シリコンエラストマーや軟質アクリル等の軟性材料からなるワンピースタイプの眼内レンズを、小さく折り畳んだ状態で眼内に挿入することが行われている。ワンピースタイプの眼内レンズは、レンズ機能を果たす光学部と、この光学部から延在する一对の支持部とを有し、眼内レンズ全体が軟性材料によって構成されている。

[0003] また、ワンピースタイプの眼内レンズを取り扱う眼内レンズ挿入器具には、できるだけ術者の眼内レンズ挿入操作性を向上させるために、一对の支持部を光学部で抱き込むように眼内レンズを折り畳む機能を備えたものがある（たとえば、特許文献1を参照）。この種の眼内レンズ挿入器具では、各々の支持部の先端部を光学部の面上に乗せた状態で、光学部を丸く折り畳む必要がある。また、従来の眼内レンズ挿入器具のなかには、眼内レンズを押し出す押出部材を備え、この押出部材によって眼内レンズを押し出すときに眼内レンズを折り畳むものがある。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特開2011-255029号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] しかしながら、従来の眼内レンズ挿入器具においては、押出部材で眼内レンズを押し出すときに、支持部の先端部が光学部の縁に引っ掛かるなどして、支持部の先端部が光学部の面上にスムーズに乗らないことがあった。

[0006] 本発明の主な目的は、支持部を光学部で抱き込むように眼内レンズを折り畳むときに、支持部の先端部を光学部の面上に確実に乗せることができる眼内レンズ挿入器具を提供することにある。

課題を解決するための手段

[0007] (第1の態様)

本発明の第1の態様は、

光学部と当該光学部から延在する一对の支持部とを有する眼内レンズを眼内に挿入する眼内レンズ挿入器具であって、

前記眼内レンズが設置されるレンズ設置部が設けられた挿入器具本体と、

前記一对の支持部のうち前記レンズ設置部の前方に配置される前方支持部の先端部を保持する保持部と、

前記保持部に保持された前記前方支持部に対して前記光学部を相対的に下方に変位させる変位機構と、

を備えることを特徴とする眼内レンズ挿入器具である。

(第2の態様)

本発明の第2の態様は、

前記挿入器具本体の中心軸方向に移動することにより前記レンズ設置部から前記眼内レンズを押し出す押出部材を備え、

前記変位機構は、前記押出部材によって前記眼内レンズを押し出す際に、前記保持部の下を通過するように前記光学部をガイドするガイド機構を備える

ことを特徴とする上記第1の態様に記載の眼内レンズ挿入器具である。

(第3の態様)

本発明の第3の態様は、

前記保持部は、前記前方支持部の先端部を離脱可能に収容する収容部を有

し、

前記押出部材に押されて前記光学部が前記保持部の下を通過するときに、前記前方支持部の先端部が前記収容部から離脱するように構成されていることを特徴とする上記第 2 の態様に記載の眼内レンズ挿入器具である。

(第 4 の態様)

本発明の第 4 の態様は、

前記ガイド機構は、水平面に対して傾斜する状態で前記保持部の下面に形成された第 1 ガイド部と、この第 1 ガイド部に対向する位置に当該第 1 ガイド部と同じ向きに傾斜する状態で形成された第 2 ガイド部とを含む

ことを特徴とする上記第 2 の態様に記載の眼内レンズ挿入器具である。

(第 5 の態様)

本発明の第 5 の態様は、

前記押出部材は、前記第 2 ガイド部の傾斜に沿って下方に変位しつつ前記眼内レンズを押し出すロッド部を有する

ことを特徴とする上記第 4 の態様に記載の眼内レンズ挿入器具である。

(第 6 の態様)

本発明の第 6 の態様は、

前記レンズ設置部に前記眼内レンズが予め設置されたプリロードタイプである

ことを特徴とする上記第 1 ～第 5 の態様のいずれか 1 つに記載の眼内レンズ挿入器具である。

(第 7 の態様)

本発明の第 7 の態様は、

前記レンズ設置部では、前記眼内レンズが無負荷状態で設置される

ことを特徴とする上記第 1 ～第 6 の態様のいずれか 1 つに記載の眼内レンズ挿入器具である。

発明の効果

[0008] 本発明によれば、支持部を光学部で抱き込むように眼内レンズを折り畳む

ときに、支持部の先端部を光学部の面上に確実に乗せることができる。

図面の簡単な説明

[0009] [図1]本発明の実施形態に係る眼内レンズ挿入器具の全体構成を示す斜視図である。

[図2]本発明の実施形態に係る眼内レンズ挿入器具の全体構成を示す側断面図である。

[図3] (A) は本発明の実施形態に係る眼内レンズ挿入器具の要部構成を示す平断面図であり、(B) は当該要部構成を示す側断面図である。

[図4] (A) はロッド部の進行方向に形成された突出ガイドの形状を説明する斜視図であり、(B) は突出ガイドの頂上部における断面形状を示す図であり、(C) は突出ガイドを通過するロッド部の断面形状を示す図である。

[図5] (A) ～ (D) は操作部の回転操作にともなう押出部材の移動の様子を時系列で示す図である。

[図6] (A) ～ (D) はロッド部の先端部が突出ガイドの形状にしたがって上下方向に変位する様子を時系列に示す図である。

[図7] (A) は突出ガイドの頂上部における断面形状を示す斜視図であり、(B) は同正面図である。

[図8] (A) は突出ガイドの頂上部における断面形状を示す斜視図であり、(B) は同正面図である。

[図9] (A) ～ (D) は押出部材によって押し出される眼内レンズの移動の様子を時系列で示す平断面図である。

[図10] (A) ～ (D) は押出部材によって押し出される眼内レンズの移動の様子を時系列で示す側断面図である。

[図11] (A) ～ (D) は押出部材によって押し出される眼内レンズの移動の様子を時系列で示す斜視図である。

発明を実施するための形態

[0010] 以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。

本発明の実施形態においては、次の順序で説明を行う。

1. 眼内レンズ挿入装置の構成
2. 眼内レンズ挿入器具の組立方法
3. 眼内レンズ挿入装置の動作
4. 実施形態の効果
5. 変形例等

[0011] <1. 眼内レンズ挿入装置の構成>

図1は本発明の実施形態に係る眼内レンズ挿入器具の全体構成を示す斜視図であり、図2は本発明の実施形態に係る眼内レンズ挿入器具の全体構成を示す側断面図である。また、図3（A）は本発明の実施形態に係る眼内レンズ挿入器具の要部構成を示す平断面図であり、同図（B）は当該要部構成を示す側断面図である。

[0012] 図示した眼内レンズ挿入器具1は、ディスポーザブル（使い捨て）の製品として提供されるものであって、眼内レンズを眼内に挿入する際に用いられる。眼内レンズ挿入器具1は、大きくは、挿入器具本体2と、操作部3と、挿入筒4と、押出部材5と、を備えている。眼内レンズ挿入器具1の各部は樹脂で構成されている。眼内レンズ挿入器具1は、予め眼内レンズが設置されたプリロードタイプとなっている。プリロードタイプの眼内レンズ挿入器具1では、眼内レンズ挿入器具1を工場から出荷する段階で、後述するレンズ設置部に予め眼内レンズが設置された状態となる。

[0013] 本実施形態においては、眼内レンズ挿入器具1の各部の相対的な位置関係や動作の方向などを明確にするために、X1方向を先端側（前方）、X2方向を後端側（後方）、Y1方向を左側（左方）、Y2方向を右側（右方）、Z1方向を上側（上方）、Z2方向を下側（下方）とする。このうち、X1方向およびX2方向は、眼内レンズ挿入器具1の中心軸方向（以下、単に「中心軸方向」ともいう。）に相当し、Y1方向およびY2方向は、眼内レンズ挿入器具1の幅方向（左右方向）に相当し、Z1方向およびZ2方向は、眼内レンズ挿入器具1の高さ方向（上下方向）に相当する。また、X1方向、X2方向、Y1方向およびY2方向に平行な平面な水平面とし、これと直

角をなす平面を垂直面とする。図中の符号 J は、眼内レンズ挿入器具 1 の中心軸を示している。

[0014] (挿入器本体)

挿入器具本体 2 は、全体に筒状に形成されている。挿入器具本体 2 の内部には、X 1 方向および X 2 方向への押出部材 5 の移動を許容する中空部が形成されている。挿入器具本体 2 の先端部にはレンズ設置部 6 が設けられている。レンズ設置部 6 は、挿入器具本体 2 の下側の外周壁から前方に突き出すように形成されている。眼内レンズ 7 は、このレンズ設置部 6 に設置されている。眼内レンズ挿入器具 1 の中心軸 J は、挿入器具本体 2、操作部 3 および挿入筒 4 の各中心軸に一致している。

[0015] 本実施形態においては、一例として、シリコンエラストマーや軟質アクリルなどの軟性材料からなるワンピースタイプの眼内レンズ 7 を取り扱うものとする。眼内レンズ 7 は、光学的な機能を果たす光学部 8 と、この光学部 8 の外周縁から外向きに弧状に延在する一対（2 つ）の支持部 9 a、9 b と、を有している。光学部 8 は、平面視円形に形成されている。一対の支持部 9 a、9 b は、それぞれ細長い腕状に形成されている。なお、図 2 では眼内レンズ 7 の表記を省略している。

[0016] ここで、レンズ設置部 6 の構成について、図 3 および図 4 を用いて詳しく説明する。

レンズ設置部 6 には突出ガイド 11 が形成されている。突出ガイド 11 は、レンズ設置部 6 の一部を上方に突出させた状態で、側面視台形状（山形）に形成されている。図 4（B）は突出ガイド 11 の形成部位を中心軸方向（正面）から見たときの断面図である。この図から分かるように、突出ガイド 11 の形成部位には凹状の溝 12 が形成されている。突出ガイド 11 は、傾斜がついた上りの傾斜部 11 a と、傾斜がつかない頂上部 11 b と、傾斜部 11 a よりも緩やかな傾斜がついた下りの傾斜部 11 c と、を有している。突出ガイド 11 は、図 4（A）に示すように、眼内レンズ挿入器具 1 の後端側から先端側に向かって、はじめは上りの傾斜部 11 a になっていて、頂上

部 1 1 b を過ぎると、緩やかな下りの傾斜部 1 1 c になっている。溝 1 2 の深さが最も深くなるのは、突出ガイド 1 1 の頂上部 1 1 b であり、上記図 4 (B) はこの頂上部 1 1 b の断面を示している。

なお、図 4 (A) , (B) における符号 2 a は、挿入器具本体 2 の一部を仮想的に切り出して示したものであり、挿入器具本体 2 の一部が図示のような形状をしているわけではない。この点は、図 6 ~ 図 8 についても同様である。

[0017] また、レンズ設置部 6 には、図示しない一对の凹溝が形成されている。一对の凹溝は、挿入器具本体 2 のレンズ設置部 6 を区画する左右の側壁部に、互いに対向する状態で形成されるものである。一对の凹溝は、レンズ設置部 6 に眼内レンズ 7 を設置する際に、光学部 8 の外周縁の一部を嵌合することにより、光学部 8 の上下方向の動きを規制する。

[0018] 保持部 1 4 は、レンズ設置部 6 を区画する左右の側壁部のうち、左側の側壁部を部分的に突出させた状態で形成されている。保持部 1 4 の下面の一部は、傾斜面 1 4 a (図 3 (B) 参照) となっている。保持部 1 4 の傾斜面 1 4 a は、「第 1 ガイド部」の一例として保持部 1 4 の下面に形成されている。これに対して、上述した突出ガイド 1 1 の下りの傾斜部 1 1 c は、「第 2 ガイド部」の一例としてレンズ設置部 6 に形成されている。ここで記述する第 1 ガイド部および第 2 ガイド部は、レンズ設置部 6 に設置された眼内レンズ 7 を押出部材 5 で押し出す際に、保持部 1 4 の下を通過するように光学部 8 をガイドするガイド機構を構成する要素となる。

[0019] 傾斜面 1 4 a は、水平面に対して傾斜する状態で形成されている。具体的には、傾斜面 1 4 a は、水平面に対して傾斜面 1 4 a の前方が後方よりも低位となるように傾斜している。また、傾斜面 1 4 a は、上下方向で突出ガイド 1 1 の傾斜部 1 1 c と対向する状態に配置されている。傾斜面 1 4 a と傾斜部 1 1 c とは、互いに同じ向きに傾斜している。

[0020] また、保持部 1 4 には、収容部 1 5 が形成されている。収容部 1 5 は、レンズ設置部 6 に眼内レンズ 7 を設置する場合に、支持部 9 a の先端部を離脱

可能に収容するものである。収容部 15 は、保持部 14 の上面の右端部に、上方および右方を開放する状態で凹状に形成されている。

[0021] また、レンズ設置部 6 の先端側では、レンズ設置部 6 を区画する左右の側壁部の対向距離が徐々に狭まっている。これは、眼内レンズ 7 の光学部 8 を左右の側壁部によって少し丸めた状態で挿入筒 4 に受け渡すためである。

[0022] 上記構成からなるレンズ設置部 6 に対して、眼内レンズ 7 は、一方の支持部 9 a をレンズ設置部 6 の前方に配置し、他方の支持部 9 b をレンズ設置部 6 の後方に配置した状態で設置される。このため、一方の支持部 9 a は「前方支持部」に相当し、他方の支持部 9 b は「後方支持部」に相当する。また、レンズ設置部 6 においては、眼内レンズ 7 の光学部 8 が突出ガイド 11 の頂上部 11 b にほぼ水平な状態で設置（載置）される。

[0023] また、レンズ設置部 6 に眼内レンズ 7 を設置した状態では、図 3（A）に示すように、保持部 14 の一部と光学部 8 の一部とが平面的に重なった状態で配置される。具体的には、保持部 14 の傾斜面 14 a の下に光学部 8 の外周部の一部が重なって配置される。また、レンズ設置部 6 に眼内レンズ 7 を設置した状態では、支持部 9 a の先端部を保持部 14 の収容部 15 に収容することにより、中心軸方向に対する支持部 9 a の移動と、前方および後方への支持部 9 a の移動が、それぞれ規制される。

[0024] （操作部）

操作部 3 は、挿入器具本体 2 の後端部に同軸上に連結されている。この連結状態において、操作部 3 は、挿入器具本体 2 の中心軸回りに回転自在に支持される。操作部 3 は、円筒状に形成されている。操作部 3 の外周面には、複数の突条部 3 a が形成されている。各々の突条部 3 a は、操作部 3 の長手方向と平行に形成されている。操作部 3 は、押出部材 5 で眼内レンズ 7 を押し出す際に、術者などのユーザーによって回転操作される部分となる。その際、操作部 3 の外周部に複数の突条部 3 a を形成しておけば、ユーザーの指が突条部 3 a に引っ掛かるため、操作部 3 を回転操作しやすくなる。

[0025] 操作部 3 の内周面には、上記図 2 に示すように、第 1 のネジ部 3 b が形成

されている。第1のネジ部3bは、雌ネジを構成している。第1のネジ部3bは、操作部3の中心軸方向のほぼ全般にわたって形成されている。操作部3の後端部には、突き当て部3cが形成されている。突き当て部3cは、操作部3の後端部の開口径を小さく絞るように内側に曲げて形成されている。突き当て部3cは、プランジャ部17が操作部3の後端部よりも後方に突出しないように、プランジャ部17の後端部が突き当てられる部分となる。

[0026] (挿入筒)

挿入筒4は、レンズ設置部6に設置された眼内レンズ7を眼内に挿入する際に、眼内レンズ7を小さく折り畳んだ状態で眼内に導くためのものである。挿入筒4は、中空の挿入筒本体4aと、細い管状のノズル部4bと、を一体に有している。挿入筒4は、挿入器具本体2の先端部に装着されている。この装着状態において、挿入器具本体2のレンズ設置部6は、挿入筒4の挿入筒本体4a内に収容して配置されている。

[0027] 挿入筒本体4aの上壁には注入部4cが形成されている。注入部4cは、粘弾性物質（たとえば、ヒアルロン酸ナトリウムなど）を注入するためのものである。注入部4cから注入された粘弾性物質は、レンズ設置部6に設置された眼内レンズ7の近傍に放出され、これによって眼内レンズ7に粘弾性物質が供給される。粘弾性物質の注入は、押出部材5によって眼内レンズ7を押し出す前に行われる。

[0028] 挿入筒本体4aの先端側は徐々に径が小さくなっている。ノズル部4bは、挿入筒4の先端部に形成されている。ノズル部4bの先端部は斜めの切り口で開口している。このため、ノズル部4bの開口は、斜め下方を向いている。ノズル部4bの先端部は、眼内レンズ挿入器具1を用いて眼内レンズ7を眼内に挿入する際に、眼球の切開創に差し込まれる部分となる。

[0029] (押出部材)

押出部材5は、挿入器具本体2の中心軸方向に移動可能に設けられている。押出部材5は、挿入器具本体2の中心軸方向に移動することにより、レンズ設置部6から眼内レンズ7を押し出すものである。その際、押出部材5は

、挿入器具本体 2 と操作部 3 と挿入筒 4 とが形成する中空部内を移動する。

[0030] 押出部材 5 は、プランジャ部 17 と、ロッド部 18 と、を有している。プランジャ部 17 とロッド部 18 とは、一体構造で押出部材 5 を構成するものであってもよいし、プランジャ部 17 とロッド部 18 をそれぞれ別体構造とし、これらを相互に組み付けることで押出部材 5 を構成するものであってもよい。眼内レンズ挿入器具 1 の中心軸方向において、プランジャ部 17 は相対的に後方に配置され、ロッド部 18 は相対的に前方に配置されている。

[0031] プランジャ部 17 は棒状に形成されている。プランジャ部 17 は、使用前の初期状態では、操作部 3 の後端部から突出しないように操作部 3 の内部に挿入した状態で配置される。プランジャ部 17 の後端部には第 2 のネジ部 17 a が形成されている。第 2 のネジ部 17 a は、雄ネジを構成している。第 2 のネジ部 17 a は、操作部 3 の内側で第 1 のネジ部 3 b と噛み合っている。眼内レンズ挿入器具 1 を使用する場合は、操作部 3 を挿入器具本体 2 の中心軸回りに回転させるように操作し、これによって押出部材 5 全体を前方に移動させることになる。そのときのプランジャ部 17 の移動開始位置は、プランジャ部 17 の後端部を操作部 3 の突き当て部 3 c に突き当てることで一義的に決まる。

[0032] ロッド部 18 は、レンズ設置部 6 に設置された眼内レンズ 7 を前方に押し出すことにより、眼内レンズ 7 を所定の形状に折り畳み、この状態で眼内レンズ 7 を挿入筒 4 のノズル部 4 b の開口部から放出させるものである。ロッド部 18 は、プランジャ部 17 よりも細い棒状に形成されている。ロッド部 18 は、適度な可撓性を有するように弾性変形可能に構成されている。ロッド部 18 の先端部には、第 1 接触部 18 a と第 2 接触部 18 b とが形成されている。眼内レンズ 7 を押出部材 5 のロッド部 18 の先端で押し出す場合、第 1 接触部 18 a は支持部 9 b に接触し、第 2 接触部 18 b は光学部 8 に接触する部分となる。第 2 接触部 18 b の上端部は、光学部 8 の縁を把持できるように、庇状に突出している。ロッド部 18 の下面には、図 4 (C) に示すように突起 19 が形成されている。突起 19 は、ロッド部 18 の長さ方向

において、第1接触部18aおよび第2接触部18bの形成部位を避けて、当該形成部位よりもロッド部18の後端側に形成されている。

[0033] <2. 眼内レンズ挿入器具の組立方法>

次に、眼内レンズ挿入器具1の組立方法について説明する。

まず、眼内レンズ挿入器具1を構成する部材(2, 3, 4, 5)を用意したら、操作部3に押出部材5を取り付ける。具体的には、押出部材5のプランジャ部17の後端部に操作部3の先端の開口部をかぶせるように嵌め込んで、操作部3を回転させる。これにより、操作部3の内周面に形成した第1のネジ部3bと、プランジャ部17の後端部に設けた第2のネジ部17aとが互いに噛み合う。このため、押出部材5の回転を規制しながら操作部3を回転させると、操作部3の回転にしたがってプランジャ部17が操作部3の内部に挿入されていく。このとき、プランジャ部17の後端部が操作部3の突き当て部3cに突き当たるまで、操作部3を回転させる。

[0034] 次に、操作部3に挿入器具本体2を取り付ける。このとき、押出部材5のロッド部18を挿入器具本体2の中空部に挿入する。これにより、ロッド部18の先端部(18a, 18b)は、レンズ設置部6の少し手前に配置される。

[0035] 次に、別途用意した眼内レンズ7を挿入器具本体2のレンズ設置部6に設置する。このとき、眼内レンズ7の光学部8は突出ガイド11の頂上部11bにほぼ水平に載置する。また、一方の支持部9aはレンズ設置部6の前方に配置し、そこで支持部9aの先端部を保持部14の収容部15に収容する。

[0036] このようにレンズ設置部6に眼内レンズ7を設置した状態では、眼内レンズ7が無負荷状態となる。無負荷状態とは、眼内レンズにほとんど負荷(圧力)がかかっていない状態、すなわち眼内レンズが本来の形状を維持している状態をいう。なお、眼内レンズの本来の形状とは、眼内レンズの製造を終えた段階の形状をいう。

[0037] 次に、挿入器具本体2の先端部に挿入筒4を取り付ける。以上で、眼内レ

ンズ 7 を内蔵する眼内レンズ挿入器具 1 の組み立てが完了する。なお、挿入器具本体 2 と操作部 3 とを連結する構造や、挿入器具本体 2 と挿入筒 4 とを連結する構造については、たとえば、特願 2014-55761 の明細書および図面（特開 2015-177845 号公報）に記載した構造を採用してもよいし、これ以外の連結構造を採用してもよい。

[0038] <3. 眼内レンズ挿入装置の動作>

次に、眼内レンズ挿入器具 1 の動作について説明する。

[0039] （押出部材の動き）

まず、操作部 3 を回転操作したときの押出部材 5 の動作について説明する。

操作部 3 を一方向に回転操作すると、第 1 のネジ部 3 b と第 2 のネジ部 17 a との噛み合いにより、押出部材 5 が前方に移動する。このとき、押出部材 5 のプランジャ部 17 は、挿入器具本体 2 の中空部に嵌合しつつ、挿入器具本体 2 の中心軸方向に真っ直ぐに移動する。また、押出部材 5 は、操作部 3 の回転操作にしたがって図 5（A）～（D）に示すように移動する。

[0040] 図 5（A）は押出部材 5 のロッド部 18 の先端部をレンズ設置部 6 の先端部まで前進させた段階を示し、同図（B）はロッド部 18 の先端部を挿入筒 4 の挿入筒本体 4 a まで前進させた段階を示している。また、図 5（C）はロッド部 18 の先端部を挿入筒 4 のノズル部 4 b まで前進させた段階を示し、同図（D）はロッド部 18 の先端部を挿入筒 4 のノズル部 4 b よりも前方に突出させた段階を示している。

[0041] （ロッド部先端の動き）

上述のように押出部材 5 を移動させると、その移動の途中で、押出部材 5 のロッド部 18 の先端部が、ロッド部 18 自身の弾性変形により、突出ガイド 11 の形状にしたがって上下方向に変位する。その様子を図 6（A）～（D）を用いて説明する。

[0042] まず、操作部 3 の回転操作にともなって押出部材 5 が前方に移動し始めると、ロッド部 18 の先端部（符号 18 a, 18 b で示す部分）は、図 6（

A) に示すように、突出ガイド 11 の上りの傾斜部 11 a にしたがって上方に変位する。次に、ロッド部 18 の先端部は、図 6 (B) に示すように、突出ガイド 11 の頂上部 11 b に達する。

[0043] 次に、ロッド部 18 の先端部は、図 6 (C) に示すように、突出ガイド 11 の下りの傾斜部 11 c にしたがって下方に変位する。このとき、突出ガイド 11 の頂上部 11 b における断面形状は、図 7 (A), (B) のようになる。すなわち、ロッド部 18 の先端部が突出ガイド 11 の頂上部 11 b を通過した後は、ロッド部 18 の下面に形成されている突起 19 の一部が突出ガイド 11 の溝 12 に入り込む。これにより、ロッド部 18 の先端部を突出ガイド 11 の下りの傾斜部 11 c にしたがって下方に変位させることができる。

[0044] 次に、ロッド部 18 の先端部は、図 6 (D) に示すように、突出ガイド 11 の傾斜部 11 c を下り終えて前方に進む。このとき、突出ガイド 11 の頂上部 11 b における断面形状は、図 8 (A), (B) のようになる。すなわち、ロッド部 18 の先端部が突出ガイド 11 の傾斜部 11 c を通過した後は、ロッド部 18 の下面に形成されている突起 19 の全部が突出ガイド 11 の溝 12 に入り込む。これにより、突出ガイド 11 とロッド部 18 との干渉を避けて、ロッド部 18 の先端部を前方に進めることができる。

[0045] (眼内レンズの動き)

また、上述のように押出部材 5 を移動させると、レンズ設置部 6 に設置されている眼内レンズ 7 が押出部材 5 のロッド部 18 によって前方に押し出される。その様子を図 9 (A) ~ (D) の平断面図、図 10 (A) ~ (D) の側断面図、図 11 (A) ~ (D) の斜視図を用いて説明する。

[0046] まず、操作部 3 の回転操作にともなって押出部材 5 が前方に移動し始めると、ロッド部 18 の先端部が支持部 9 b と光学部 8 とに順に接触する (図 9 (A)、図 10 (A) および図 11 (A) を参照)。具体的には、最初に支持部 9 b に対してロッド部 18 の第 1 接触部 18 a が接触し、次いで、光学部 8 に対してロッド部 18 の第 2 接触部 18 b が接触する。

このとき、ロッド部 18 の第 1 接触部 18 a は、支持部 9 b に接触したまま、支持部 9 b を前方に押し込むことにより、支持部 9 b 全体を略 U 字形に光学部 8 側に曲げる。また、支持部 9 b の先端部は第 1 接触部 18 a の上に乗せられ、その状態でロッド部 18 の先端部が突出ガイド 11 の上りの傾斜部 11 a に沿って上方に変位する。そして、ロッド部 18 の先端部が突出ガイド 11 の頂上部 11 b に達すると、第 2 接触部 18 b が光学部 8 の縁に接触する。また、支持部 9 b の先端部は、光学部 8 の面上に乗り上げられる。

[0047] 次に、ロッド部 18 の先端部が支持部 9 b と光学部 8 とに接触しながら眼内レンズ 7 全体を前方に押し出す（図 9（B）、図 10（B）および図 11（B）を参照）。このとき、ロッド部 18 の先端部は、第 2 接触部 18 b で光学部 8 の縁を把持しながら、突出ガイド 11 の頂上部 11 b に沿って前進する。これにより、眼内レンズ 7 の光学部 8 が突出ガイド 11 の頂上部 11 b から傾斜部 11 c へと押し出される。こうして押し出された光学部 8 は、突出ガイド 11 の下りの傾斜部 11 c に沿って斜めに傾く。

[0048] 一方、支持部 9 a の先端部は保持部 14 の収容部 15 に収容されたまま、支持部 9 a 全体が光学部 8 の移動によって曲げられる。支持部 9 a がこのように曲げられる理由は、次のとおりである。

まず、支持部 9 a の先端部は、保持部 14 の収容部 15 に収容されることで前方への移動が規制されている。このため、ロッド部 18 に押されて光学部 8 が前方に移動しても、支持部 9 a の先端部は収容部 15 に引っ掛かるかたちでそこに留められる。したがって、ロッド部 18 の先端部で光学部 8 を前方に押し込むと、その押し込み方向と反対方向の力が支持部 9 a に加わる。このため、支持部 9 a は、光学部 8 の移動にしたがって徐々に曲げられる。

[0049] 次に、ロッド部 18 の先端部が支持部 9 b と光学部 8 の両方に接触しながら眼内レンズ 7 全体をさらに前方に押し出す（図 9（C）、図 10（C）および図 11（C）を参照）。このとき、ロッド部 18 の先端部は、第 2 接触部 18 b で光学部 8 の縁を把持しながら、突出ガイド 11 の下りの傾斜部 1

1 c に沿って下方に変位する。そうすると、光学部 8 は、突出ガイド 1 1 の下りの傾斜部 1 1 c とこれに対向する保持部 1 4 の傾斜面 1 4 a とに案内されて斜め下方に移動する。一方、支持部 9 a は、その先端部が保持部 1 4 の収容部 1 5 に保持されたまま、光学部 8 の移動によってさらに大きく曲げられる。具体的には、支持部 9 a 全体が略 U 字形をなすように光学部 8 側に曲げられる。このとき、上述した光学部 8 の斜め下方への移動により、支持部 9 a の位置に対して光学部 8 の位置が相対的に下方に変位する。

[0050] 次に、ロッド部 1 8 の押出動作によって光学部 8 が保持部 1 4 の下を通過すると、支持部 9 a の先端部が保持部 1 4 の収容部 1 5 を離脱する（図 9（D）、図 10（D）および図 11（D）を参照）。このとき、収容部 1 5 から離脱した支持部 9 a の先端部は、保持部 1 4 の下を通過中の光学部 8 の面上に乗る。また、支持部 9 a の先端部を乗せた光学部 8 は、レンズ設置部 6 の左右の側壁部に押されて徐々に変形し、支持部 9 a の基端側の部位もレンズ設置部 6 の一方の側壁部に接触する。これにより、支持部 9 a の形状的な戻りが抑制される。このため、支持部 9 a は元の形状に戻らずに略 U 字形の曲がったままの状態に維持され、支持部 9 a の先端部は光学部 8 の面上に乗ったままの状態に維持される。

[0051] その後、眼内レンズ 7 は、ロッド部 1 8 の移動によって挿入筒 4 内へと押し出される。その際、眼内レンズ 7 の光学部 8 は、先細りの形状とされた挿入筒本体 4 a の内壁によって左右方向から丸められ、最終的には一对の支持部 9 a, 9 b を抱き込むように折り畳まれる。このように折り畳まれた眼内レンズ 7 は、ロッド部 1 8 によって挿入筒 4 のノズル部 4 b から押し出される。このとき、挿入筒 4 のノズル部 4 b を眼球の切開創に差し込んだ状態で、ノズル部 4 b の開口から眼内レンズ 7 を押し出すことにより、眼内に眼内レンズ 7 を挿入することができる。

[0052] <4. 実施形態の効果>

本発明の実施形態によれば、以下に記述する 1 つまたは複数の効果が得られる。

- [0053] (1) 本発明の実施形態においては、挿入器具本体 2 のレンズ設置部 6 に設置される眼内レンズ 7 の支持部 9 a の先端部を保持部 1 4 で保持し、その支持部 9 a に対して光学部 8 を相対的に下方に変位させる変位機構を備えている。このため、支持部 9 a の先端部を光学部 8 の面上に確実に乗せることができる。
- [0054] (2) 本発明の実施形態においては、押出部材 5 によってレンズ設置部 6 から眼内レンズ 7 を押し出す際に、保持部 1 4 の下を通過するように光学部 8 をガイドするガイド機構 (1 1 c, 1 4 a) を備えている。このため、押出部材 5 の押出動作を利用して、光学部 8 を相対的に下方に変位させることができる。
- [0055] (3) 本発明の実施形態においては、支持部 9 a の先端部を収容する収容部 1 5 を保持部 1 4 に設け、押出部材 5 に押されて光学部 8 が保持部 1 4 の下を通過するときに、支持部 9 a の先端部が収容部 1 5 から離脱する構成になっている。このため、押出部材 5 の押出動作を利用して、支持部 9 a を光学部 8 側に曲げながら、支持部 9 a の先端部を収容部 1 5 から離脱させて光学部 8 の面上に乗せることができる。
- [0056] (4) 本発明の実施形態においては、レンズ設置部 6 に眼内レンズ 7 が予め設定されたプリロードタイプの眼内レンズ挿入器具 1 を採用している。このため、眼内レンズ挿入器具 1 を使用するユーザーは、その都度、眼内レンズ 7 の設置作業を行う必要がない。このため、白内障手術におけるユーザーの作業負担を軽減することができる。
- [0057] (5) 本発明の実施形態においては、挿入器具本体 2 のレンズ設置部 6 に眼内レンズ 7 が無負荷状態で設置されるため、眼内レンズ 7 を内蔵したプリロードタイプの眼内レンズ挿入器具 1 を長期にわたって保存しても、眼内レンズ 7 の形状が癖付けされることがない。したがって、眼内レンズ挿入器具 1 を用いて眼内に挿入される眼内レンズ 7 の形状の復元性が損なわれるおそれがない。
- [0058] < 5. 変形例等 >

本発明の技術的範囲は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の構成要件やその組み合わせによって得られる特定の効果を導き出せる範囲において、種々の変更や改良を加えた形態も含む。

[0059] たとえば、上記実施形態においては、プリロードタイプの眼内レンズ挿入器具 1 を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限らず、眼内レンズ挿入器具を使用するユーザーがその都度、眼内レンズを設置するタイプの眼内レンズ挿入器具に適用してもよい。

[0060] また、上記実施形態においては、操作部 3 の回転操作によって押出部材 5 を前方に移動させる構成を採用したが、本発明はこれに限らず、たとえば押出部材を指で直接押し込む構成を採用してもよい。

符号の説明

- [0061] 1 …眼内レンズ挿入器具
2 …挿入器具本体
3 …操作部
4 …挿入筒
5 …押出部材
6 …レンズ設置部
7 …眼内レンズ
8 …光学部
9 a …支持部（前方支持部）
9 b …支持部（後方支持部）
11 …突出ガイド
11 a …傾斜部
11 b …頂上部
11 c …傾斜部
14 …保持部
15 …収容部
18 …ロッド部

請求の範囲

- [請求項1] 光学部と当該光学部から延在する一対の支持部とを有する眼内レンズを眼内に挿入する眼内レンズ挿入器具であって、
- 前記眼内レンズが設置されるレンズ設置部が設けられた挿入器具本体と、
- 前記一対の支持部のうち前記レンズ設置部の前方に配置される前方支持部の先端部を保持する保持部と、
- 前記保持部に保持された前記前方支持部に対して前記光学部を相対的に下方に変位させる変位機構と、
- を備えることを特徴とする眼内レンズ挿入器具。
- [請求項2] 前記挿入器具本体の中心軸方向に移動することにより前記レンズ設置部から前記眼内レンズを押し出す押出部材を備え、
- 前記変位機構は、前記押出部材によって前記眼内レンズを押し出す際に、前記保持部の下を通過するように前記光学部をガイドするガイド機構を備える
- ことを特徴とする請求項1に記載の眼内レンズ挿入器具。
- [請求項3] 前記保持部は、前記前方支持部の先端部を離脱可能に収容する収容部を有し、
- 前記押出部材に押されて前記光学部が前記保持部の下を通過するときに、前記前方支持部の先端部が前記収容部から離脱するように構成されている
- ことを特徴とする請求項2に記載の眼内レンズ挿入器具。
- [請求項4] 前記ガイド機構は、水平面に対して傾斜する状態で前記保持部の下面に形成された第1ガイド部と、この第1ガイド部に対向する位置に当該第1ガイド部と同じ向きに傾斜する状態で形成された第2ガイド部とを含む
- ことを特徴とする請求項2に記載の眼内レンズ挿入器具。
- [請求項5] 前記押出部材は、前記第2ガイド部の傾斜に沿って下方に変位しつ

つ前記眼内レンズを押し出すロッド部を有する


ことを特徴とする請求項 4 に記載の眼内レンズ挿入器具。

[請求項6] 前記レンズ設置部に前記眼内レンズが予め設置されたプリロードタイプである


ことを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載の眼内レンズ挿入器具。

[請求項7] 前記レンズ設置部では、前記眼内レンズが無負荷状態で設置されることを特徴とする請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載の眼内レンズ挿入器具。



[図1]

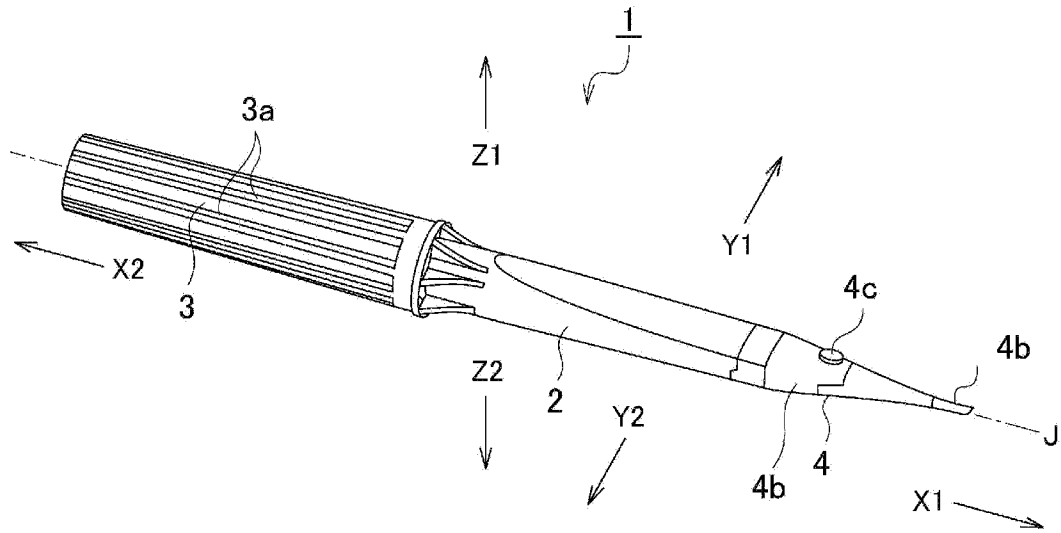




[図2]

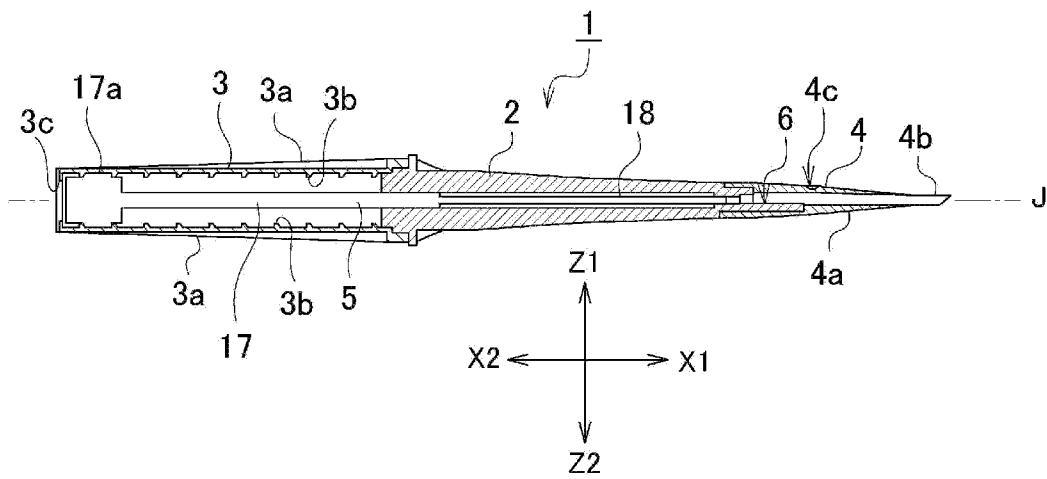


[図3]

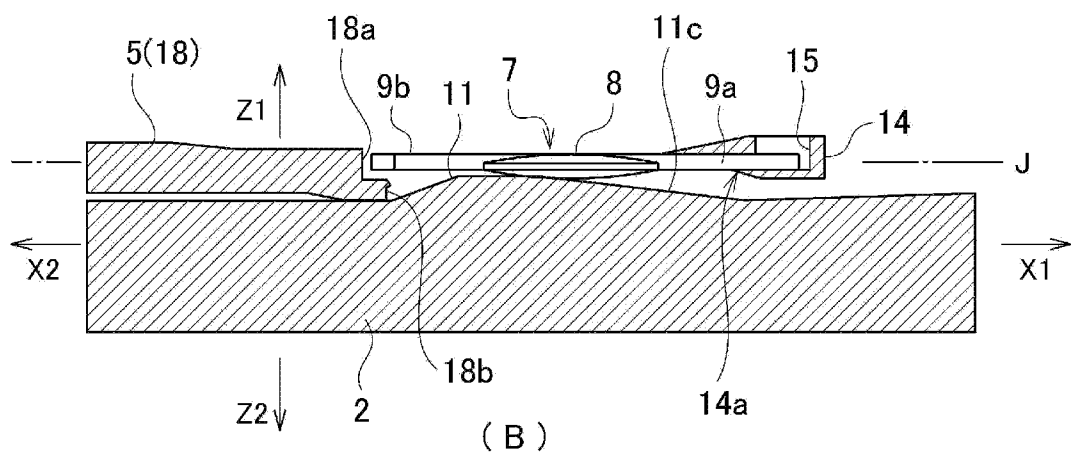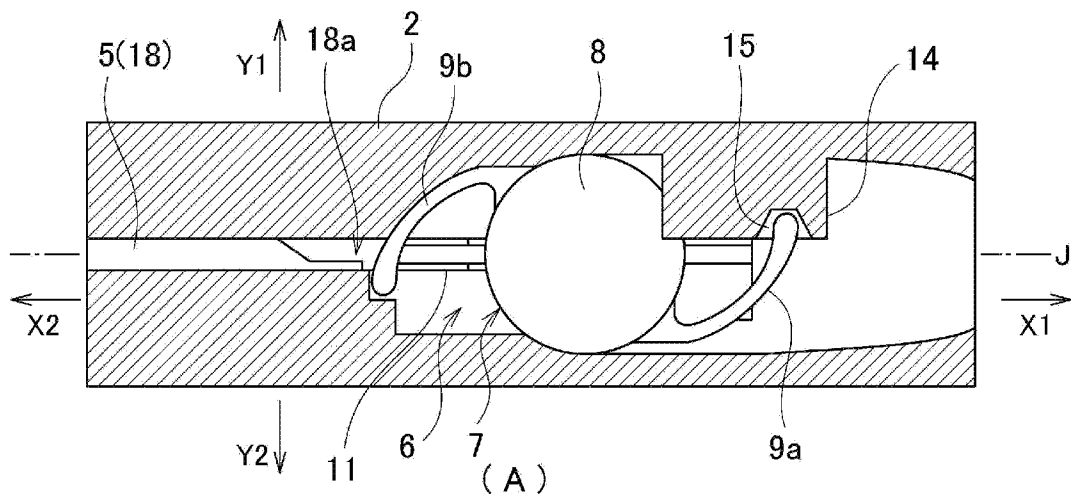


[図4]

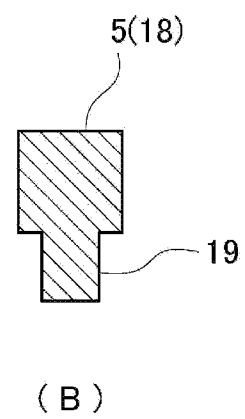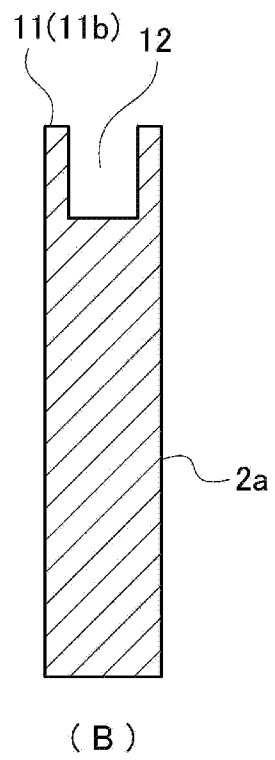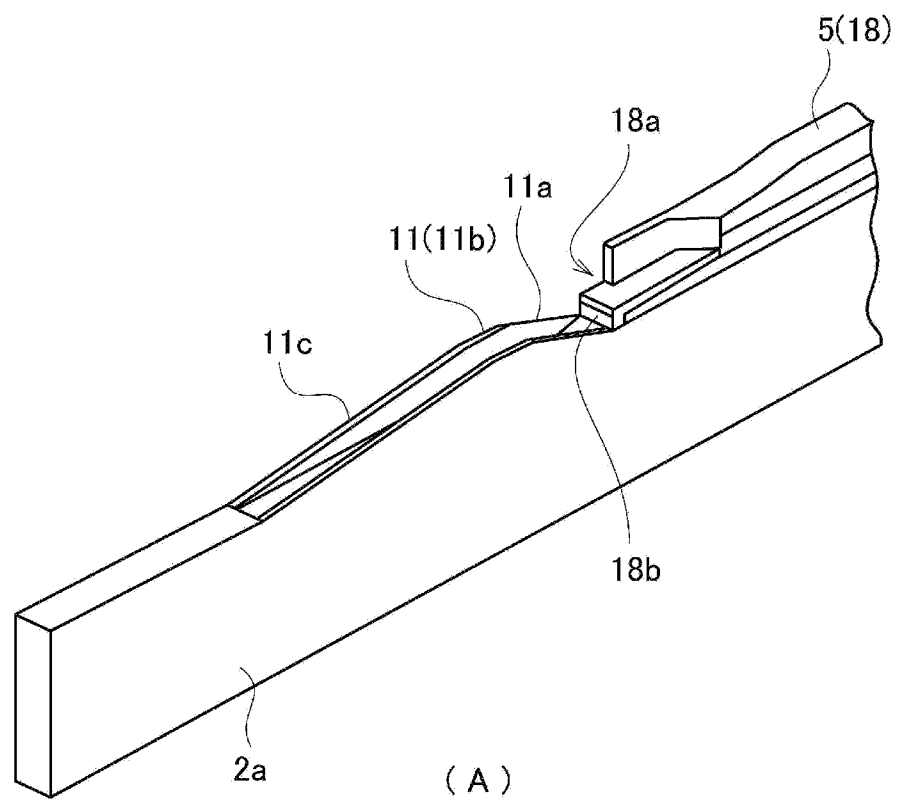


[図6]

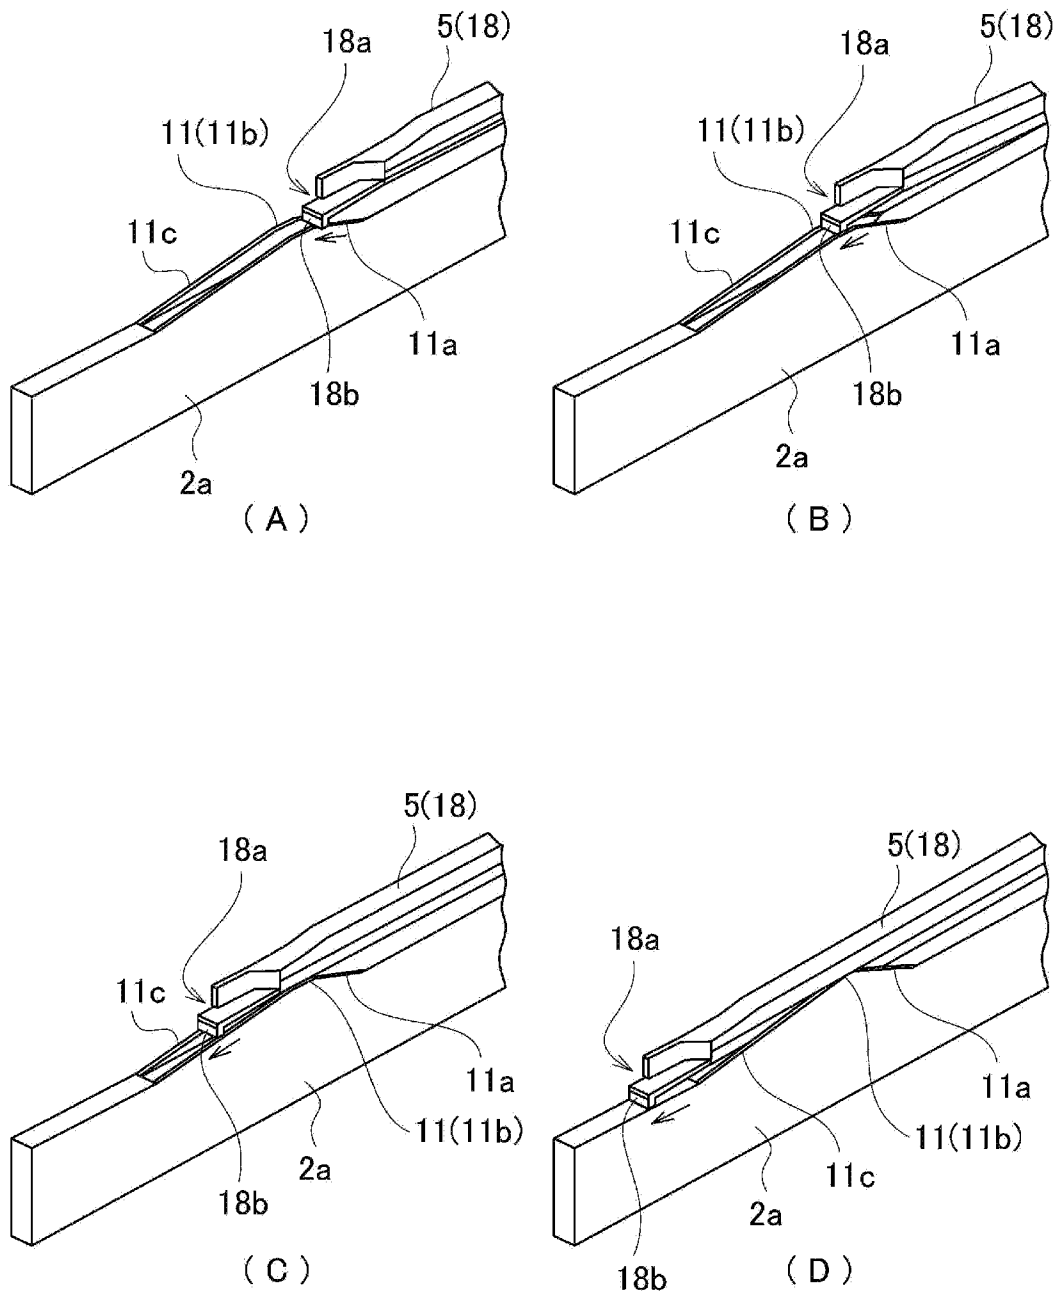

[図7]

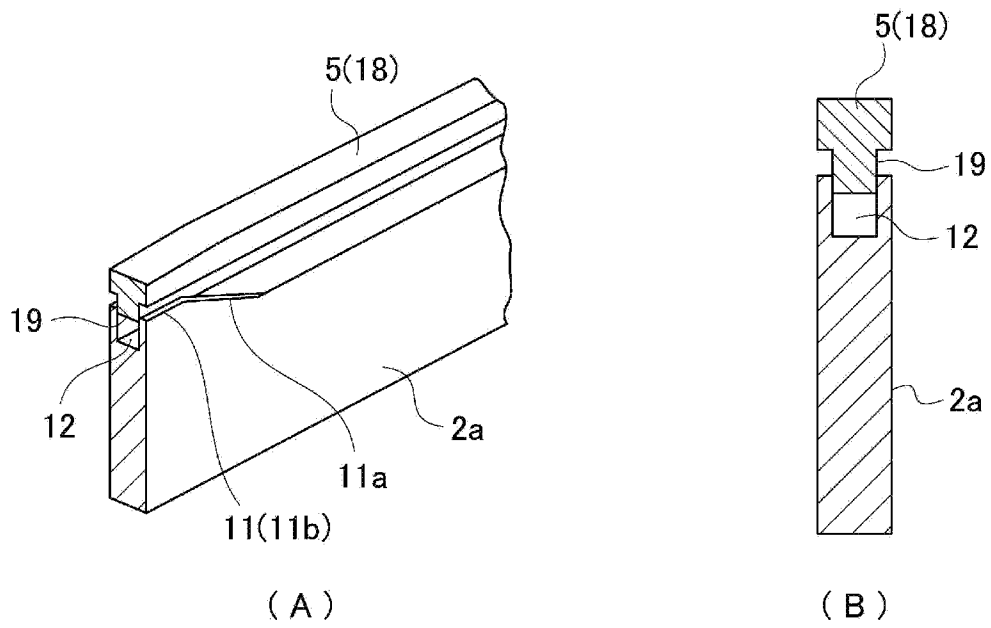

[図8]

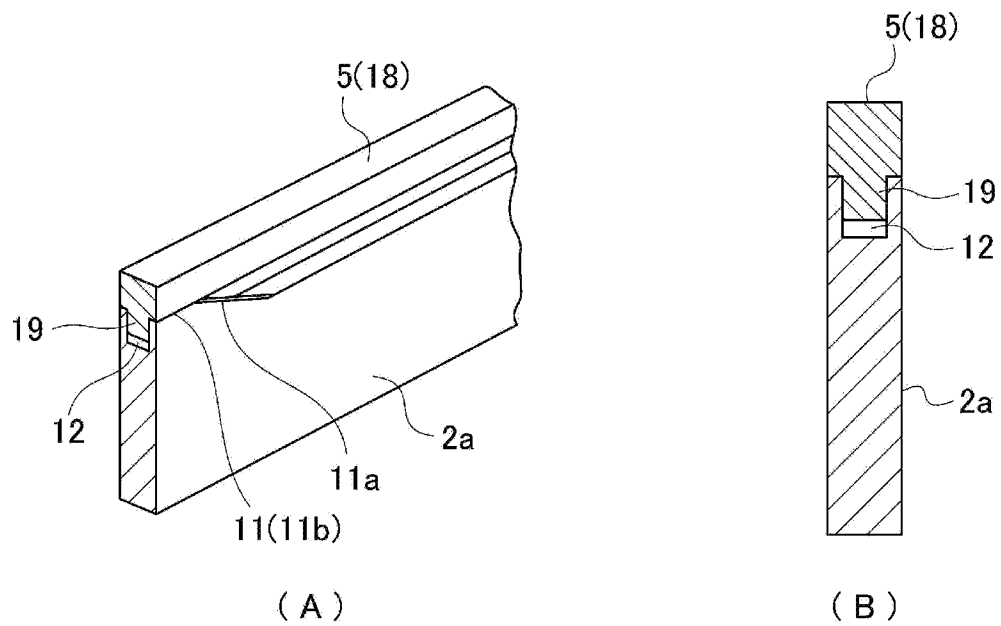

[図9]


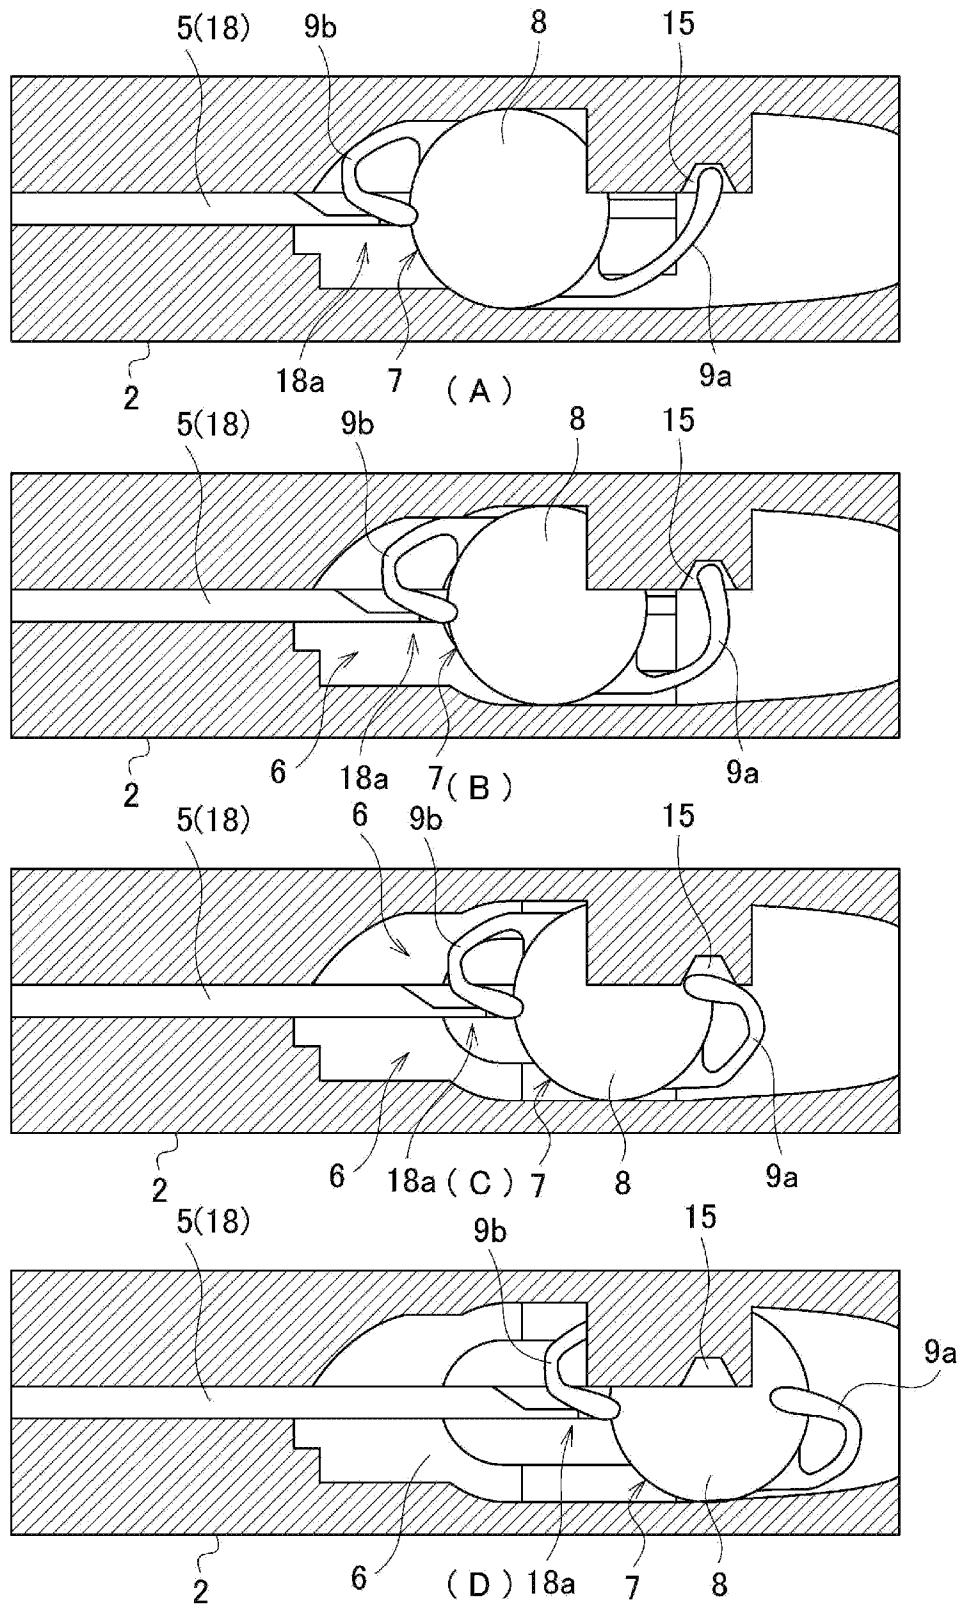


Figure 1 consists of four cross-sectional views (A, B, C, D) of a semiconductor device. The device is built on a substrate (2) with a trench (11). A gate stack (5(18)) is formed on the substrate. A contact (14) is formed on the gate stack. The contact (14) is moved towards the trench (11) in a series of steps. In (A), the contact (14) is on the gate stack. In (B), the contact (14) is moved towards the trench (11). In (C), the contact (14) is moved further towards the trench (11). In (D), the contact (14) is moved into the trench (11). The contact (14) is formed by a conductive material (15) and a dielectric material (9a). The gate stack (5(18)) is formed by a gate dielectric (18a) and a gate conductive layer (18b). The trench (11) is formed in the substrate (2). The contact (14) is moved towards the trench (11) by a force (7) applied to the contact (14). The contact (14) is moved into the trench (11) by a force (7) applied to the contact (14). The contact (14) is moved into the trench (11) by a force (7) applied to the contact (14). The contact (14) is moved into the trench (11) by a force (7) applied to the contact (14).

[図11]

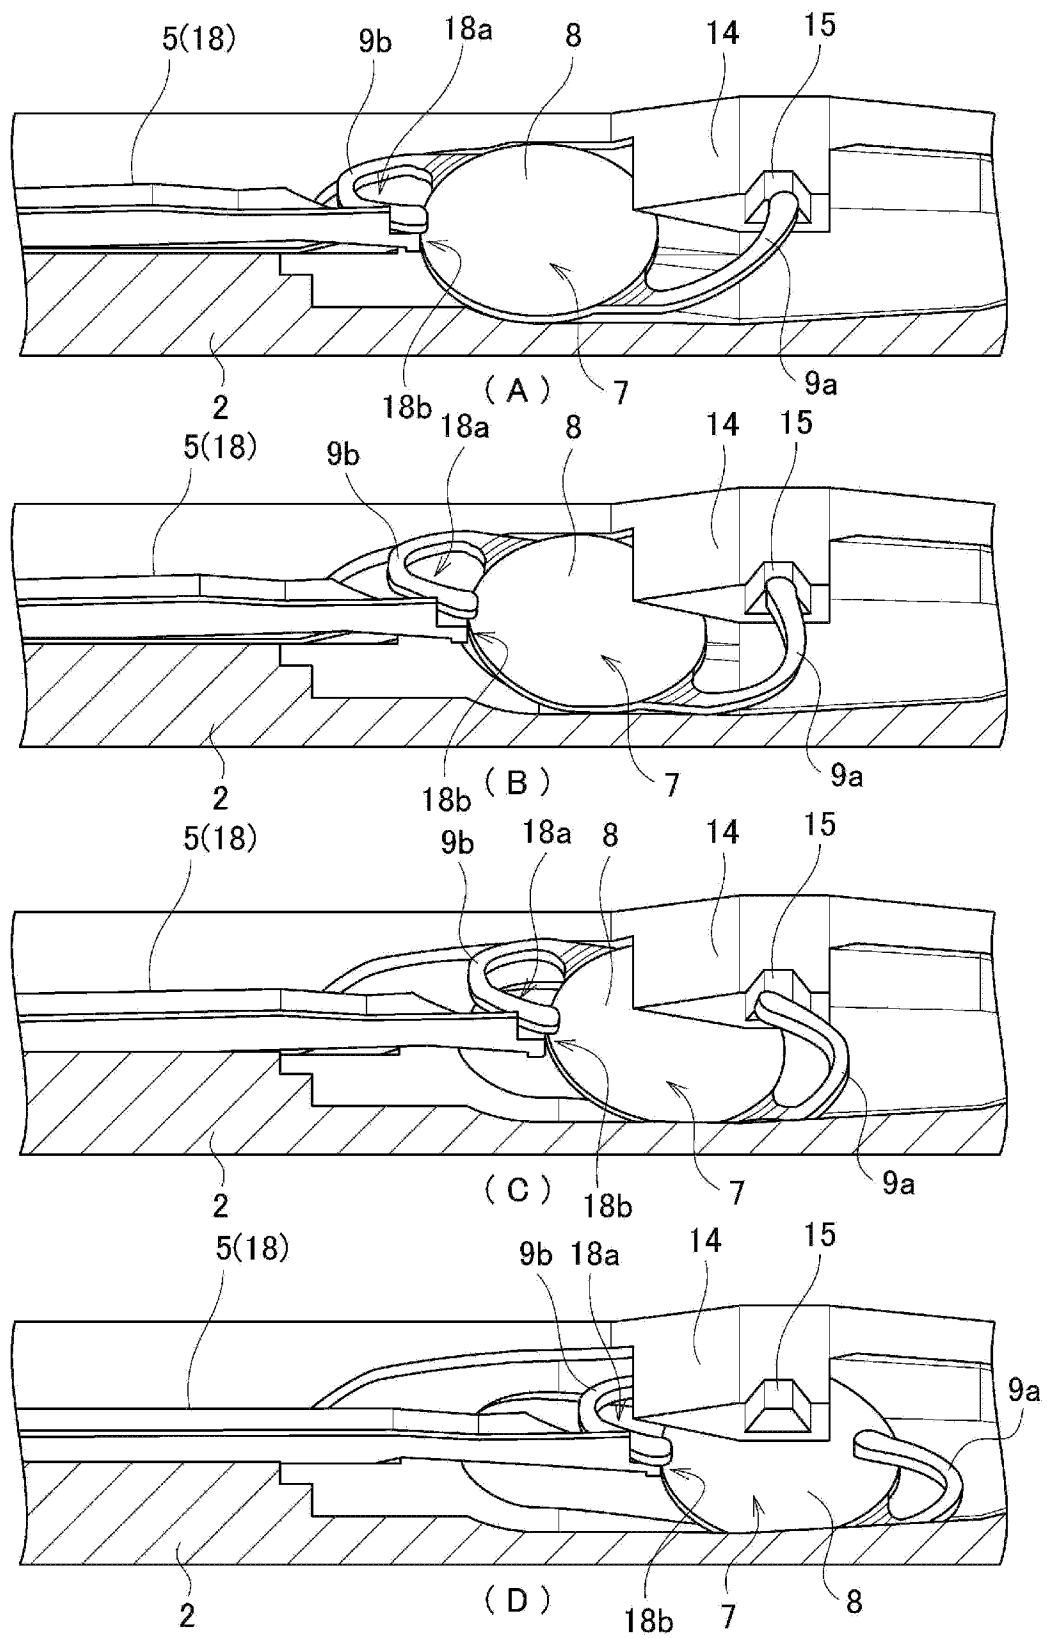

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/077328

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61F2/16(2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61F2/16

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2016
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2016	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2016

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	WO 2015/125905 A1 (Santen Pharmaceutical Co., Ltd.), 27 August 2015 (27.08.2015), paragraphs [0044] to [0052], [0074] to [0093]; fig. 1 to 8, 13 to 16 & US 2016/0331587 A1 paragraphs [0060] to [0068], [0090] to [0109]; fig. 1 to 8, 13 to 16 & JP 2015-171529 A & CA 2938660 A1 & KR 10-2016-0122164 A & TW 201538143 A	1-3, 6-7 4-5
A	JP 2014-140711 A (Santen Pharmaceutical Co., Ltd.), 07 August 2014 (07.08.2014), & US 2015/0327992 A1 & WO 2014/104271 A1 & EP 2939637 A1 & TW 201438687 A & CN 104883998 A & KR 10-2015-0102952 A	1-7

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
01 December 2016 (01.12.16)

Date of mailing of the international search report
13 December 2016 (13.12.16)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. A61F2/16(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. A61F2/16

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2016年
日本国実用新案登録公報	1996-2016年
日本国登録実用新案公報	1994-2016年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X A	WO 2015/125905 A1 (参天製薬株式会社) 2015.08.27, 段落 [0044]-[0052]及び[0074]-[0093], 第1-8及び13-16図 & US 2016/0331587 A1, 段落[0060]-[0068]及び[0090]-[0109], 第 1-8及び13-16図 & JP 2015-171529 A & CA 2938660 A1 & KR 10-2016-0122164 A & TW 201538143 A	1-3, 6-7 4-5
A	JP 2014-140711 A (参天製薬株式会社) 2014.08.07 & US 2015/0327992 A1 & WO 2014/104271 A1 & EP 2939637 A1 & TW 201438687 A & CN 104883998 A & KR 10-2015-0102952 A	1-7

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

01.12.2016

国際調査報告の発送日

13.12.2016

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

寺澤 忠司

31

9623

電話番号 03-3581-1101 内線 3386