

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496484 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220133651. 4

(22) 申请日 2012. 03. 25

(73) 专利权人 魏秀玲

地址 272200 山东省潍坊市诸城市南关路
25 号诸城市妇幼保健院

(72) 发明人 魏秀玲 孙增明

(51) Int. Cl.

A43B 3/02(2006. 01)

A43B 23/02(2006. 01)

A43B 13/22(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种产科医生用隔离靴

(57) 摘要

本实用新型公开了一种产科医生用隔离靴，包括靴体和靴筒，靴筒的开口处设置有弹性带，所述靴体的脚后跟处靠近靴壁上设置有楔形垫，所述楔形垫可以在靴壁上滑动，靴体的底面设置有耐磨层；所述耐磨层是由橡胶制成的；所述耐磨层的厚度为 2-3 毫米。本实用新型穿戴舒适，方便实用，防污效果好，能够适合不同大小脚的人穿戴，通用性强，由于靴底设置有耐磨层，可以防止在手术室内被掉落到地上的医疗器械扎透，保护了医务人员的人身安全。

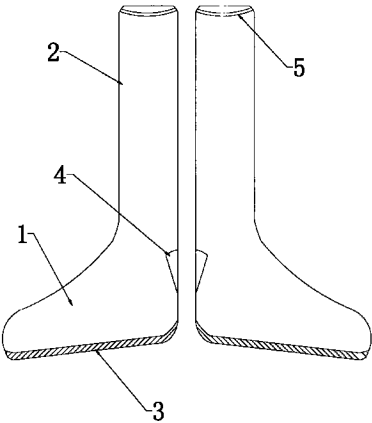

1. 一种产科医生用隔离靴,包括靴体和靴筒,靴筒的开口处设置有弹性带,其特征在于:所述靴体的脚后跟处靠近靴壁上设置有楔形垫,所述楔形垫可以在靴壁上滑动,靴体的底面设置有耐磨层。

2. 根据权利要求1所述的一种产科医生用隔离靴,其特征在于:所述耐磨层是由橡胶制成的。

3. 根据权利要求1或2所述的一种产科医生用隔离靴,其特征在于:所述耐磨层的厚度为2-3毫米。

一种产科医生用隔离靴

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，尤其是一种产科医生用隔离靴。

背景技术

[0002] 产科医生在执行医疗操作时，无论是施行流产术还是术前清洗患者会阴部，清洗液及血液等难免会溅到医生的裤腿及脚面上，因为这些液体具有污染性，目前医务人员一般都会穿着隔离衣及隔离靴进行防护，但是普通的隔离靴鞋底没有加厚，容易被掉落到地上的医疗器械扎透，这样极大的危害了医务人员的人身安全，并且人的脚的大小不一样，有时很难找到大小合适的隔离靴。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服上述技术缺点提供一种产科医生用隔离靴。

[0004] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案为：一种产科医生用隔离靴，包括靴体和靴筒，靴筒的开口处设置有弹性带，所述靴体的脚后跟处靠近靴壁上设置有楔形垫，所述楔形垫可以在靴壁上滑动，靴体的底面设置有耐磨层。

[0005] 所述耐磨层是由橡胶制成的。

[0006] 所述耐磨层的厚度为 2-3 毫米。

[0007] 本实用新型所具有的有益效果是：

[0008] 本实用新型穿戴舒适，方便实用，防污效果好，能够适合不同大小脚的人穿戴，通用性强，由于靴底设置有耐磨层，可以防止在手术室内被掉落到地上的医疗器械扎透，保护了医务人员的人身安全。

附图说明

[0009] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图 1 对本实用新型做以下详细说明。

[0011] 如图 1 所示，包括靴体 1 和靴筒 2，靴筒的开口处设置有弹性带 5，所述靴体 1 的脚后跟处靠近靴壁上设置有楔形垫 4，所述楔形垫 4 可以在靴壁上滑动，靴体 1 的底面设置有耐磨层 3；所述耐磨层 3 是由橡胶制成的；所述耐磨层 3 的厚度为 2-3 毫米。

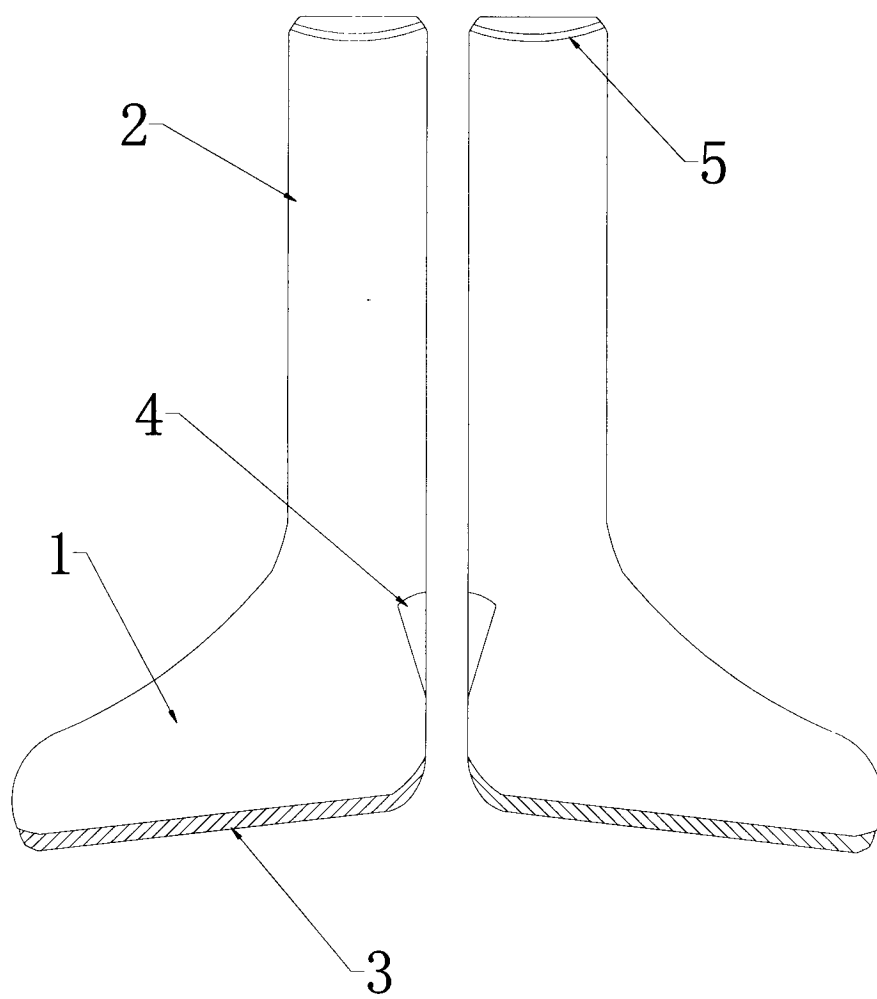


图 1