



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D209373 S

(45)公告日：中華民國 110 (2021) 年 01 月 11 日

(21)申請案號：109302745

(22)申請日：中華民國 108 (2019) 年 07 月 04 日

(51)LOC.(11)Cl.：24-01

(30)優先權：2019/01/04

美國

29/675,738

(71)申請人：美商梅梭刻度技術公司 (美國) MESO SCALE TECHNOLOGIES, LLC. (US)
美國(72)設計人：奧斯本 羅傑 OSBORNE, RODGER DARIN (US)；沃史塔特 雅各
WOHLSTADTER, JACOB N. (US)；寇娃 珊德 KOVACS, SANDOR (US)；林姆
坤勒 亞倫 LEIMKUEHLER, AARON (US)；辛莫 賽西利雅 ZIMMERMAN,
CECILIA (US)；凡德莎 吉爾斯 VANDERSARL, JULES (US)

(74)代理人：林志剛

(56)參考文獻：

EU 003382670-0001

JP D1497485

JP D1596097

US D721184


審查人員：謝孟峰

圖式數：26 共 21 頁

(54)名稱

儀器之部分

代表圖：

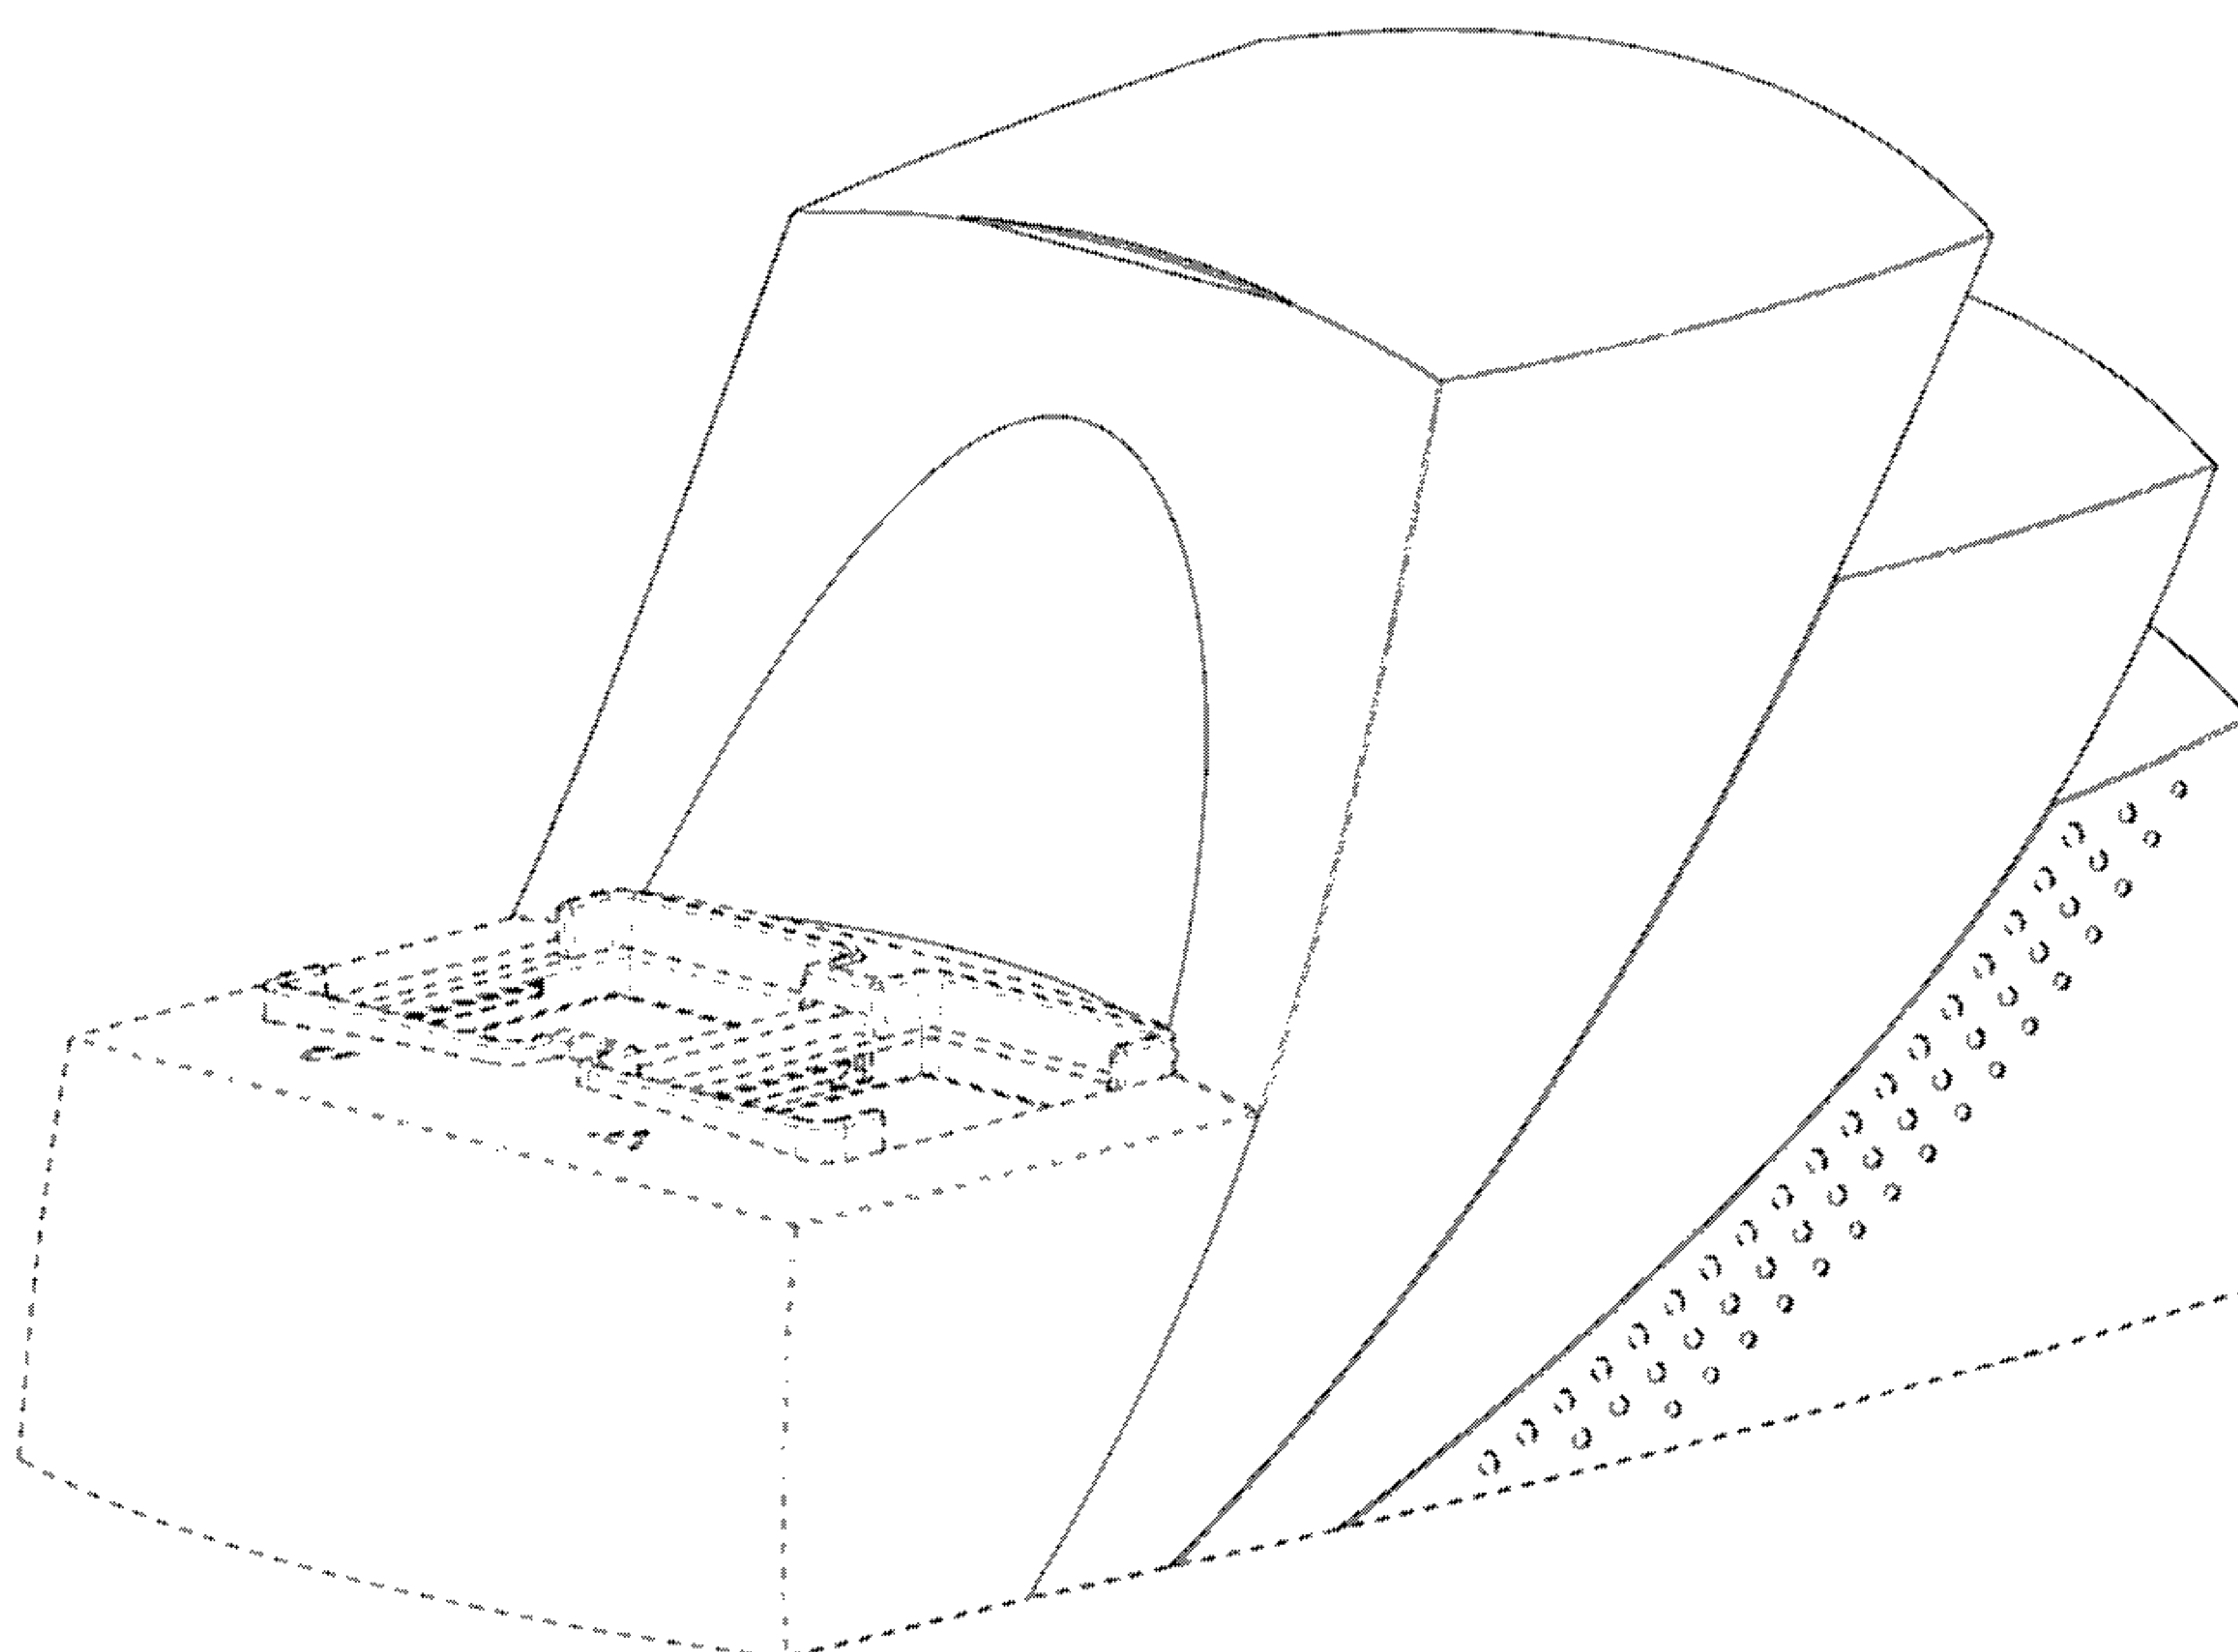

【立體圖1】

D209373

【設計說明書】

【中文設計名稱】 儀器之部分

【英文設計名稱】 INSTRUMENT

【物品用途】

【0001】 本設計的物品係用於讀取和分析科學檢測板的儀器。


【設計說明】

【0002】 圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分。


【0003】 在「表示發光狀態參考圖」的各圖式和「表示發光部參考圖」的各圖式中，所繪製的放射狀細線是為了表示其發光狀態。

【0004】 在「表示發光部參考圖」的各圖式中，所揭露之藍色填色部分是為了表示其發光部。


【設計圖式】
(指定代表圖)

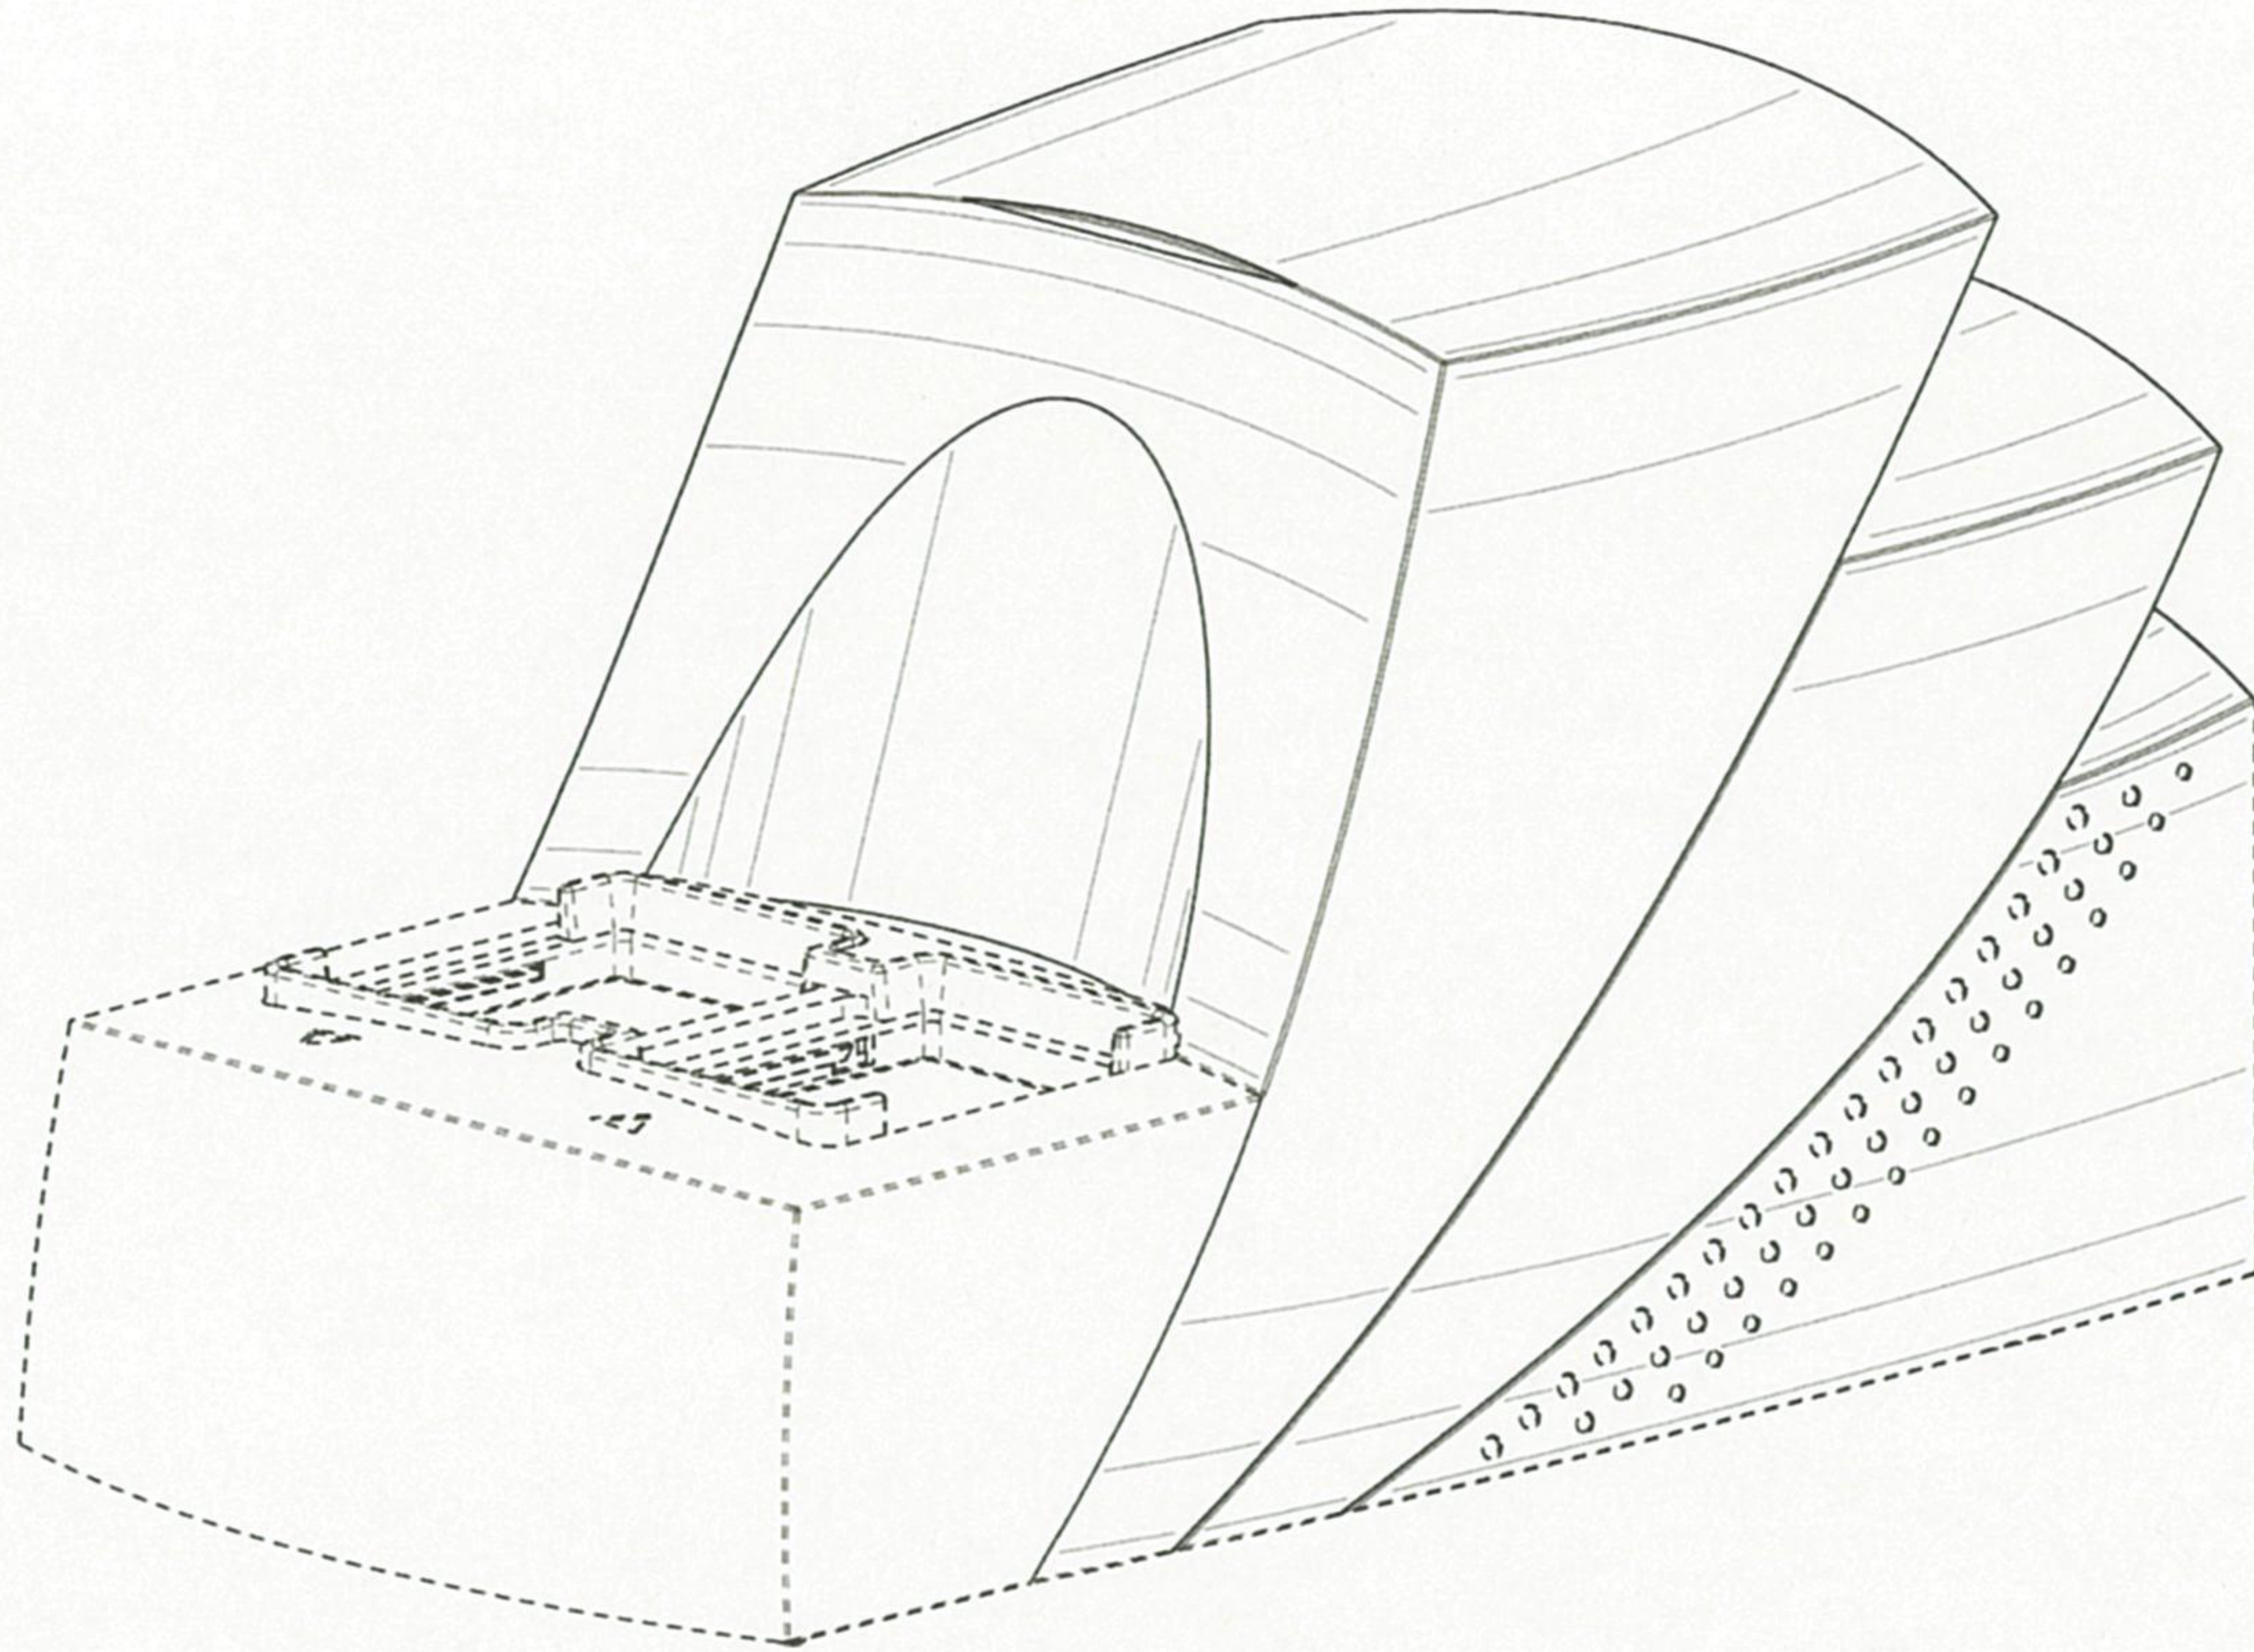


【立體圖1】

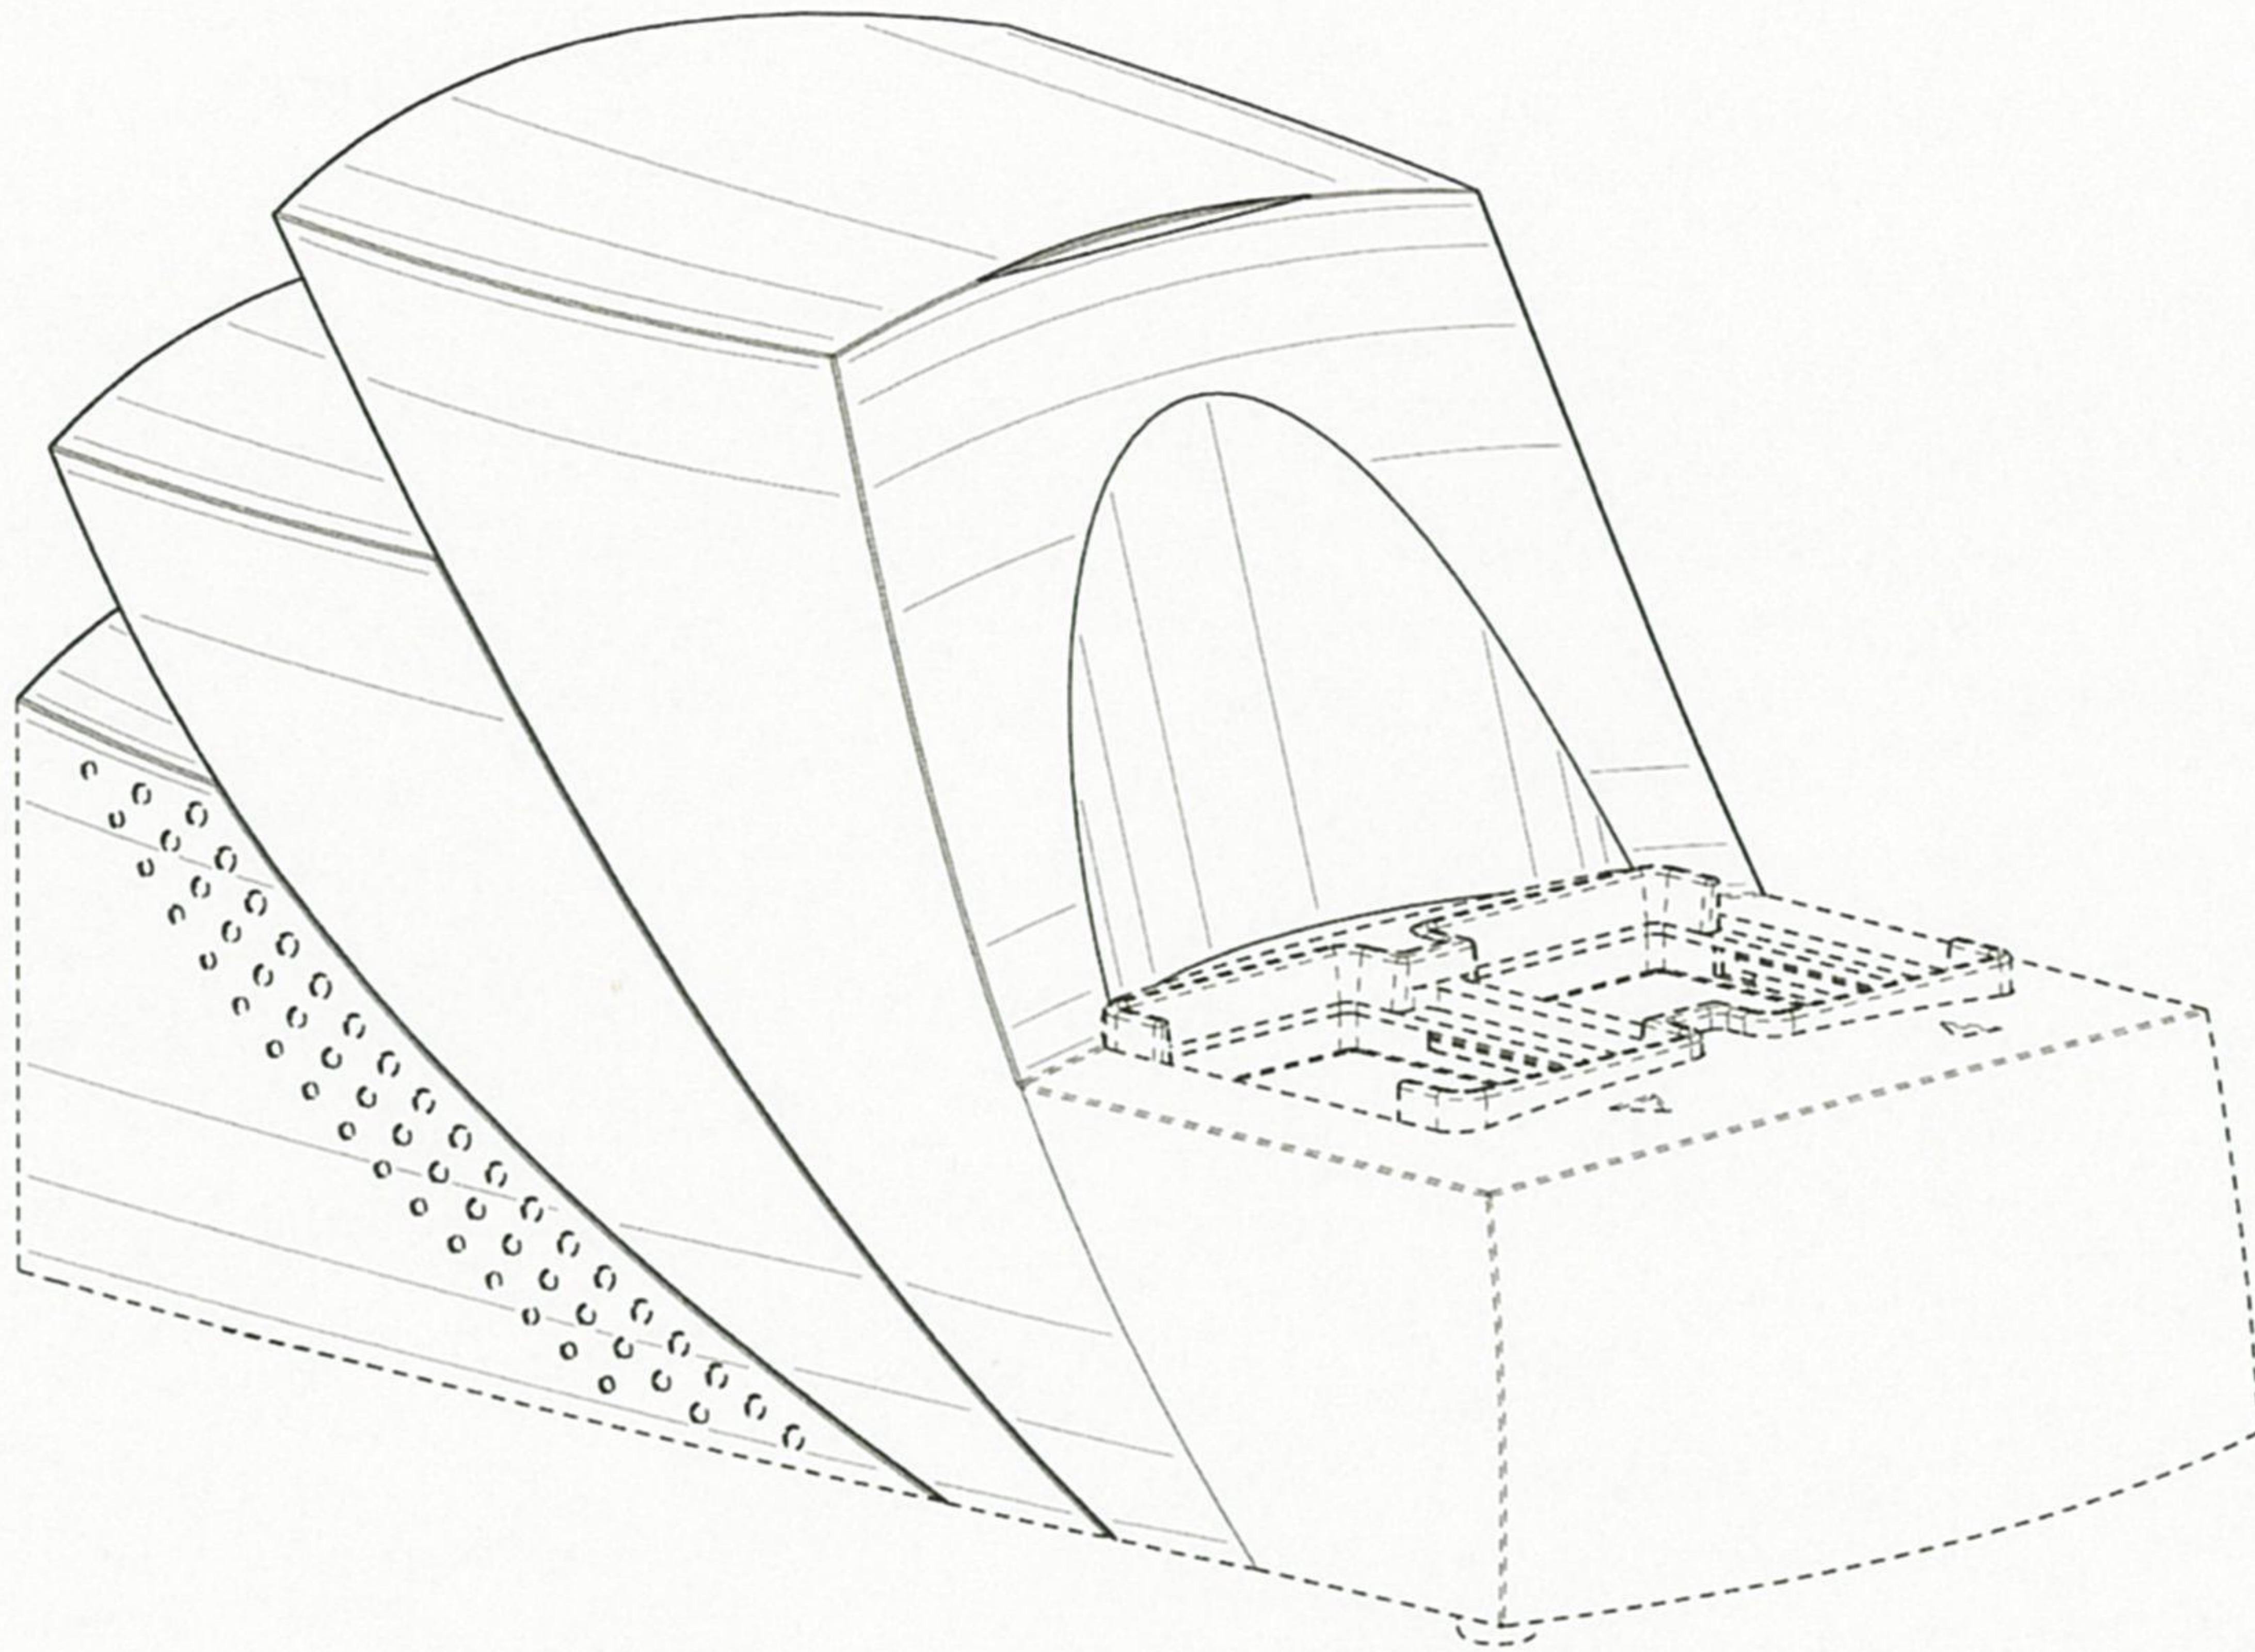


【立體圖2】

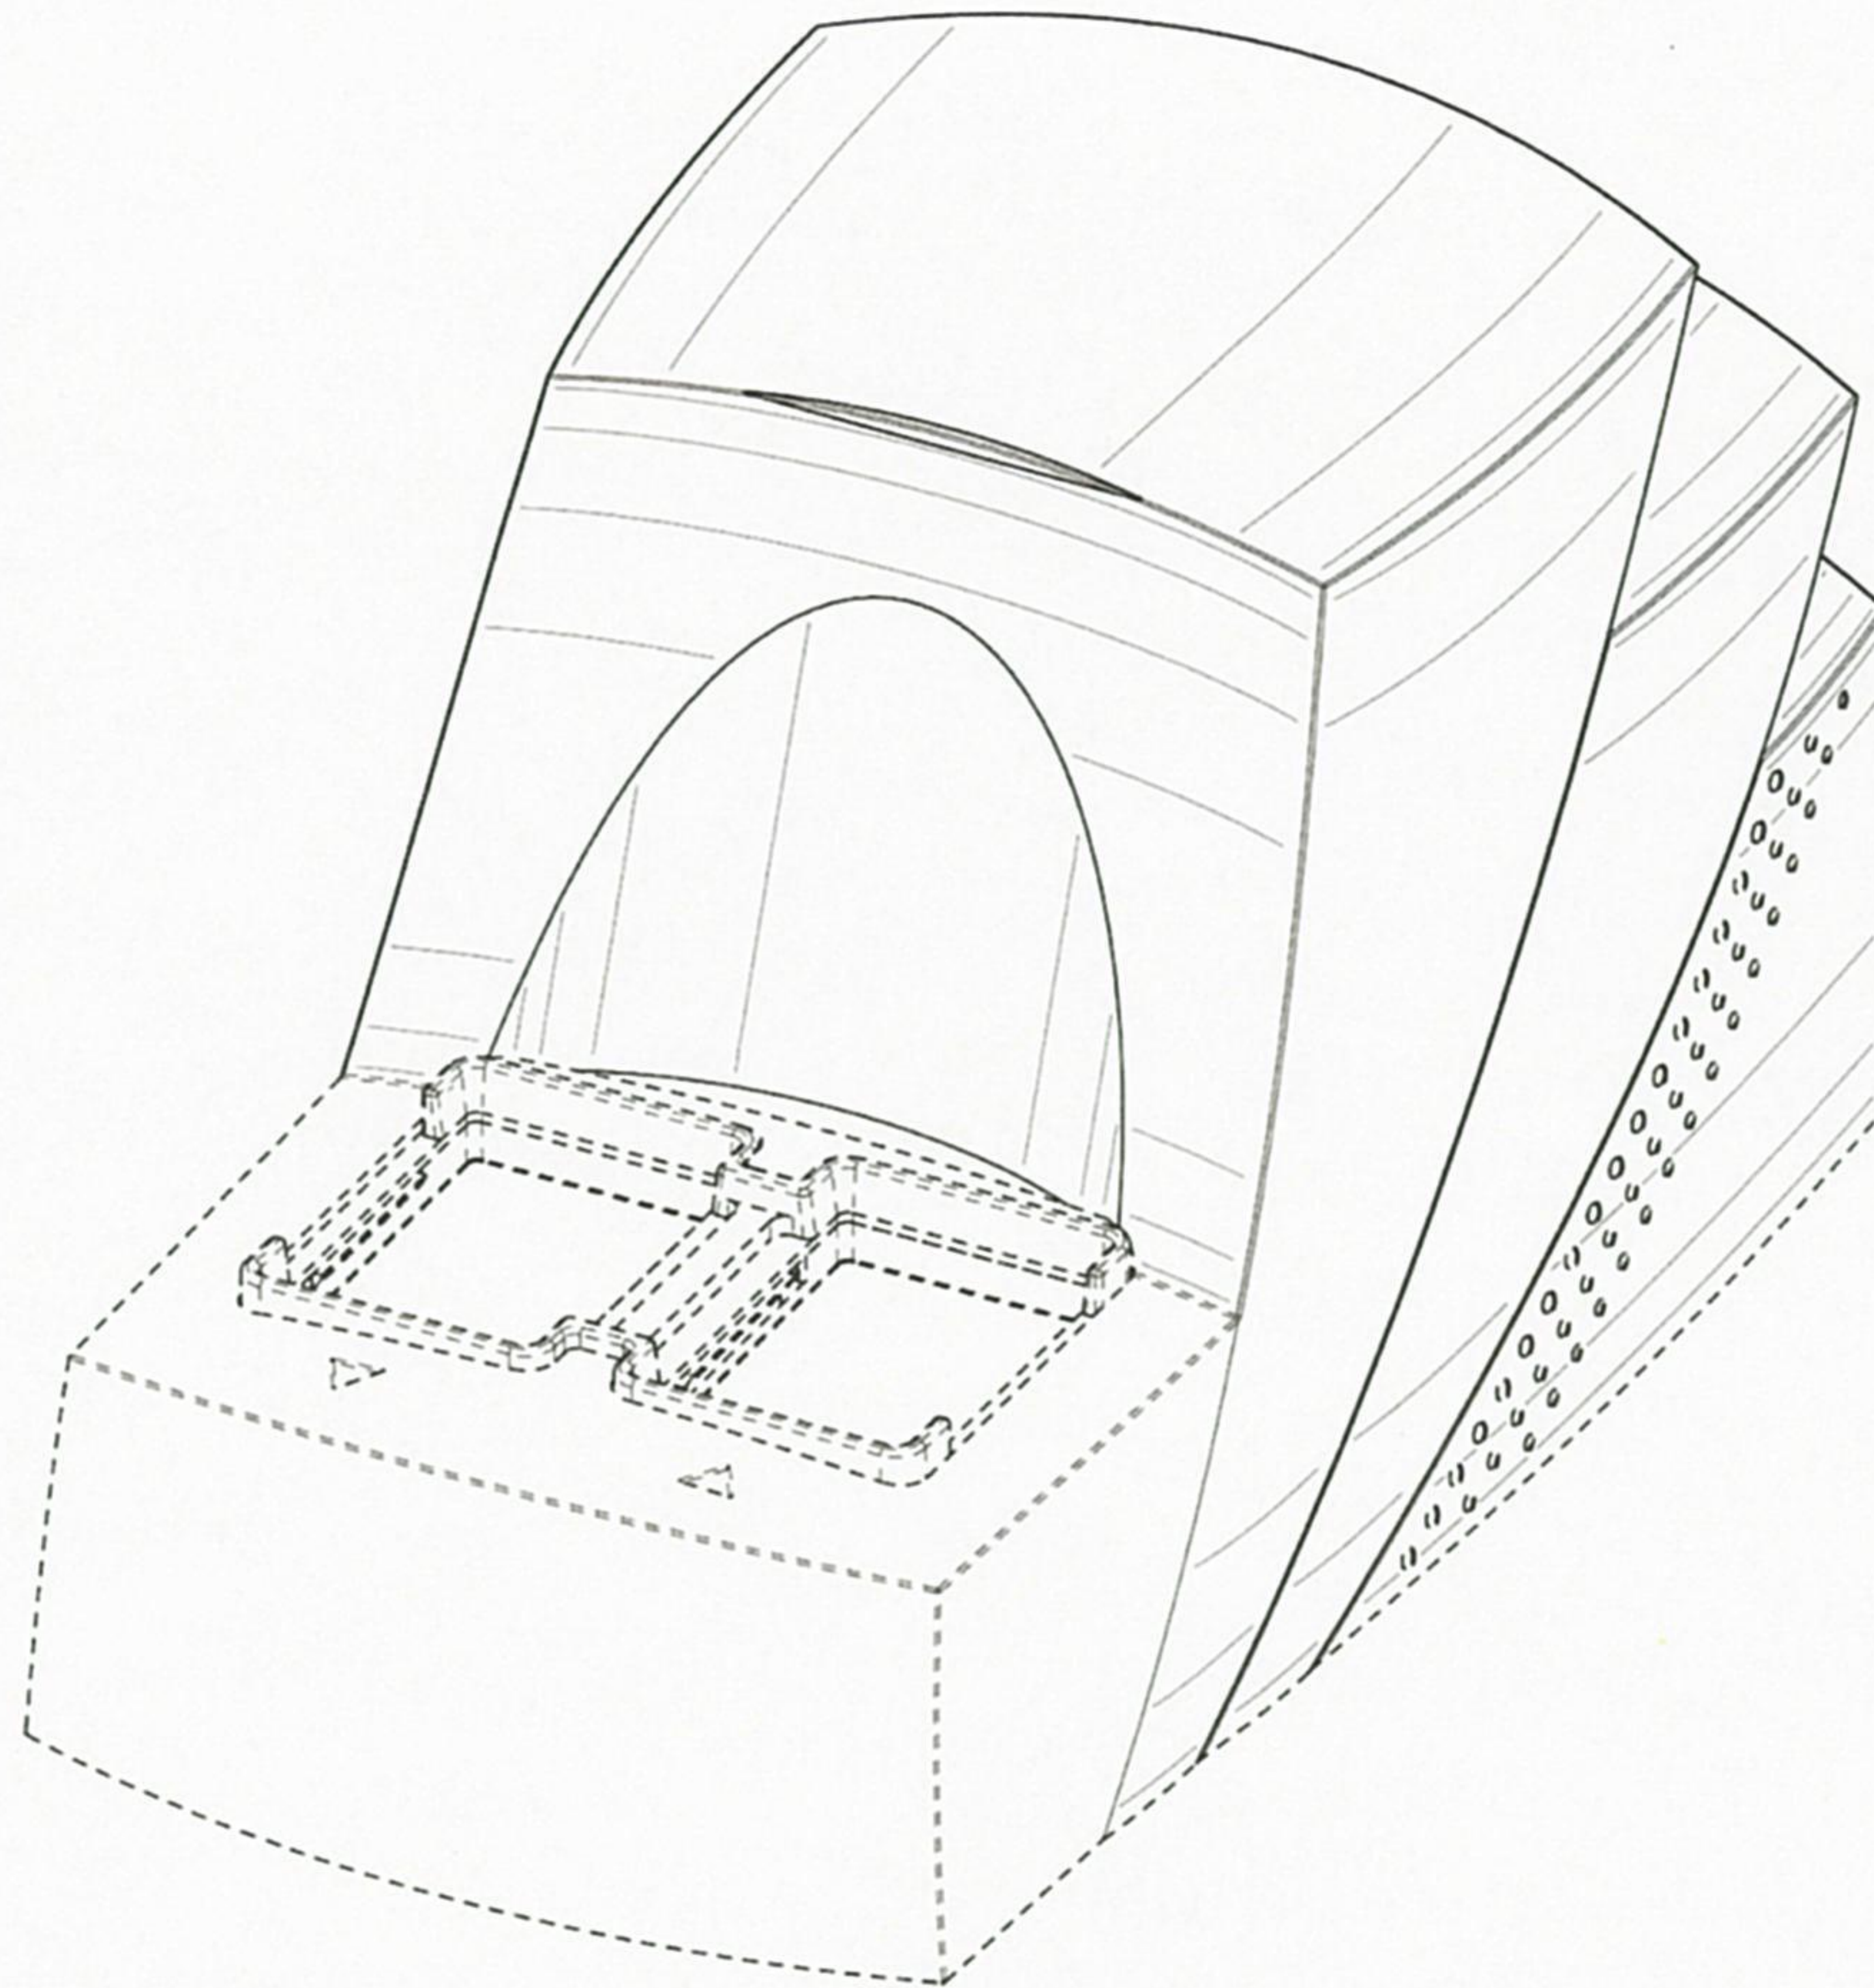


【立體圖3】

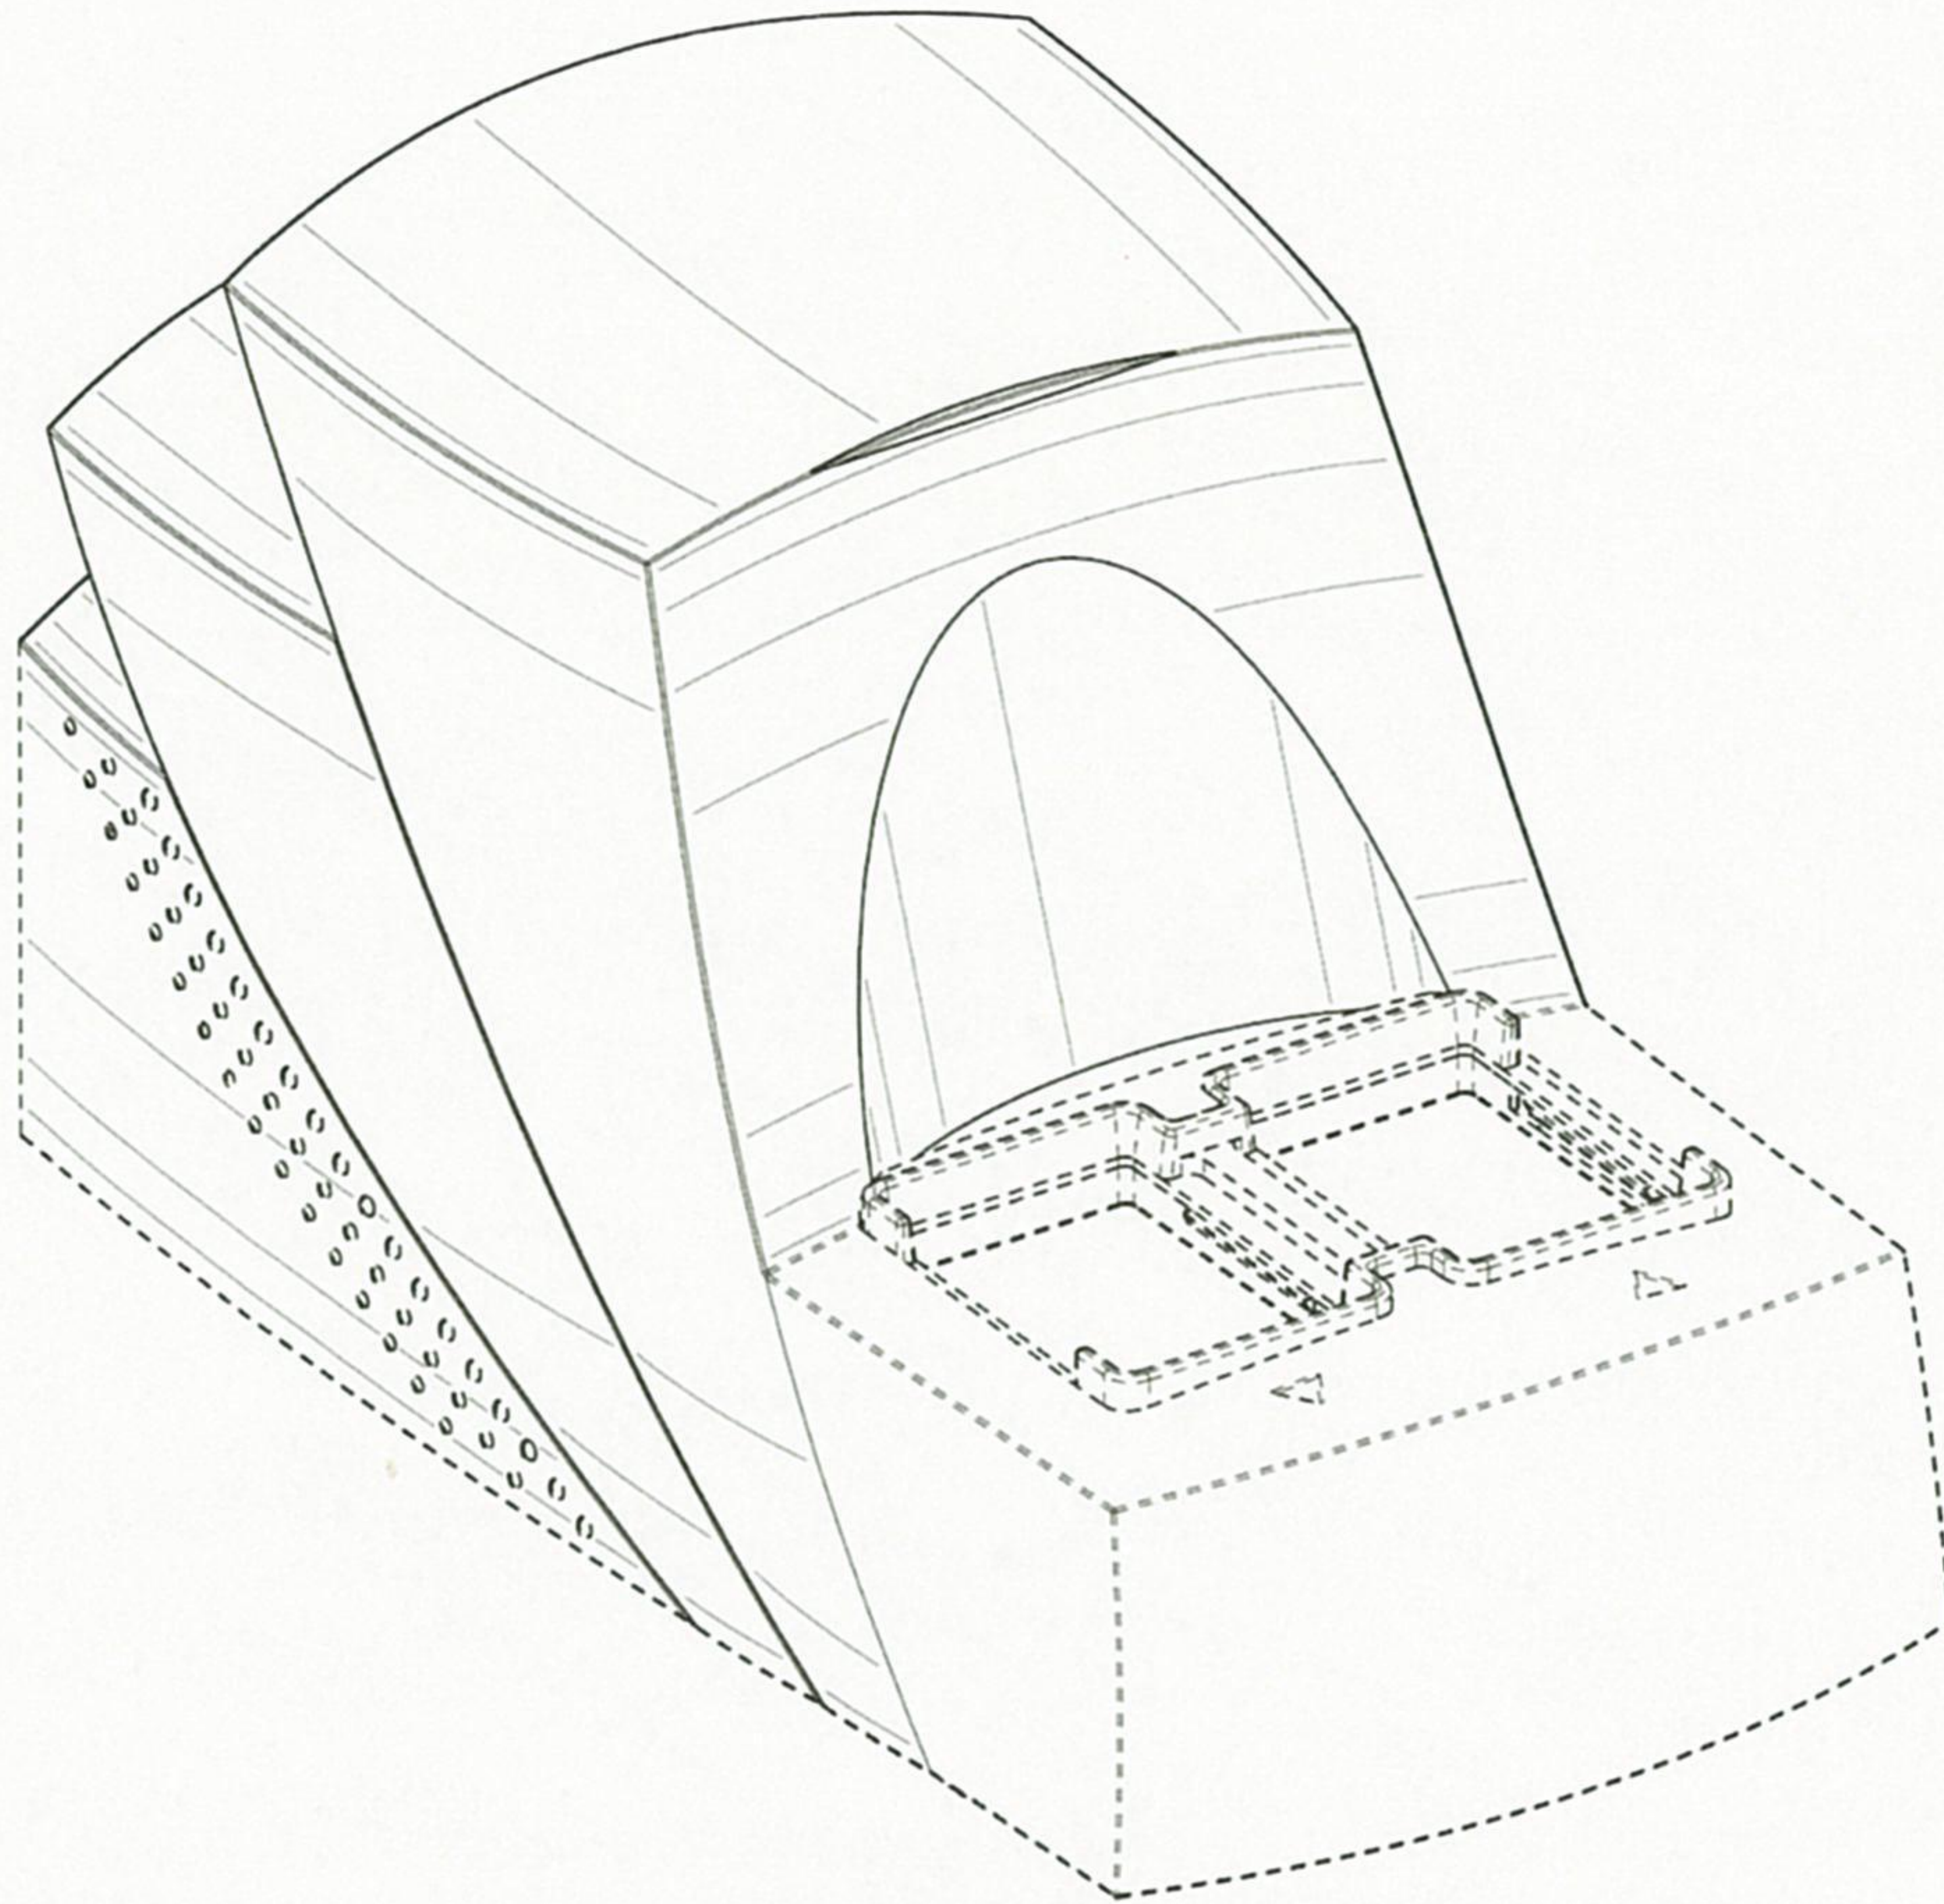


【立體圖4】

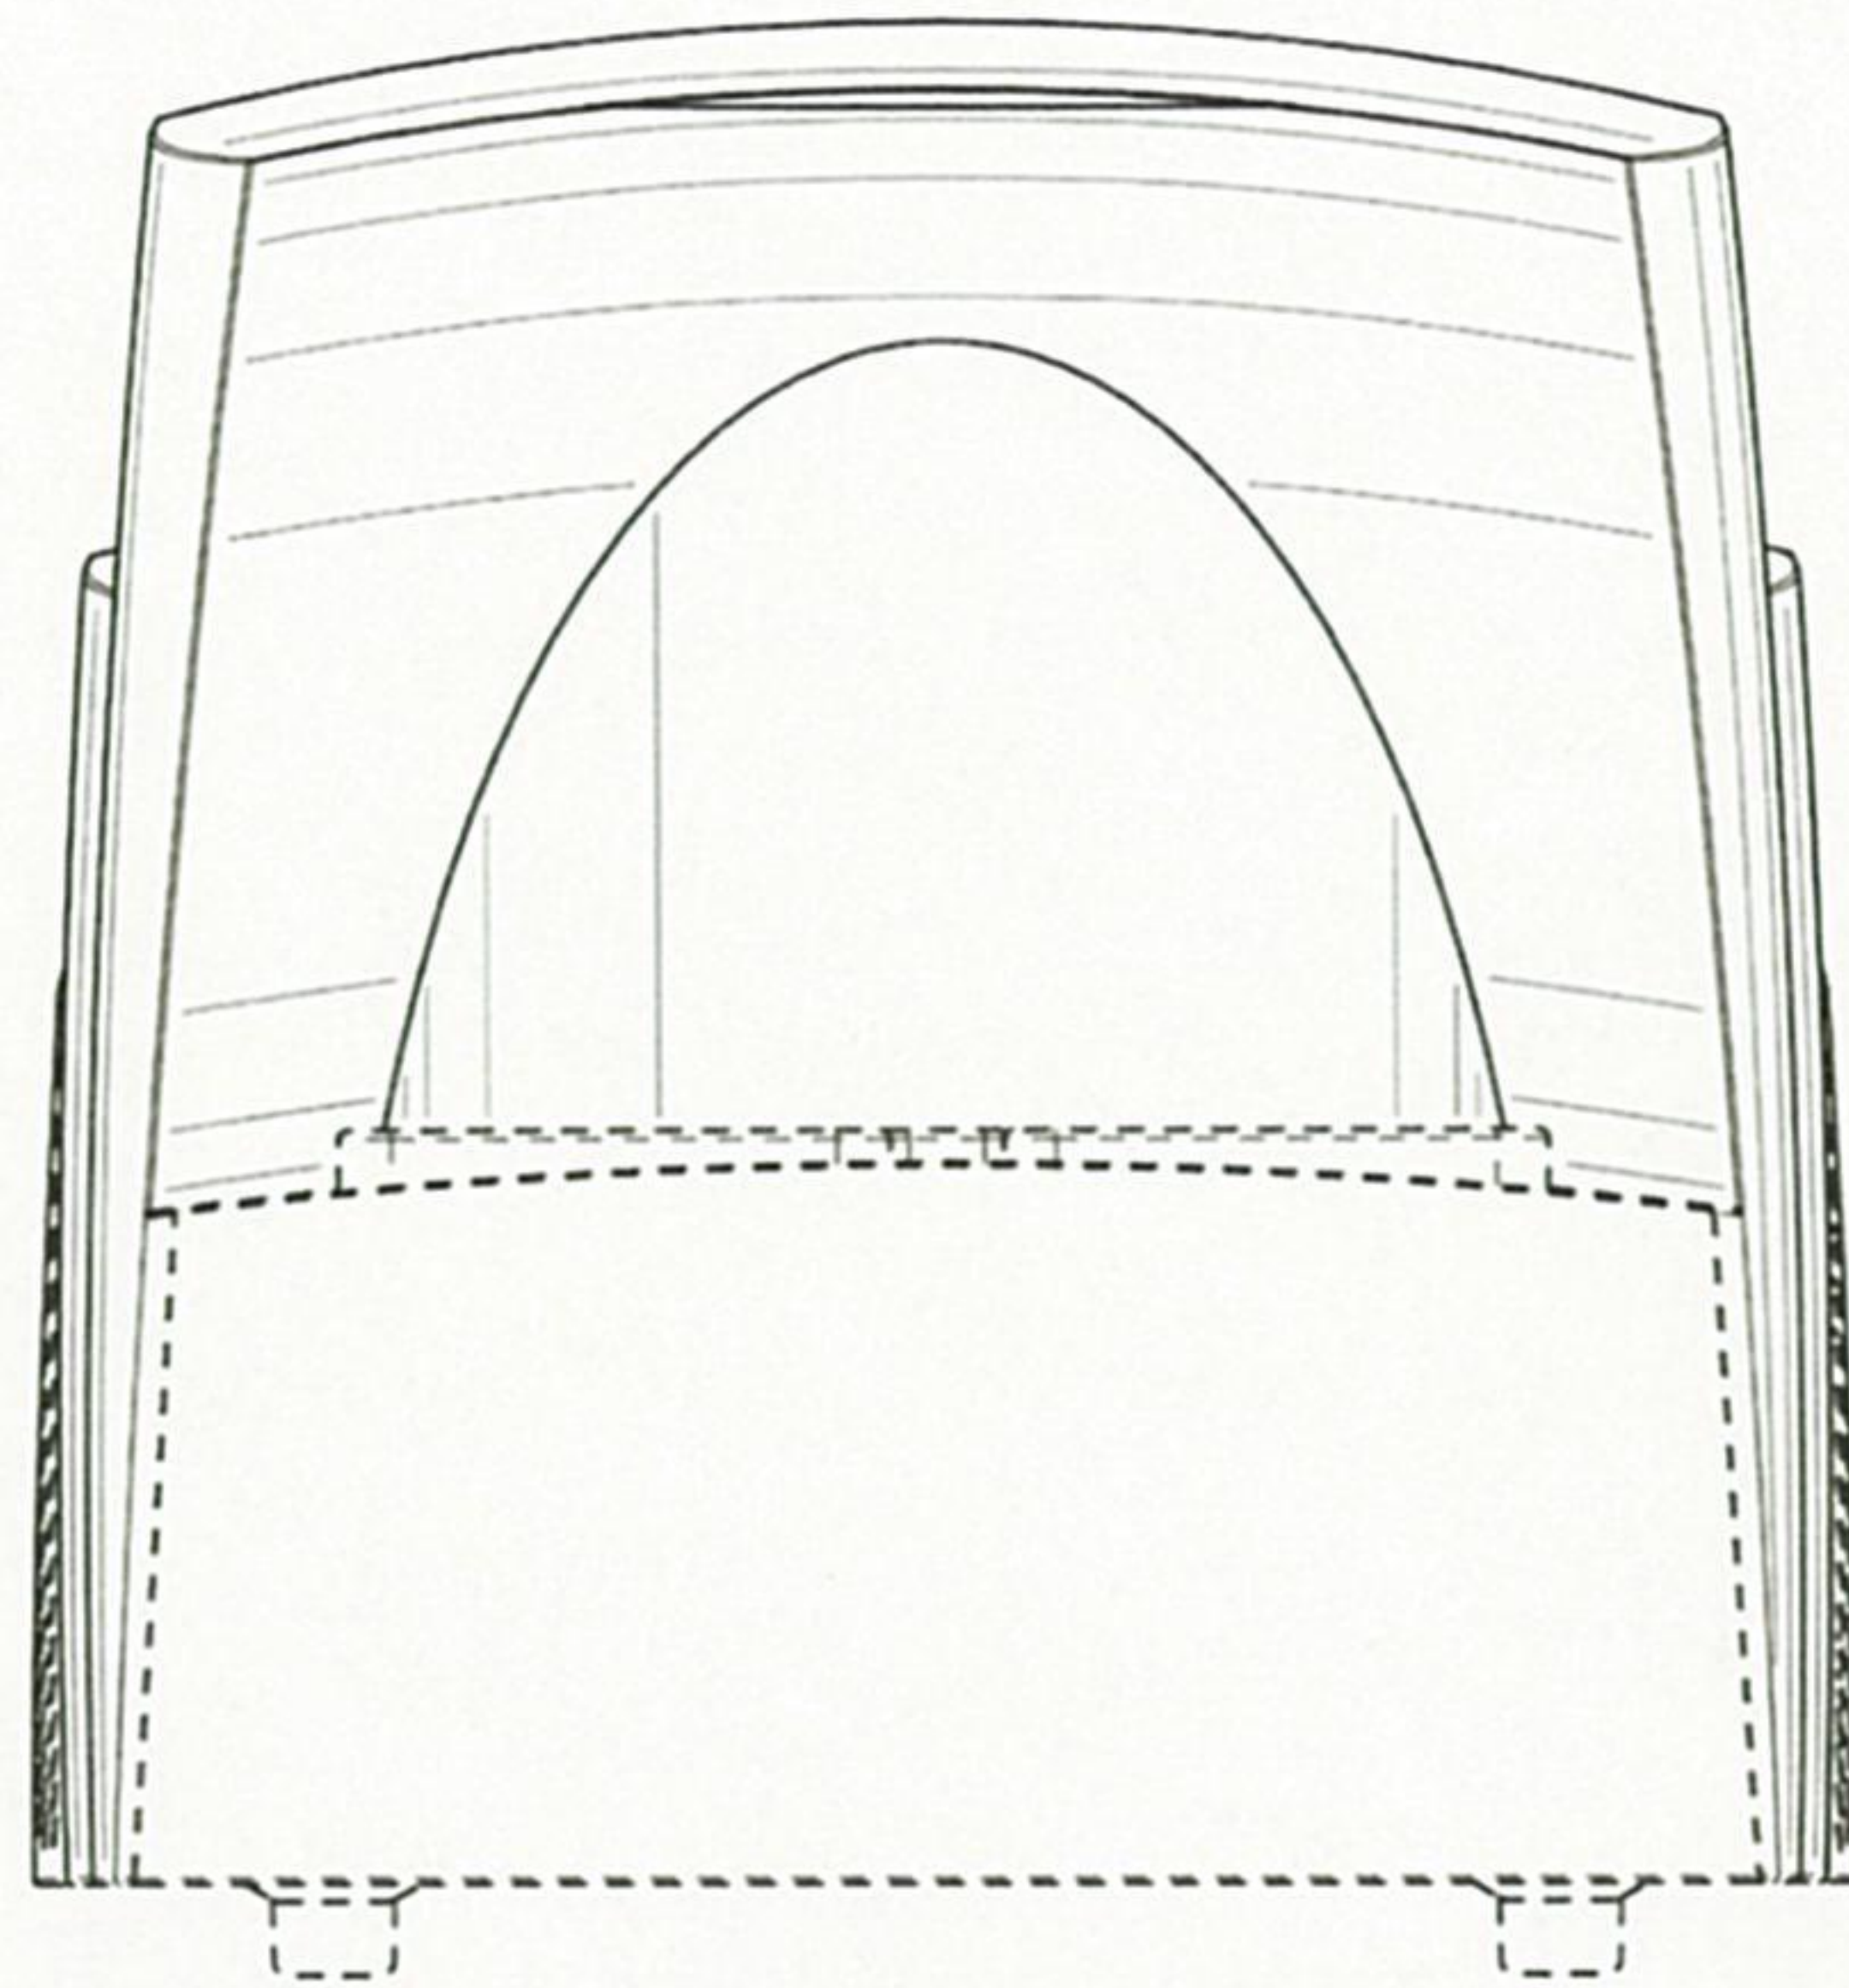


【前視圖】

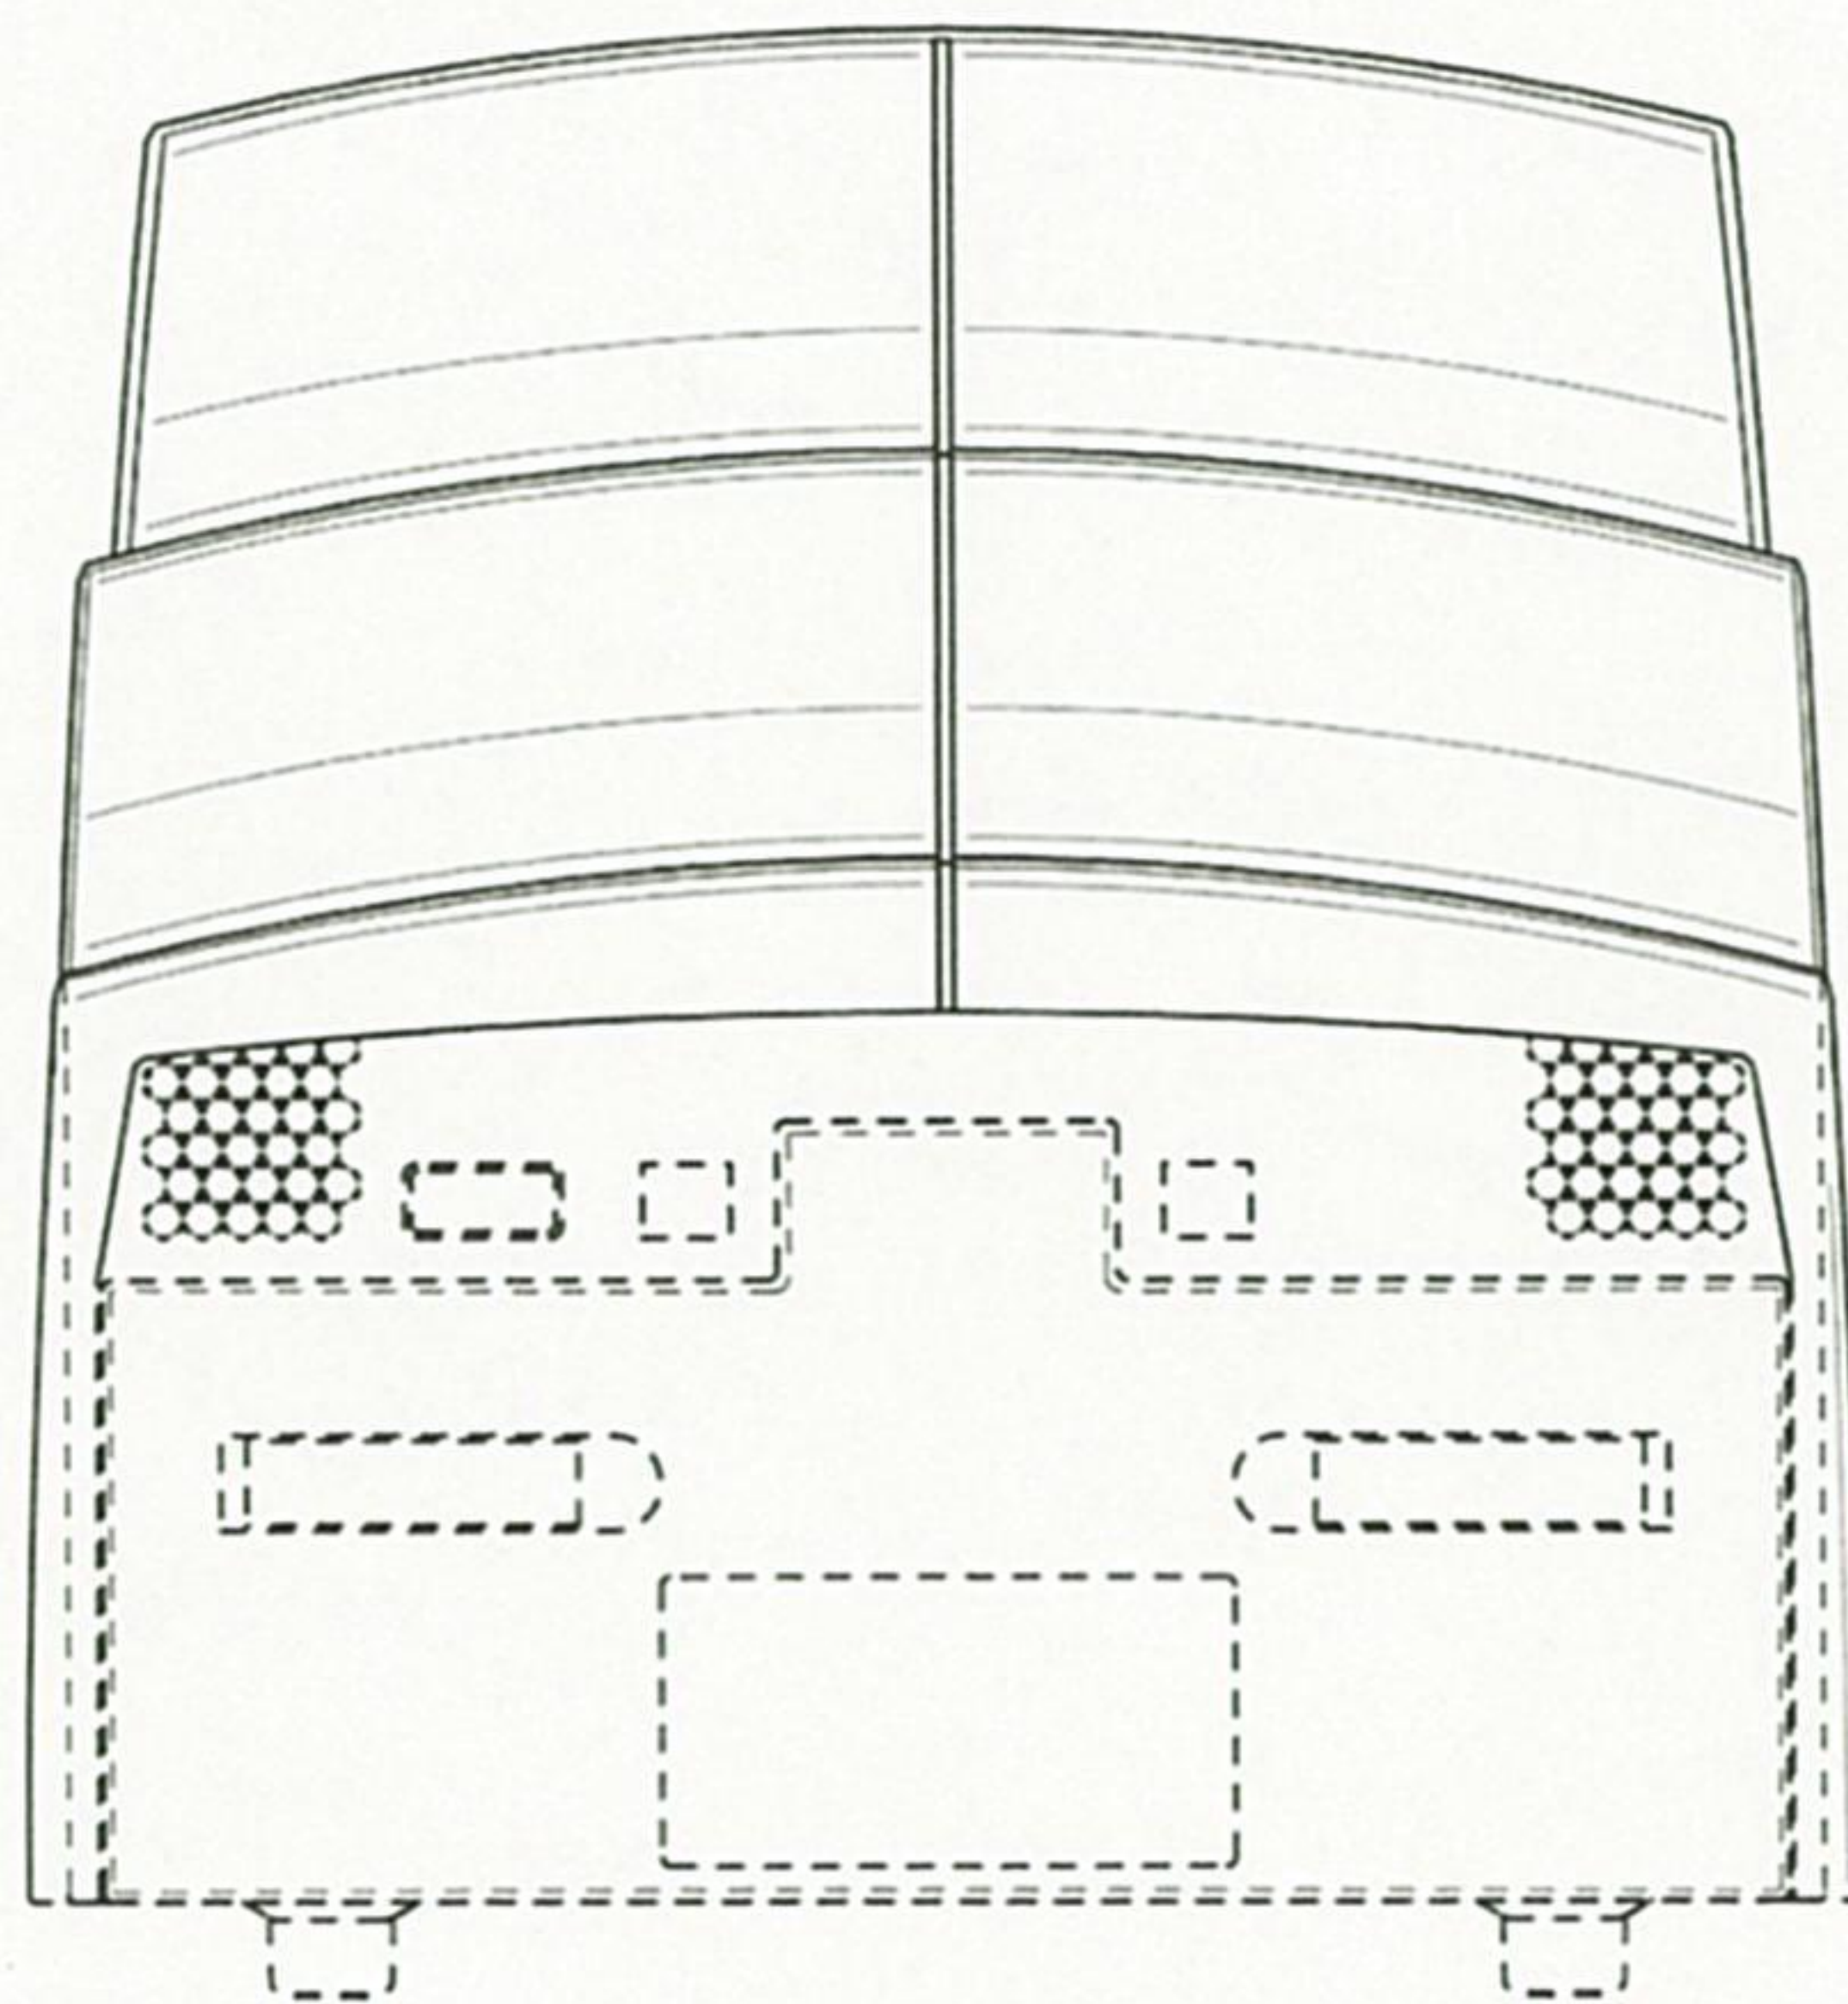


【後視圖】

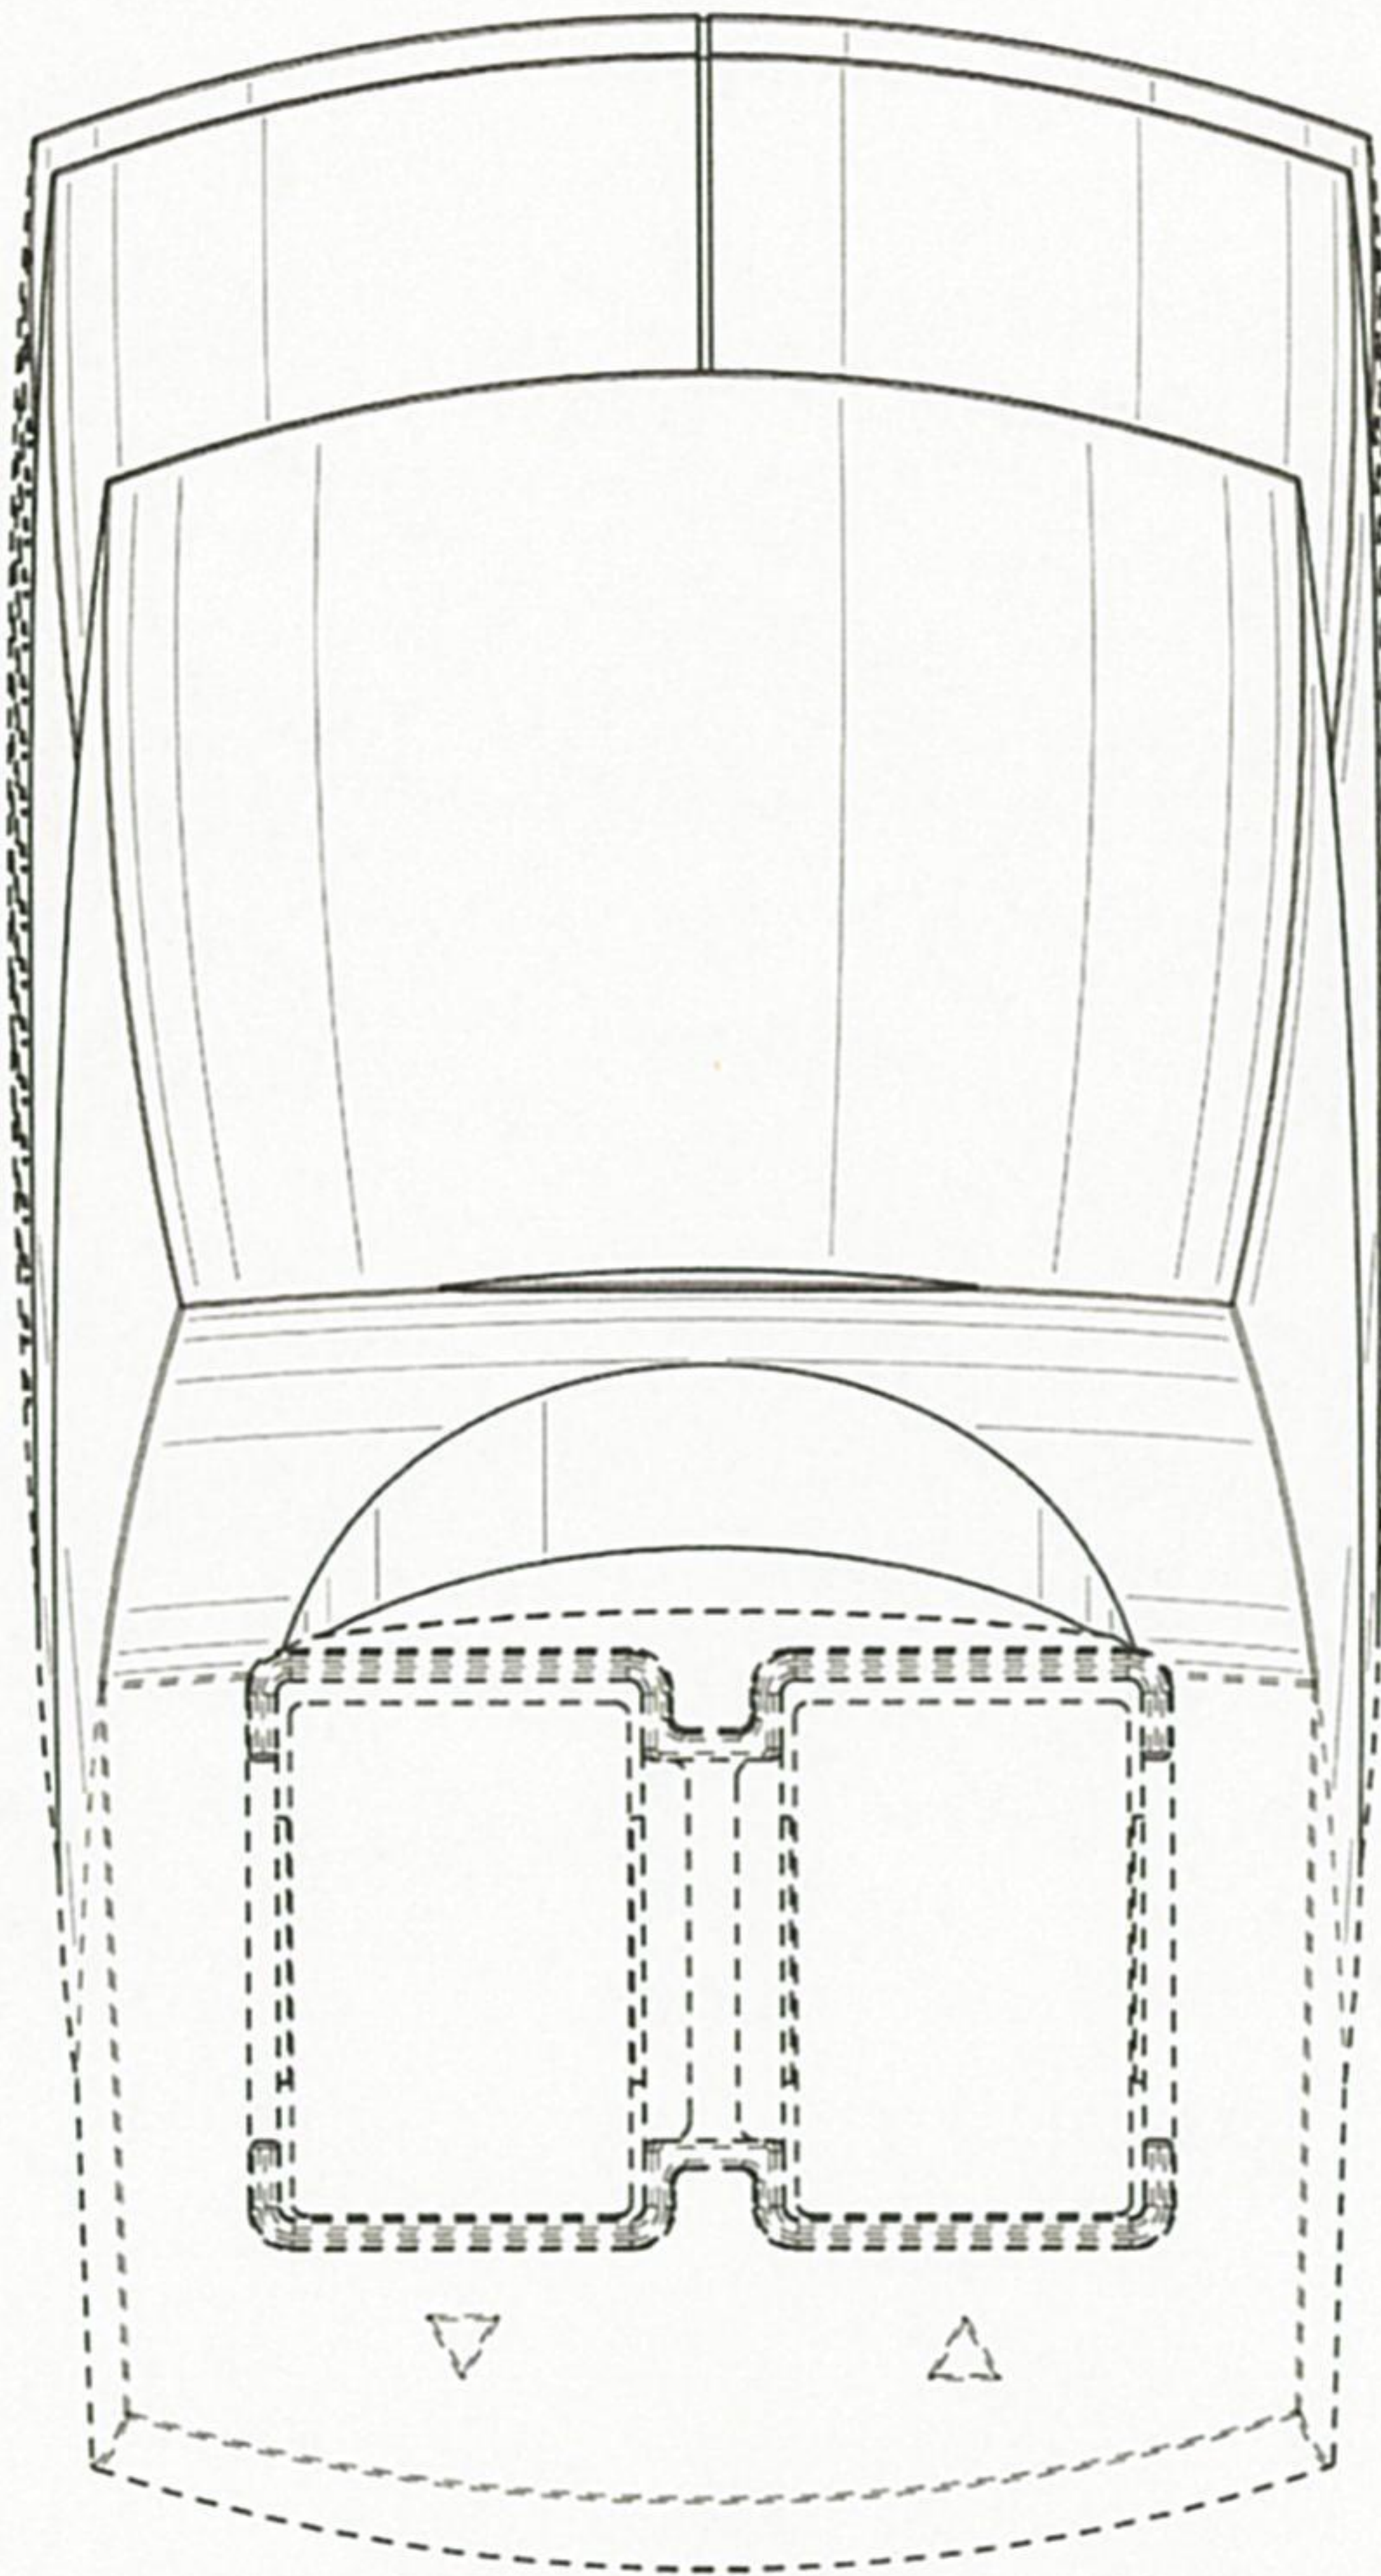


【 俯 視 圖 】

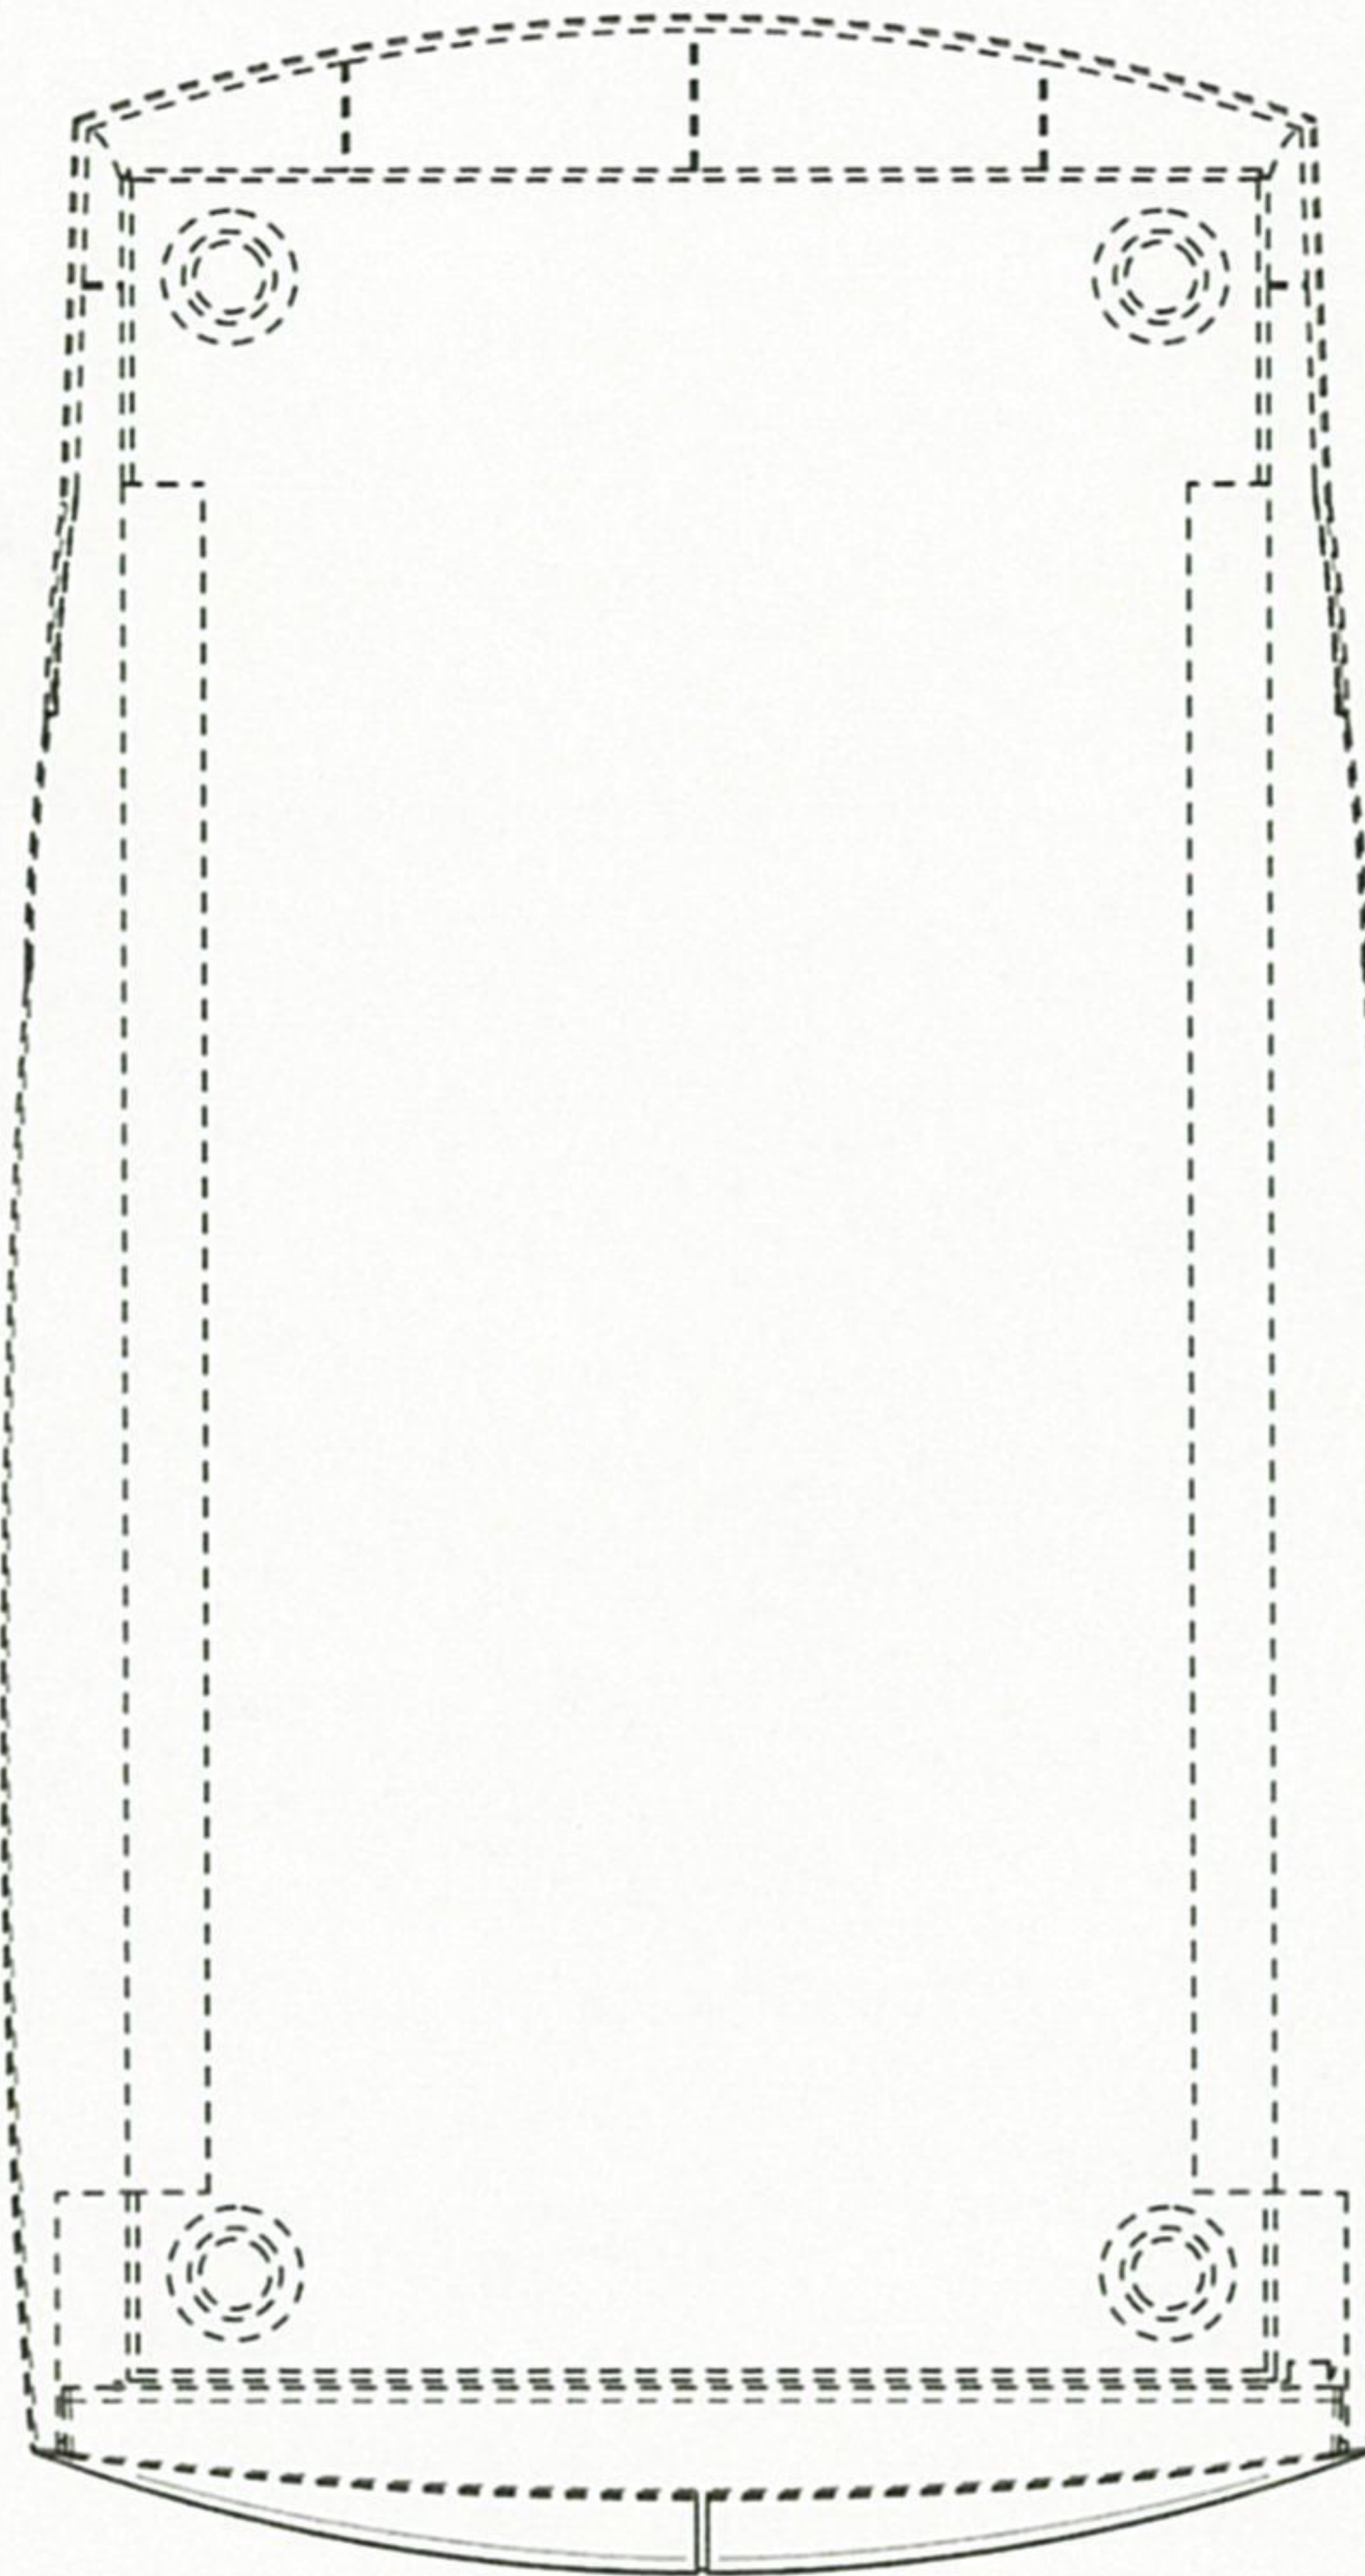


【仰視圖】

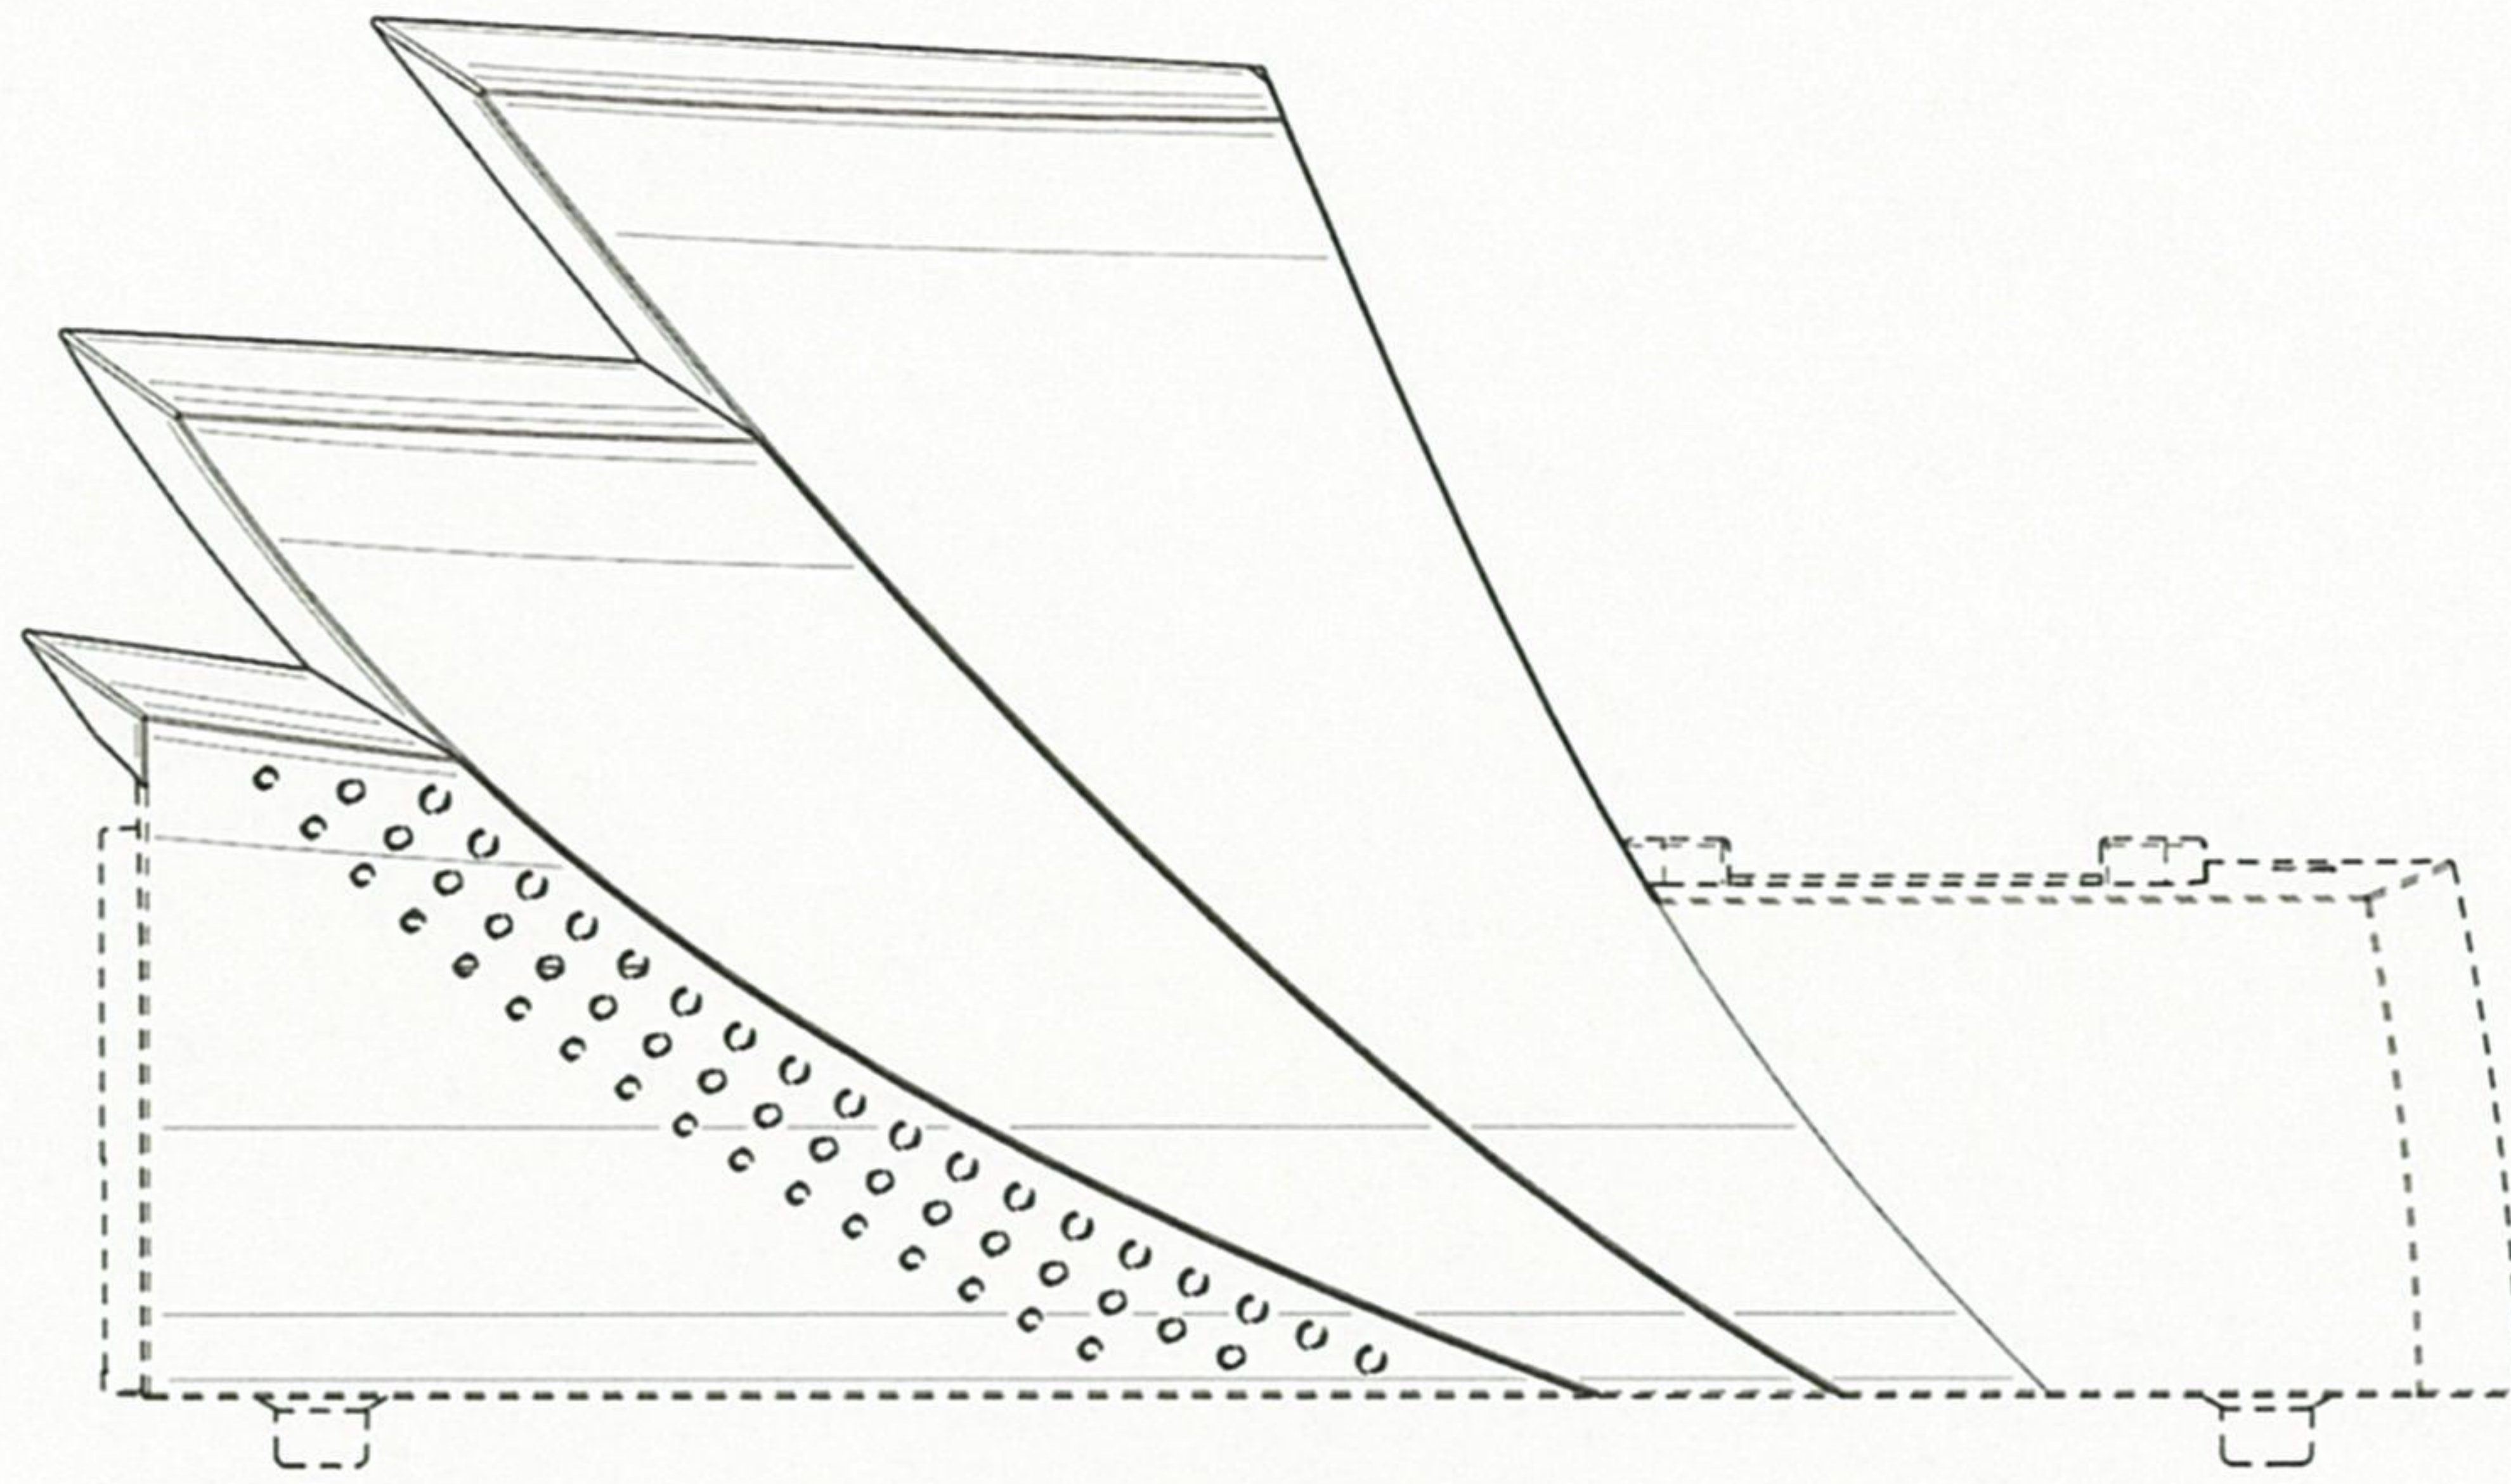


【左側視圖】

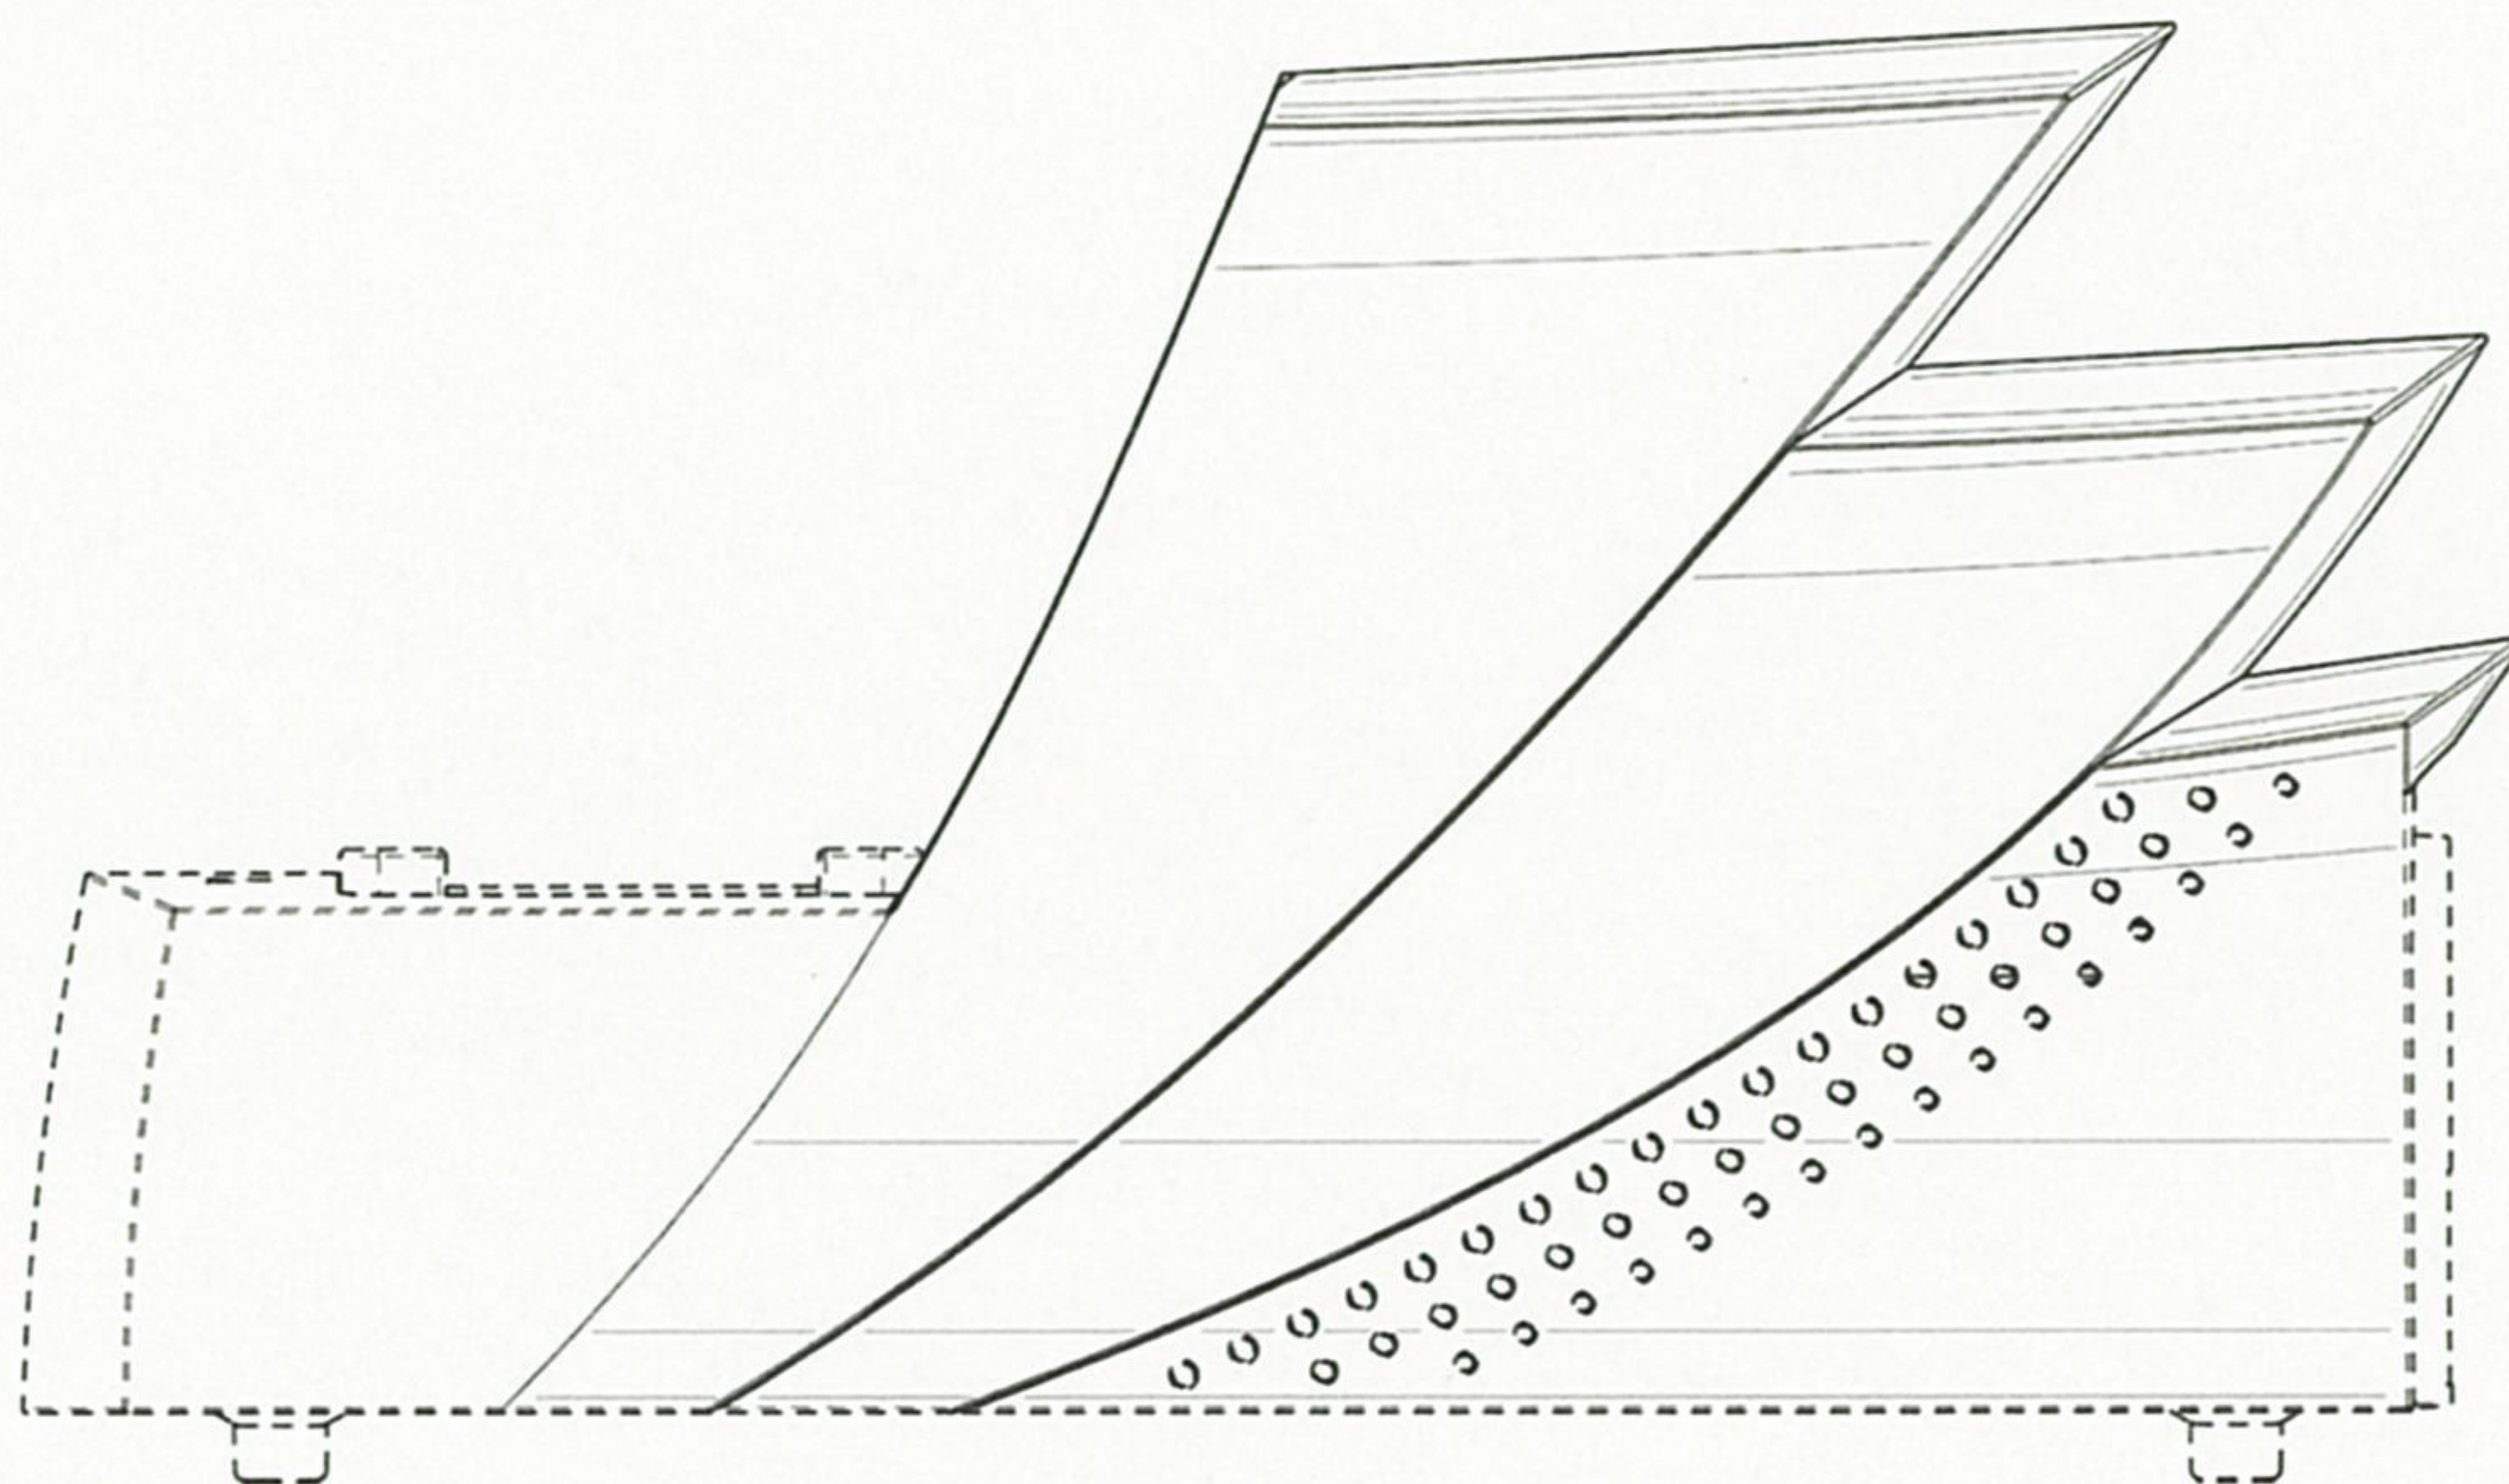


【右側視圖】

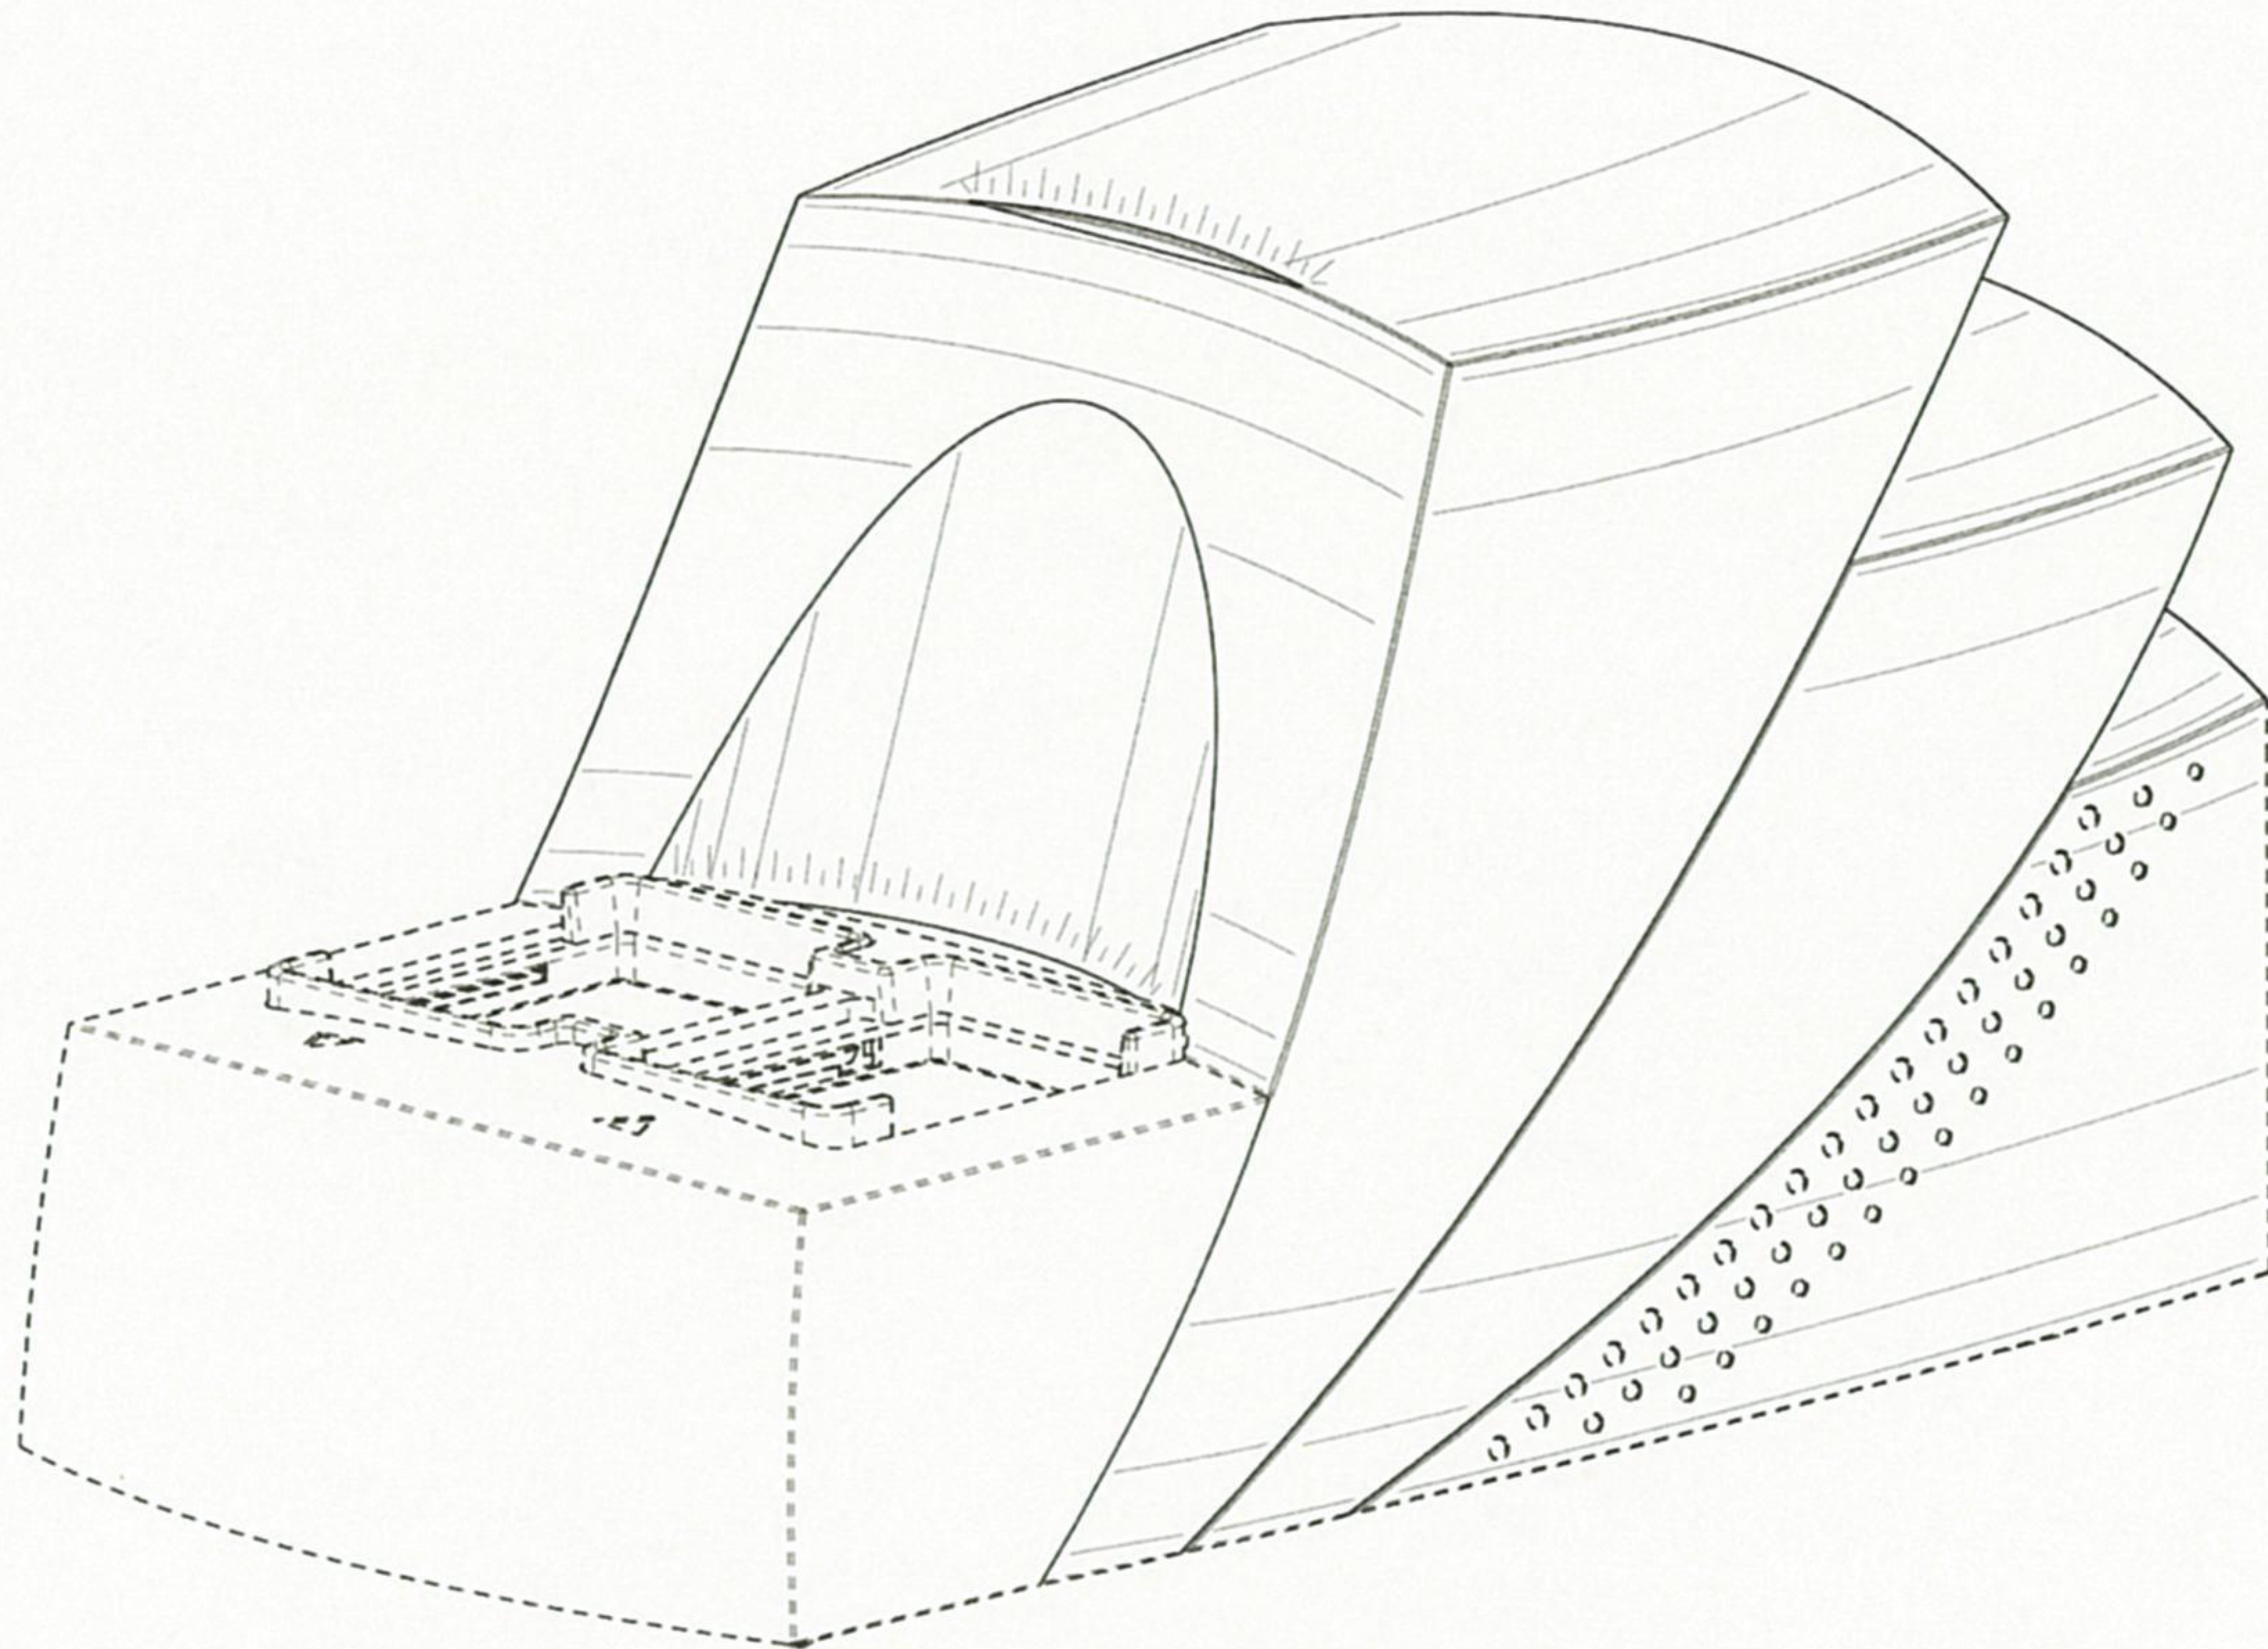


【表示發光狀態立體參考圖1】

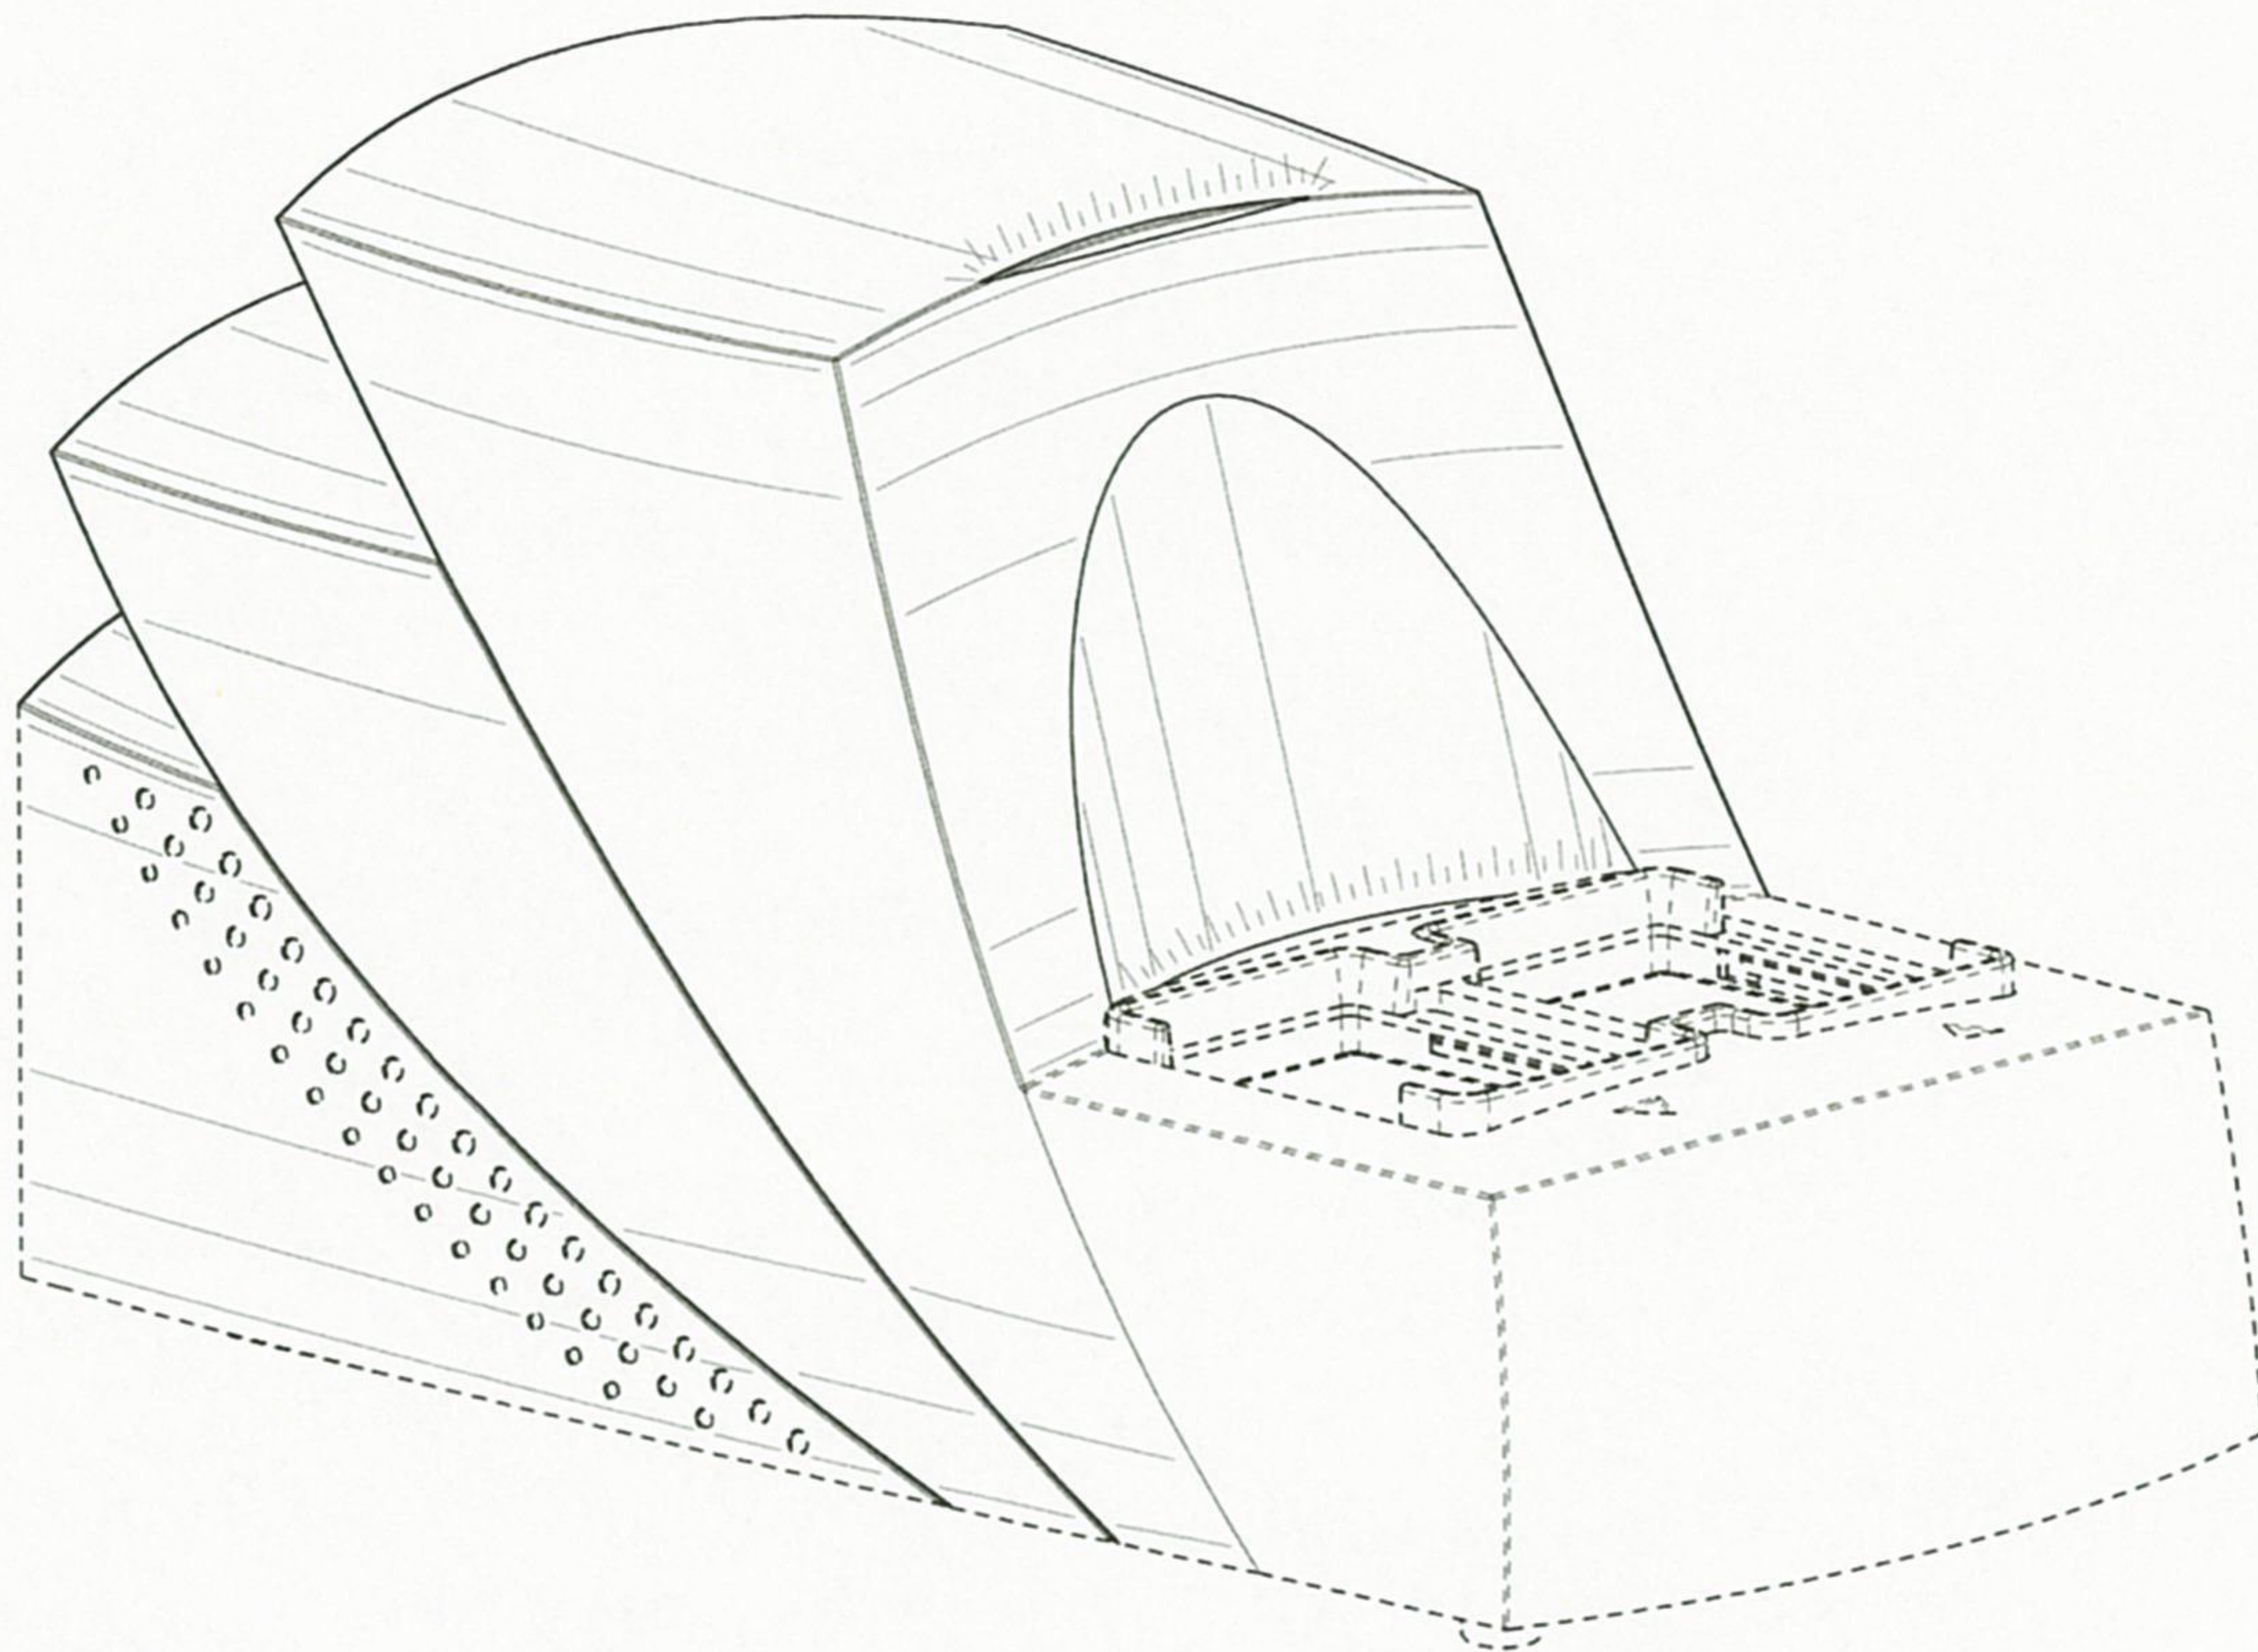


【表示發光狀態立體參考圖2】

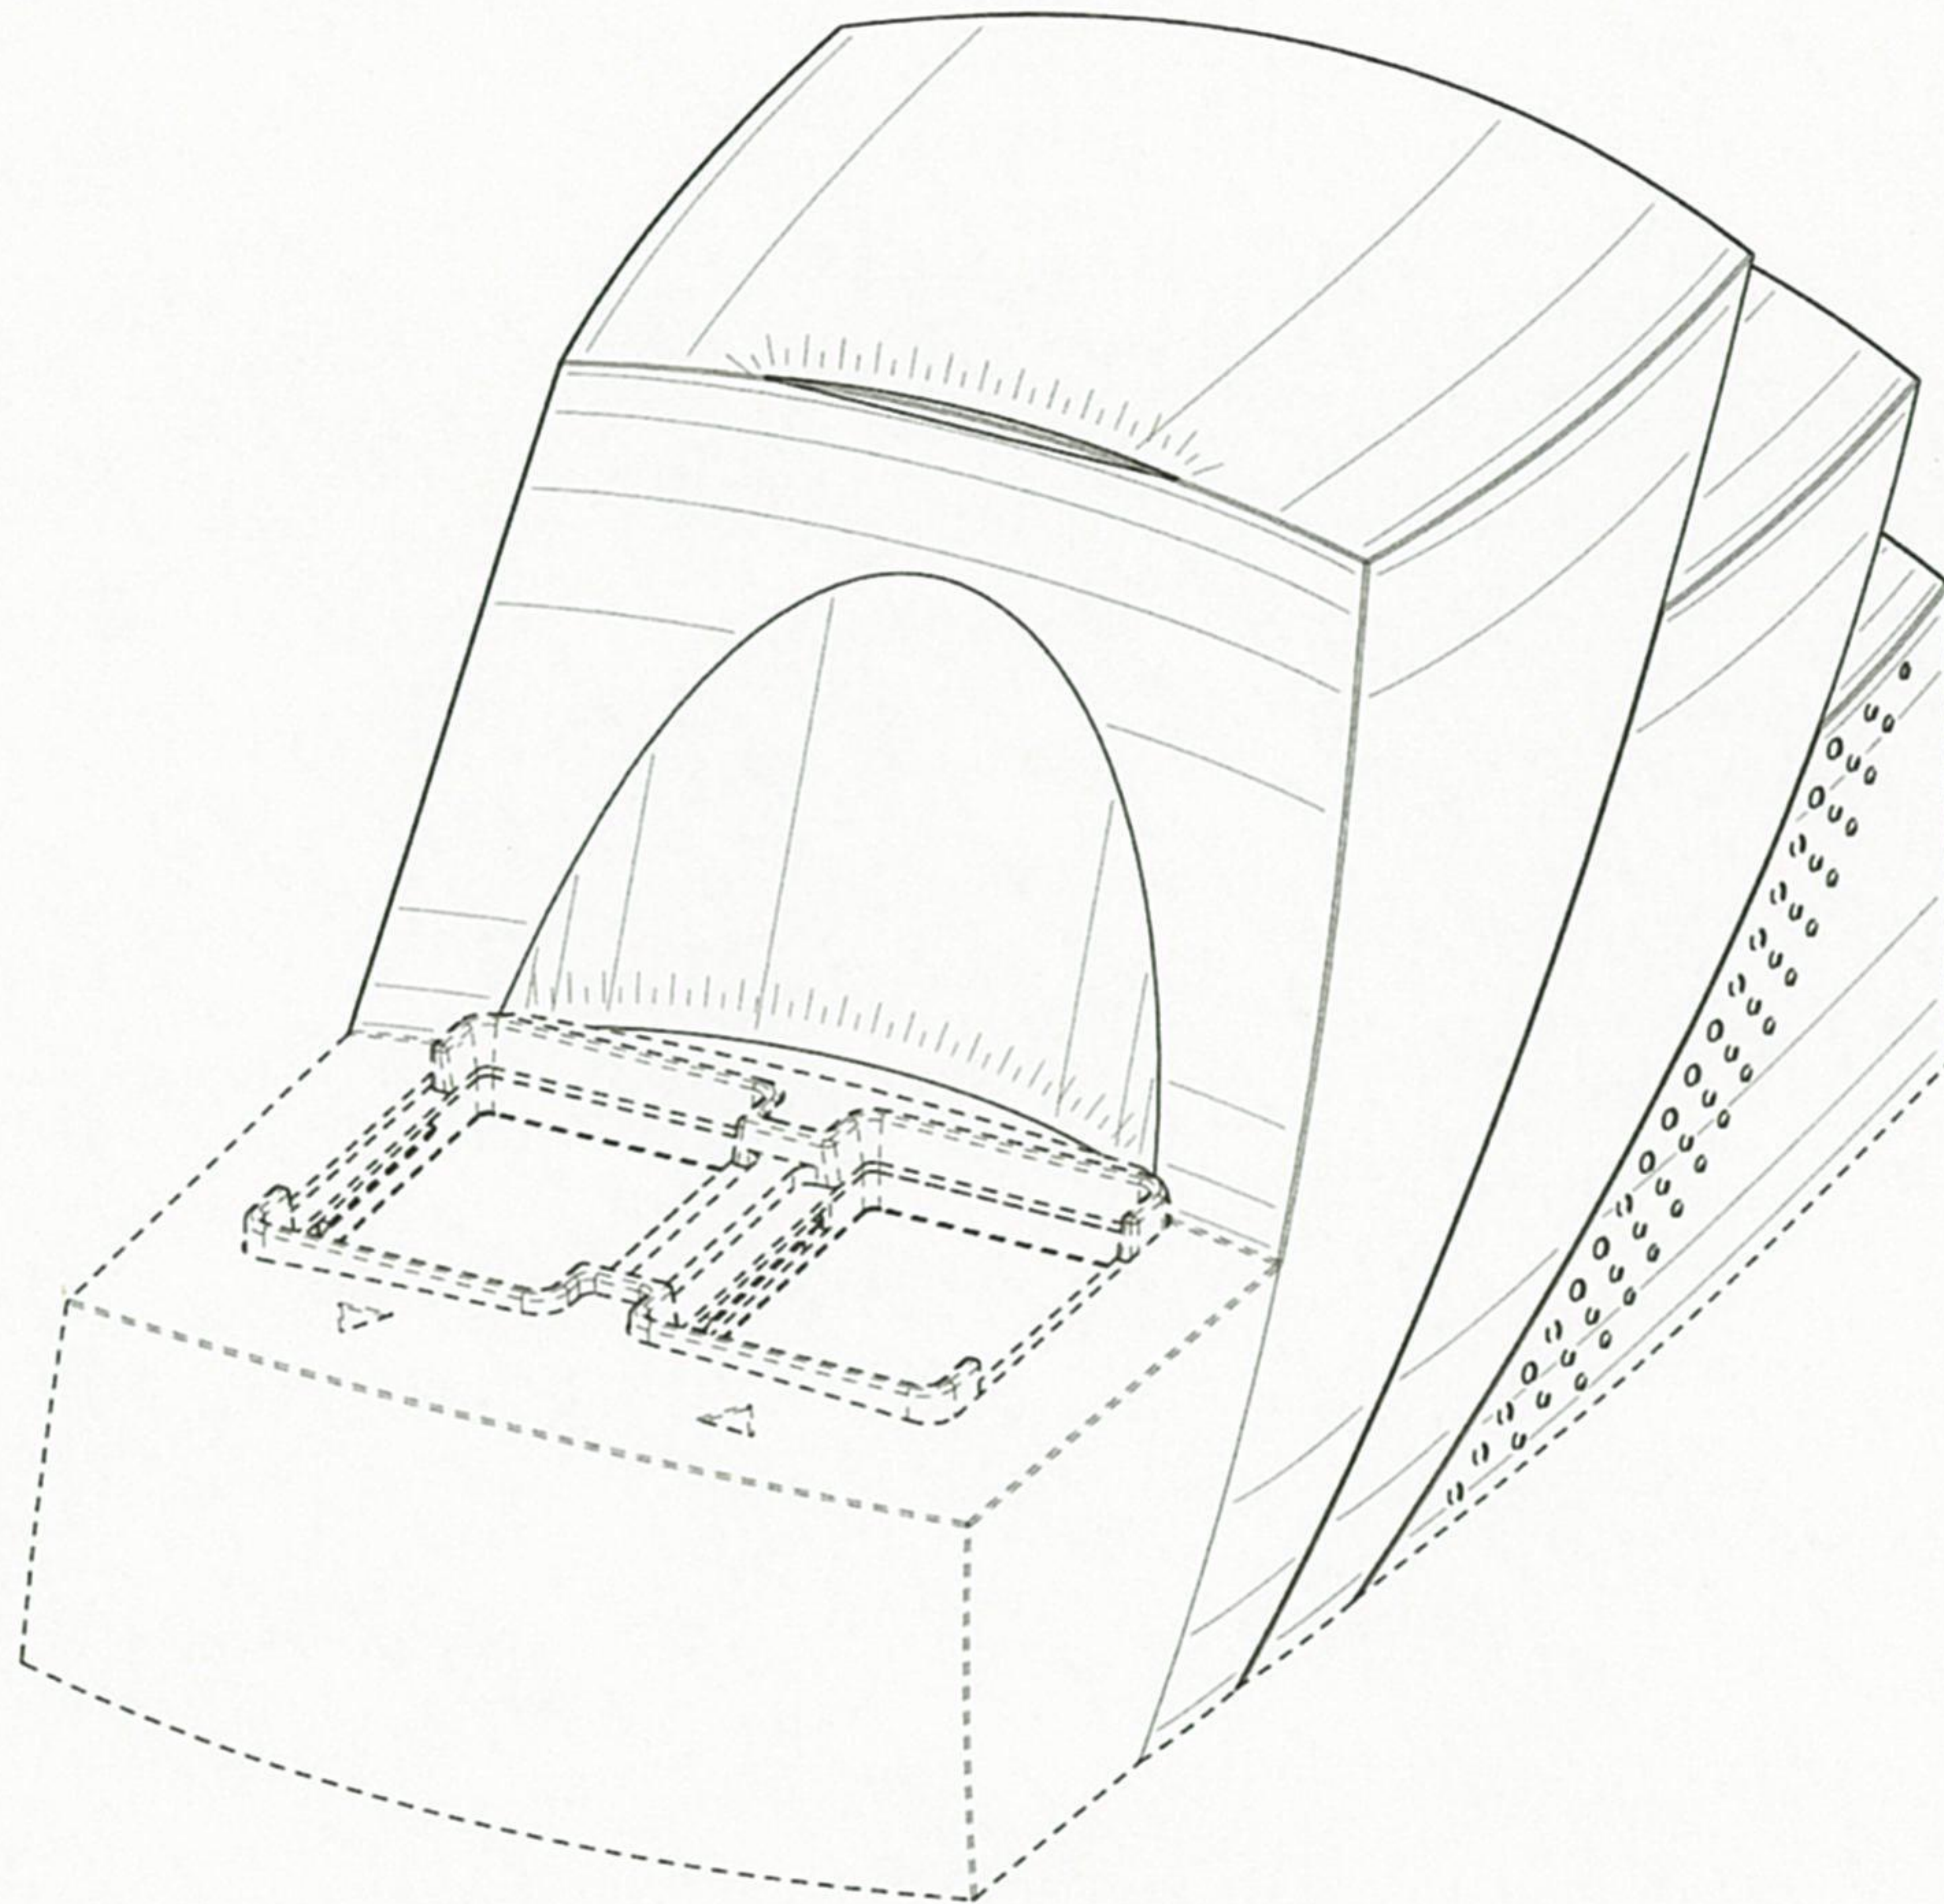


【表示發光狀態立體參考圖3】

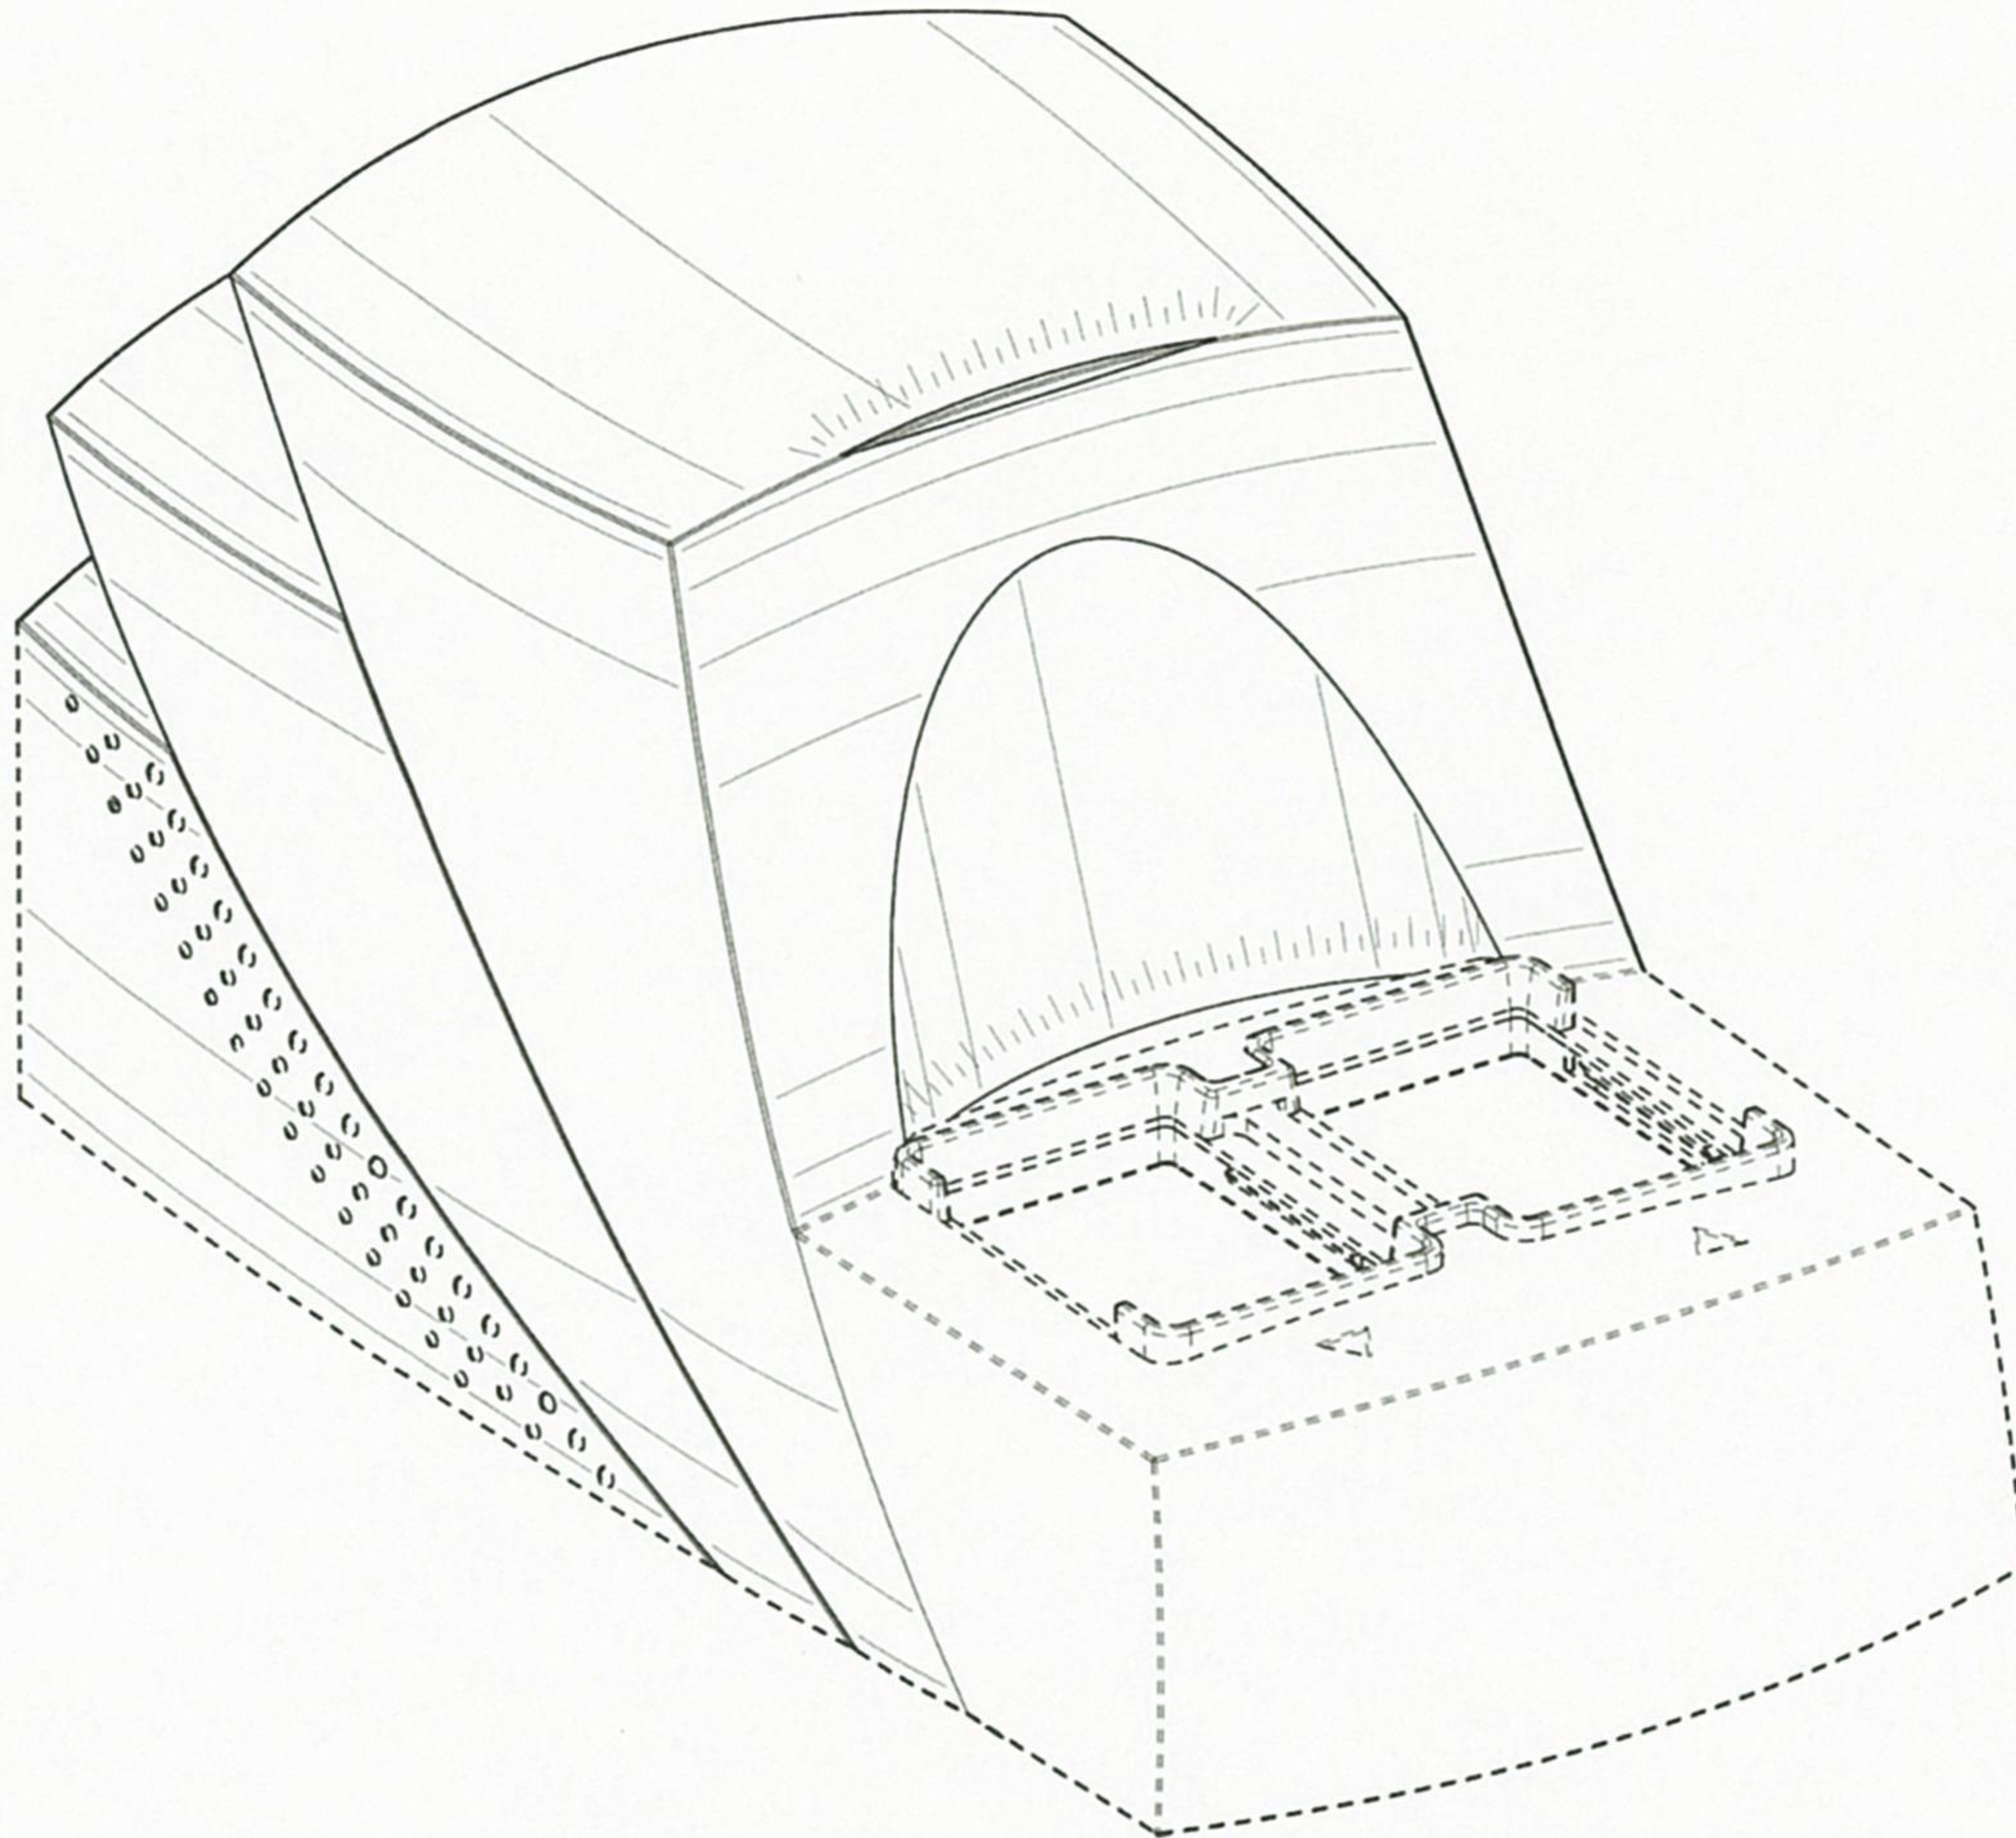


【表示發光狀態立體參考圖4】

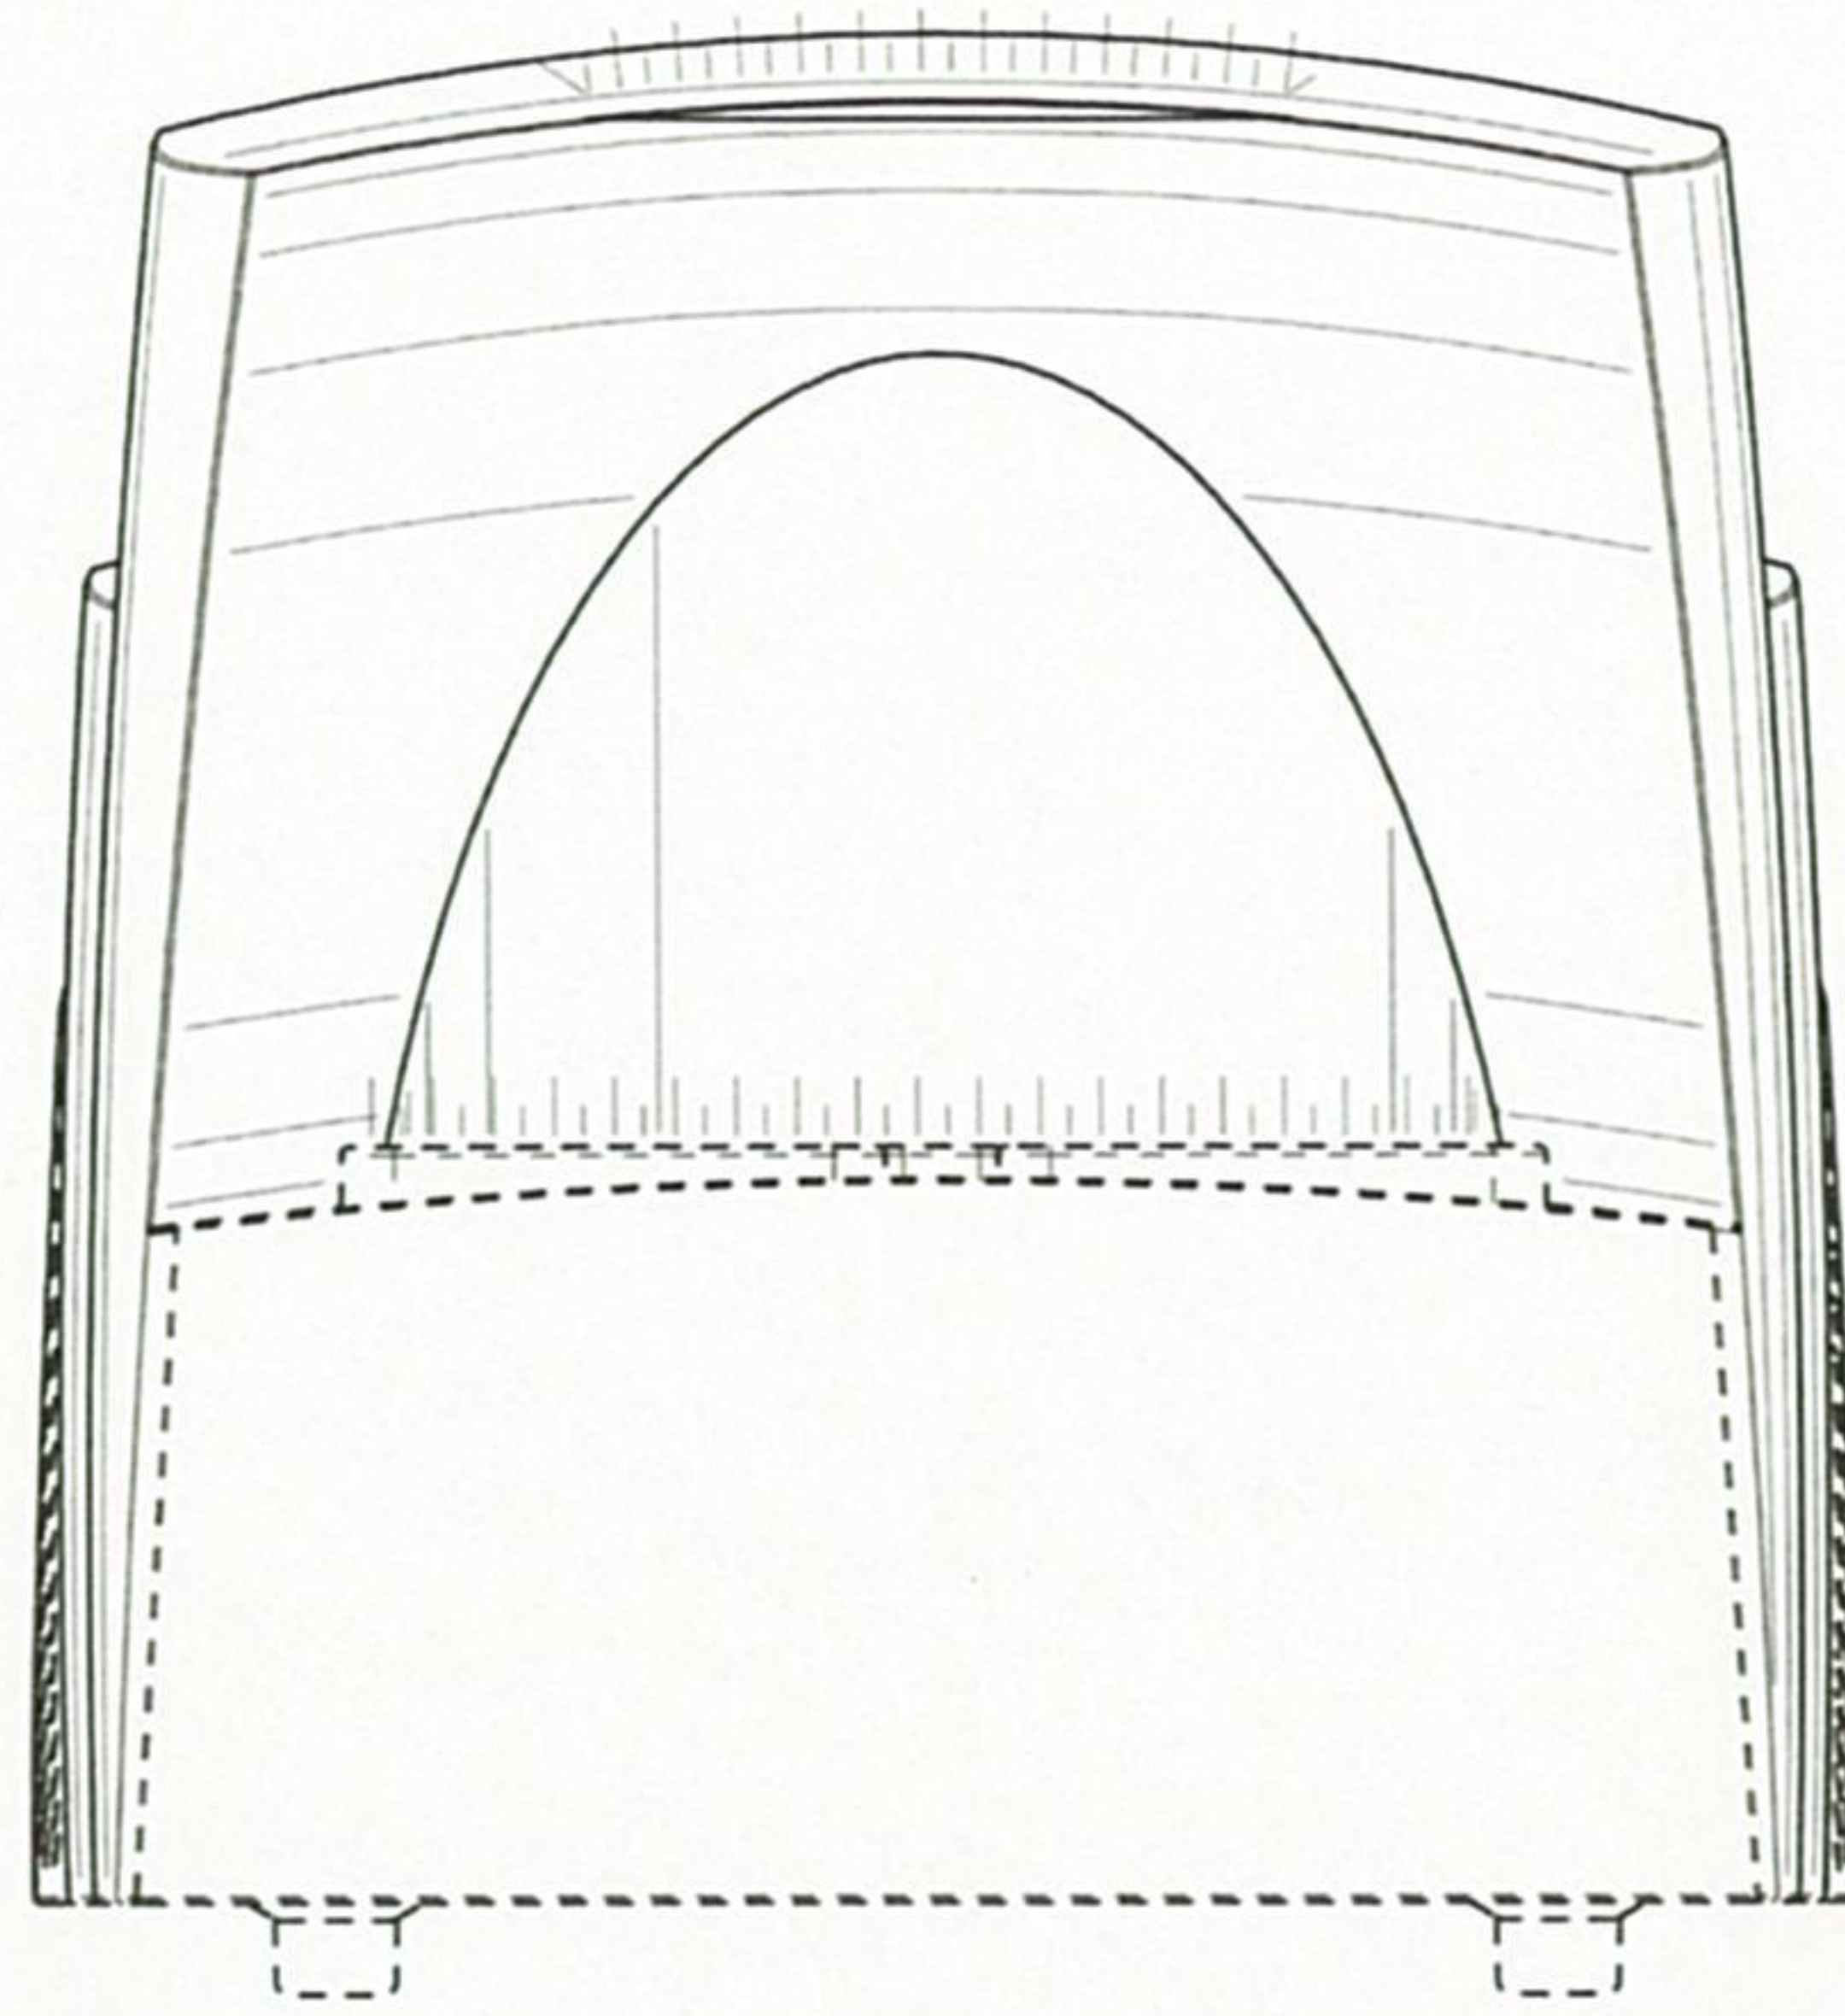


【表示發光狀態前視參考圖】

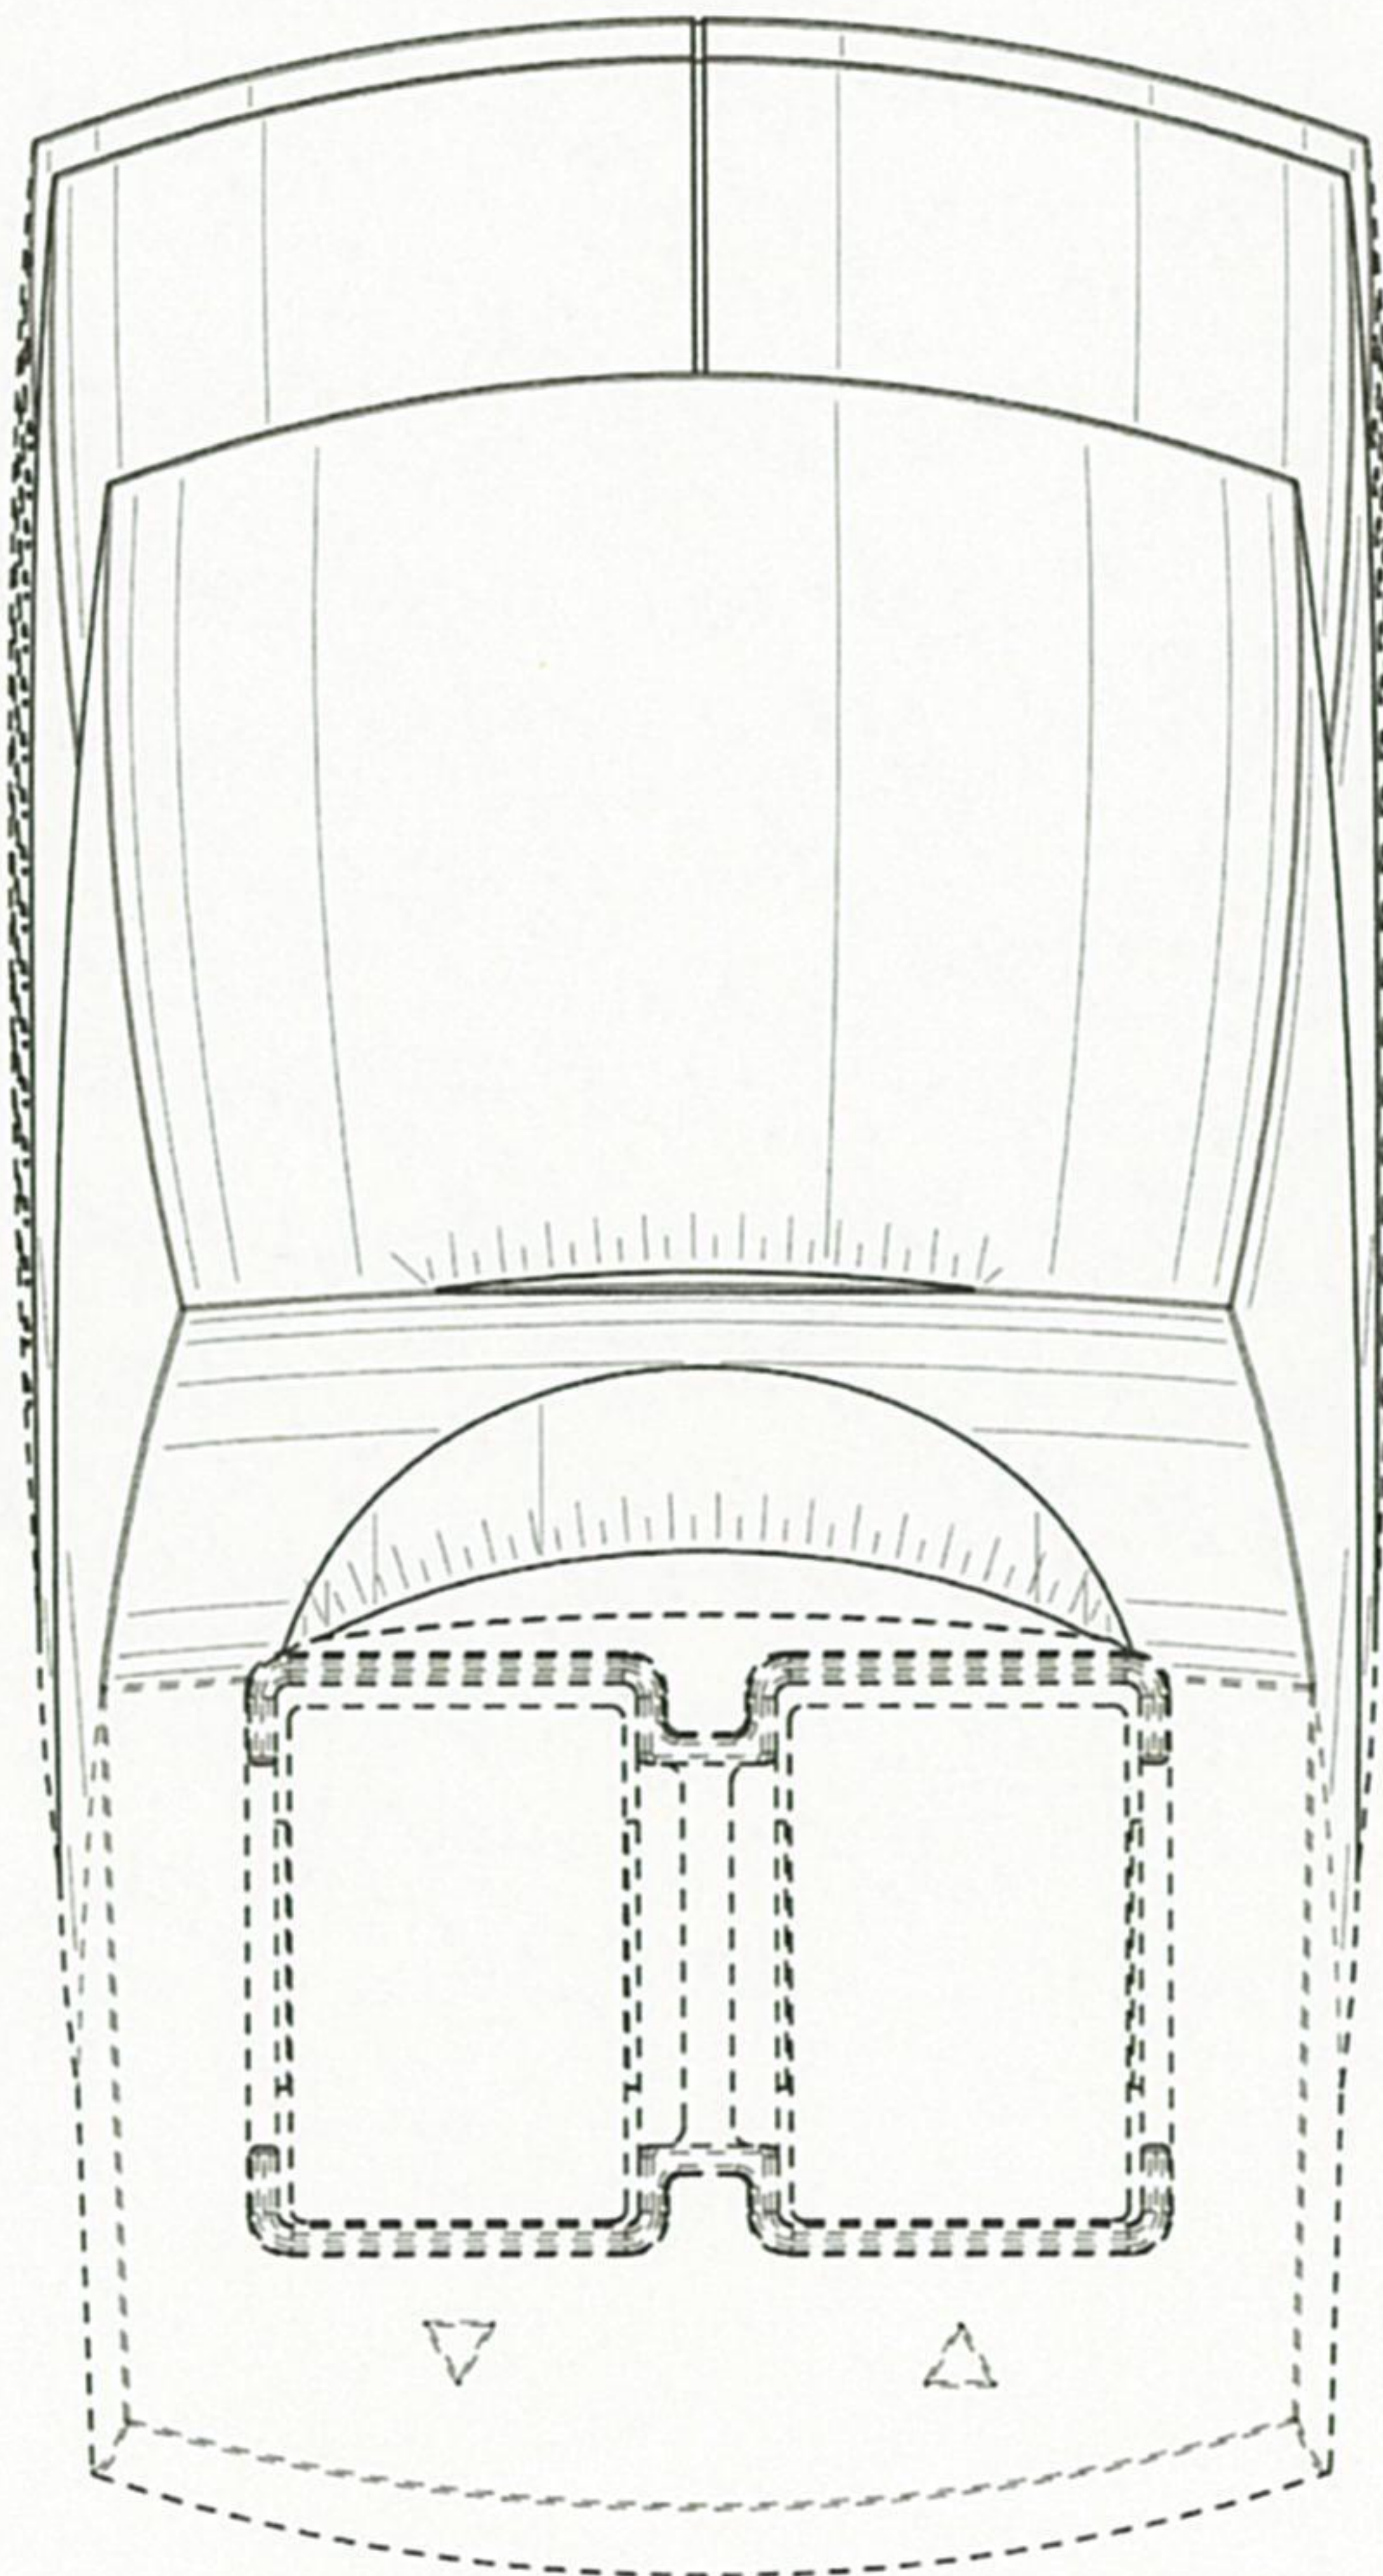


【表示發光狀態俯視參考圖】

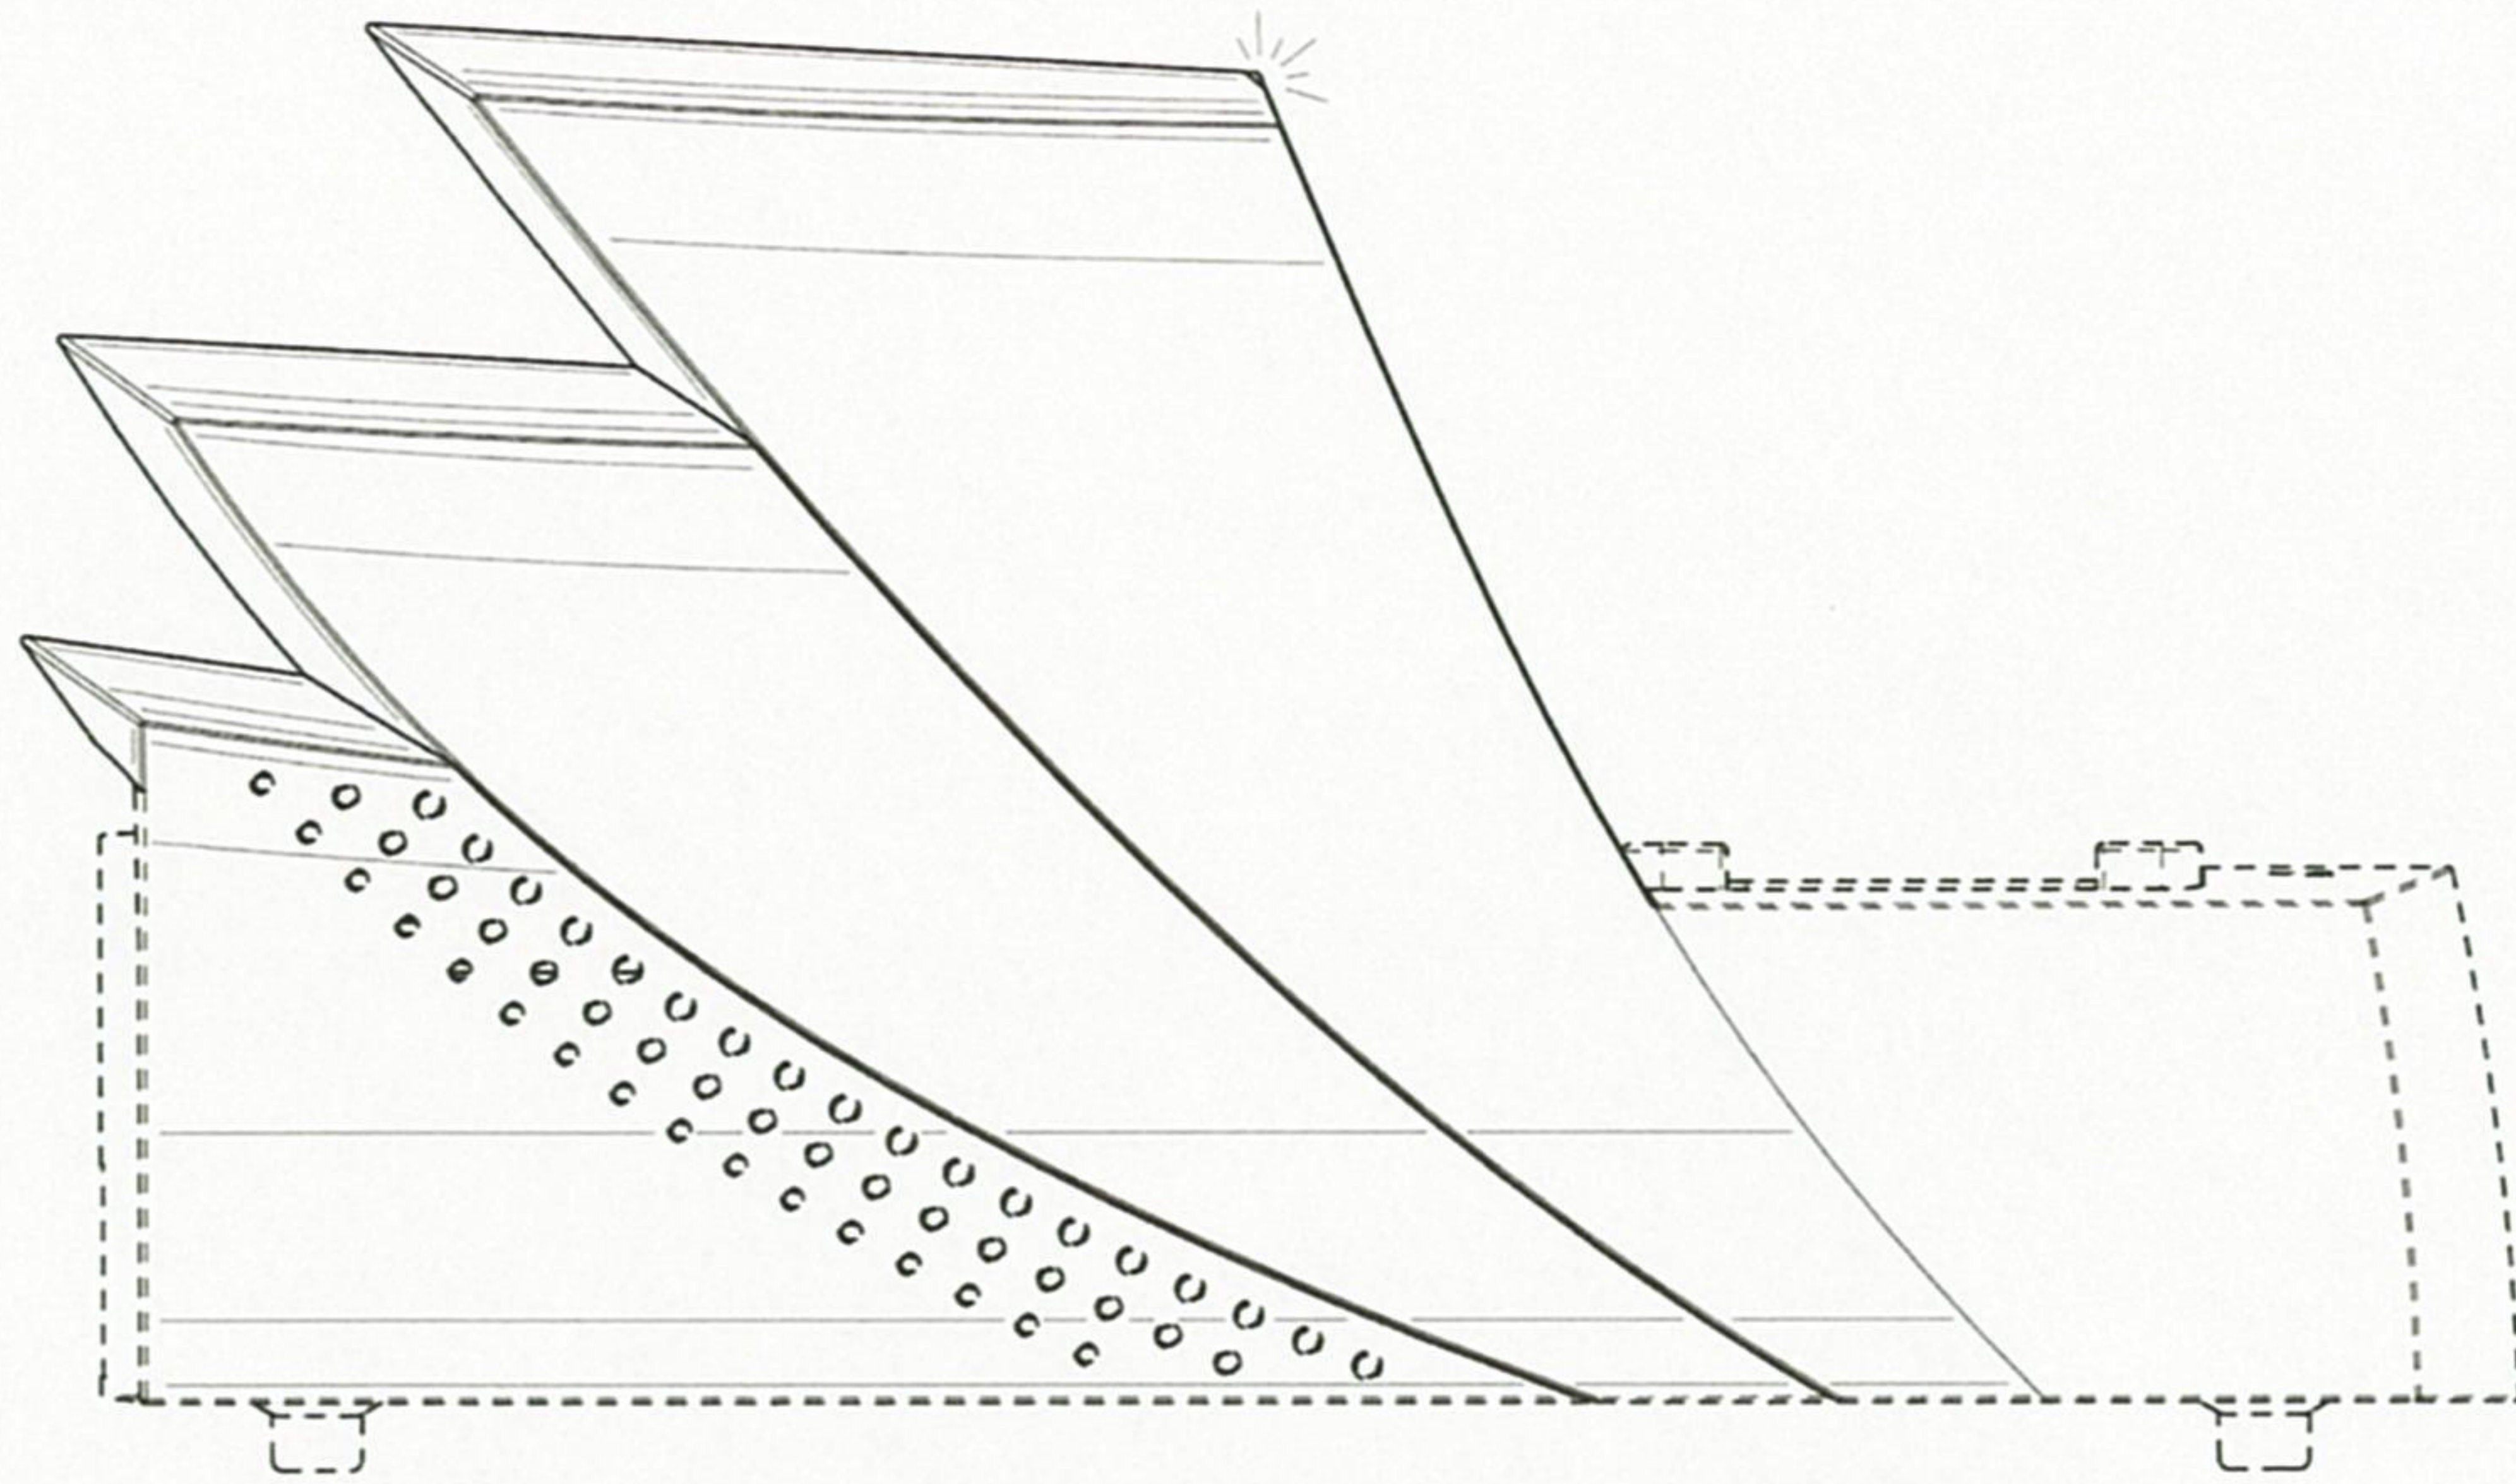


【表示發光狀態左側視參考圖】

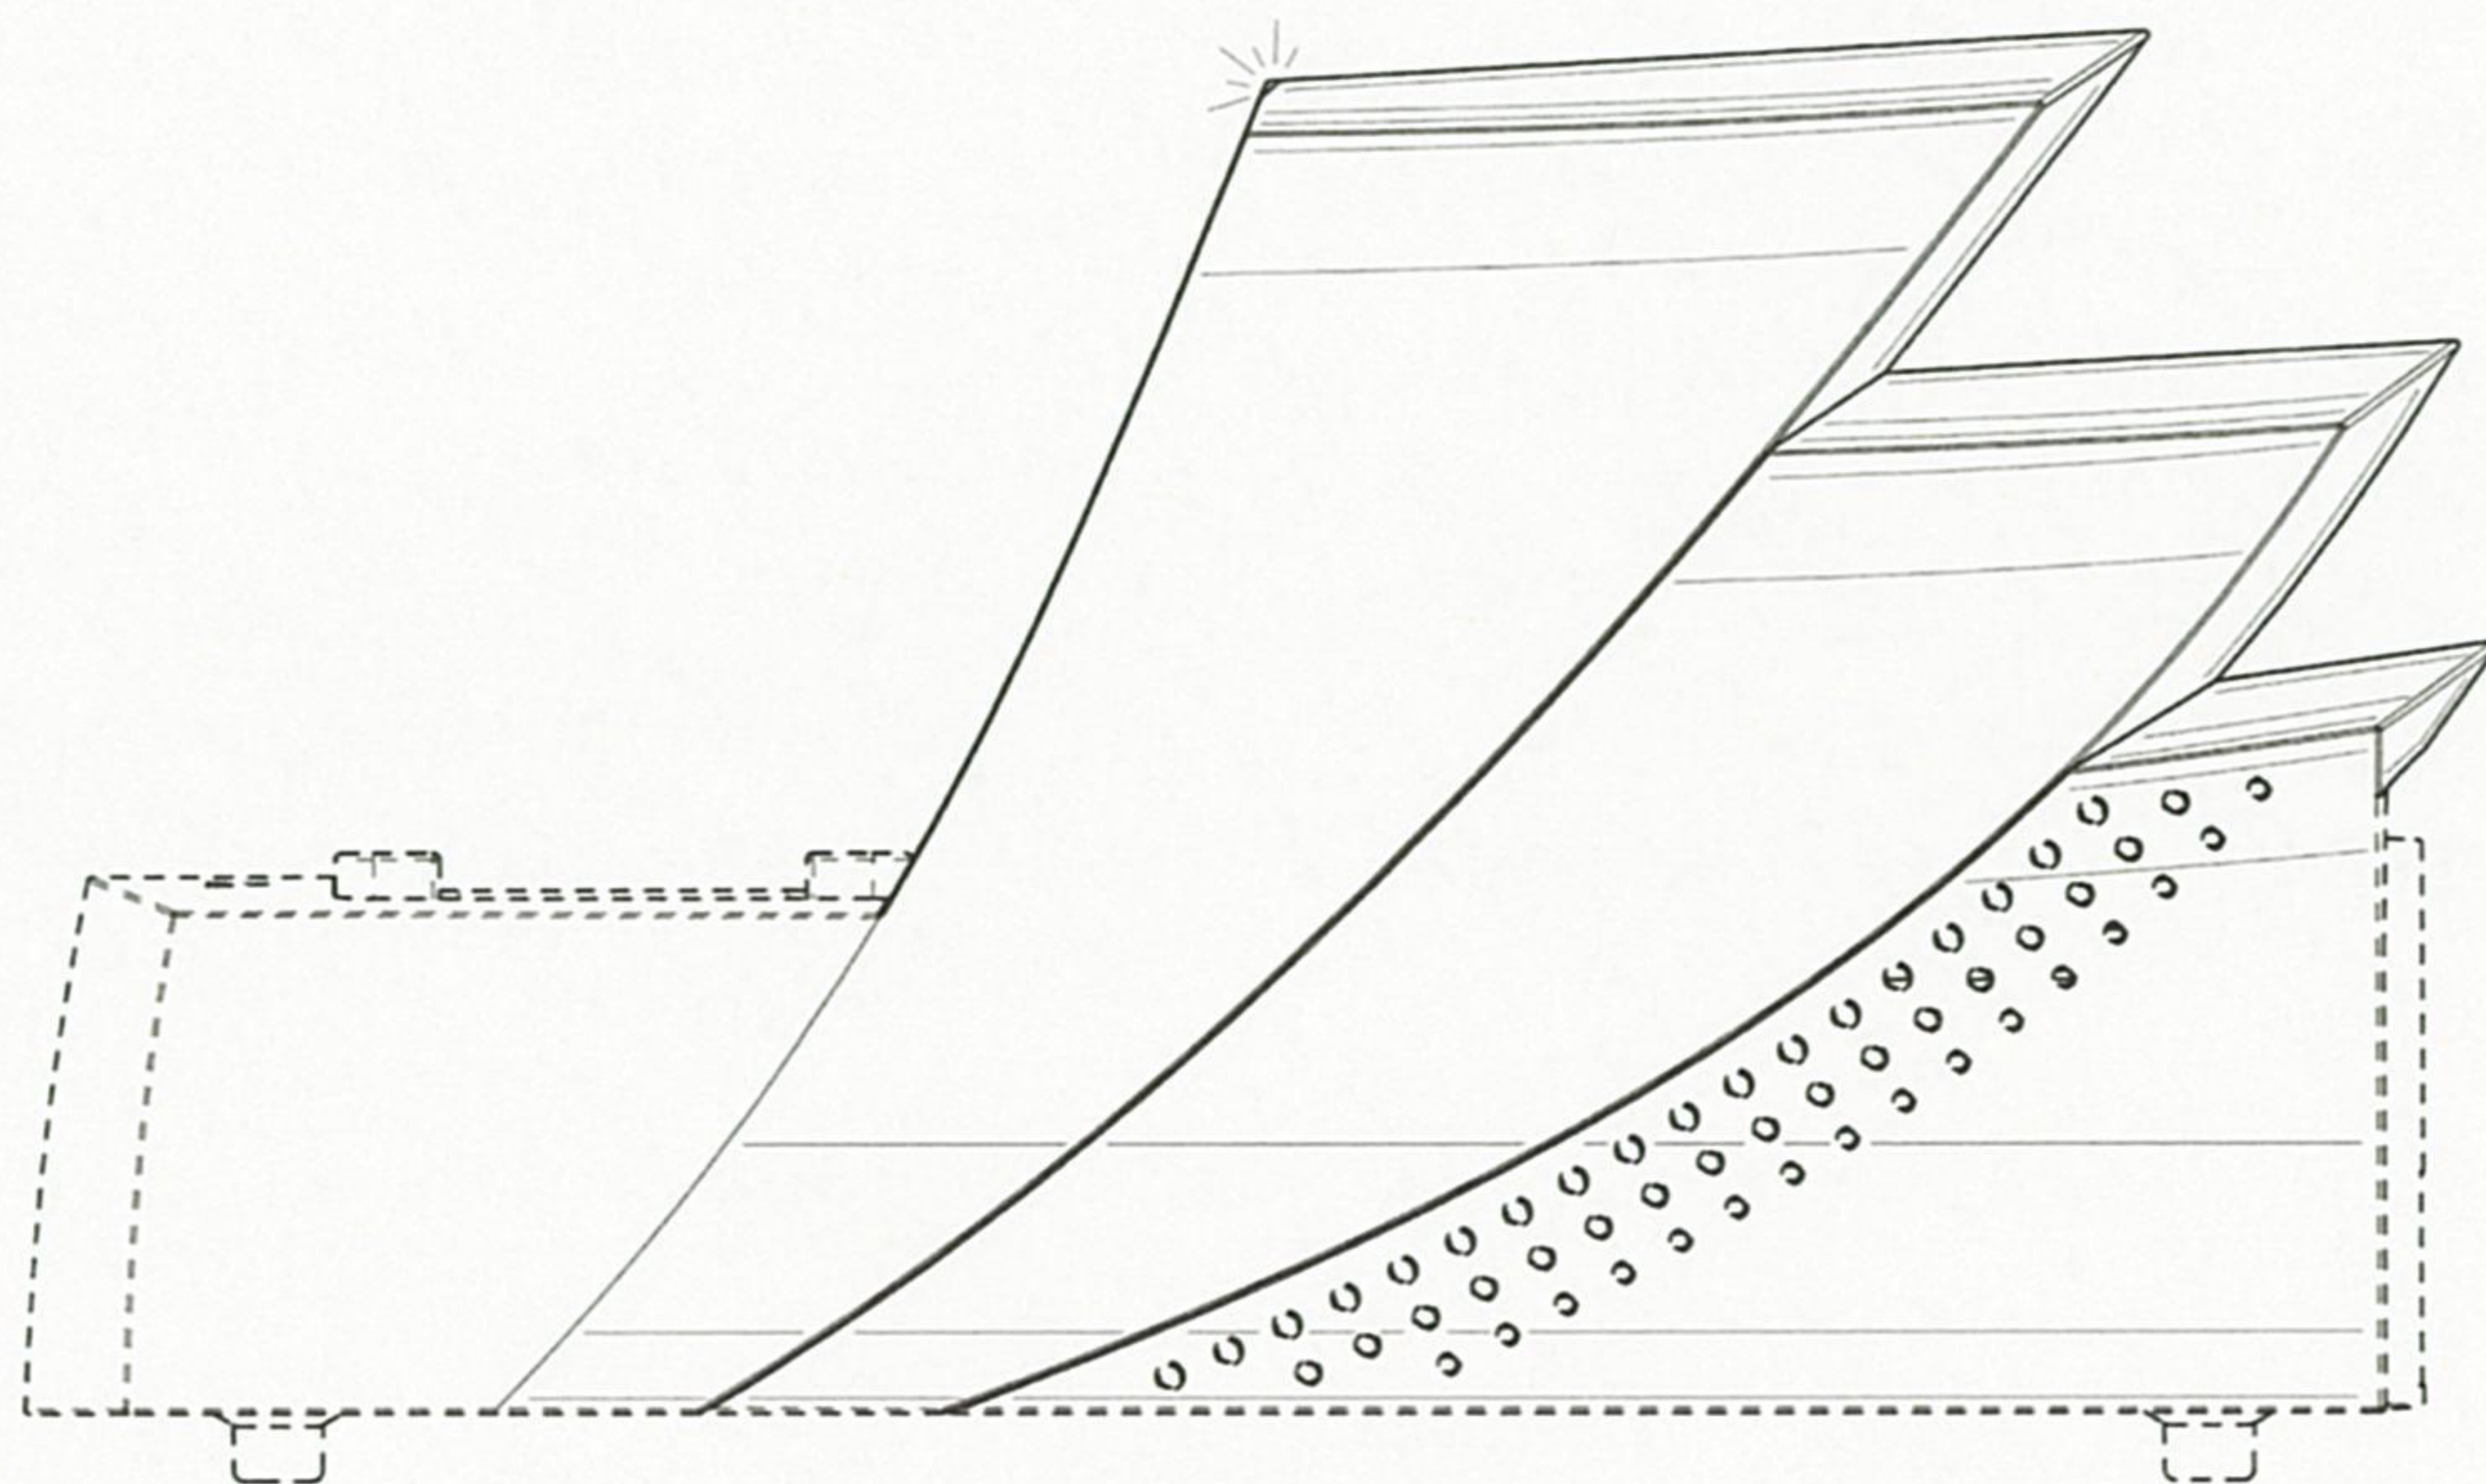


【表示發光狀態右側視參考圖】

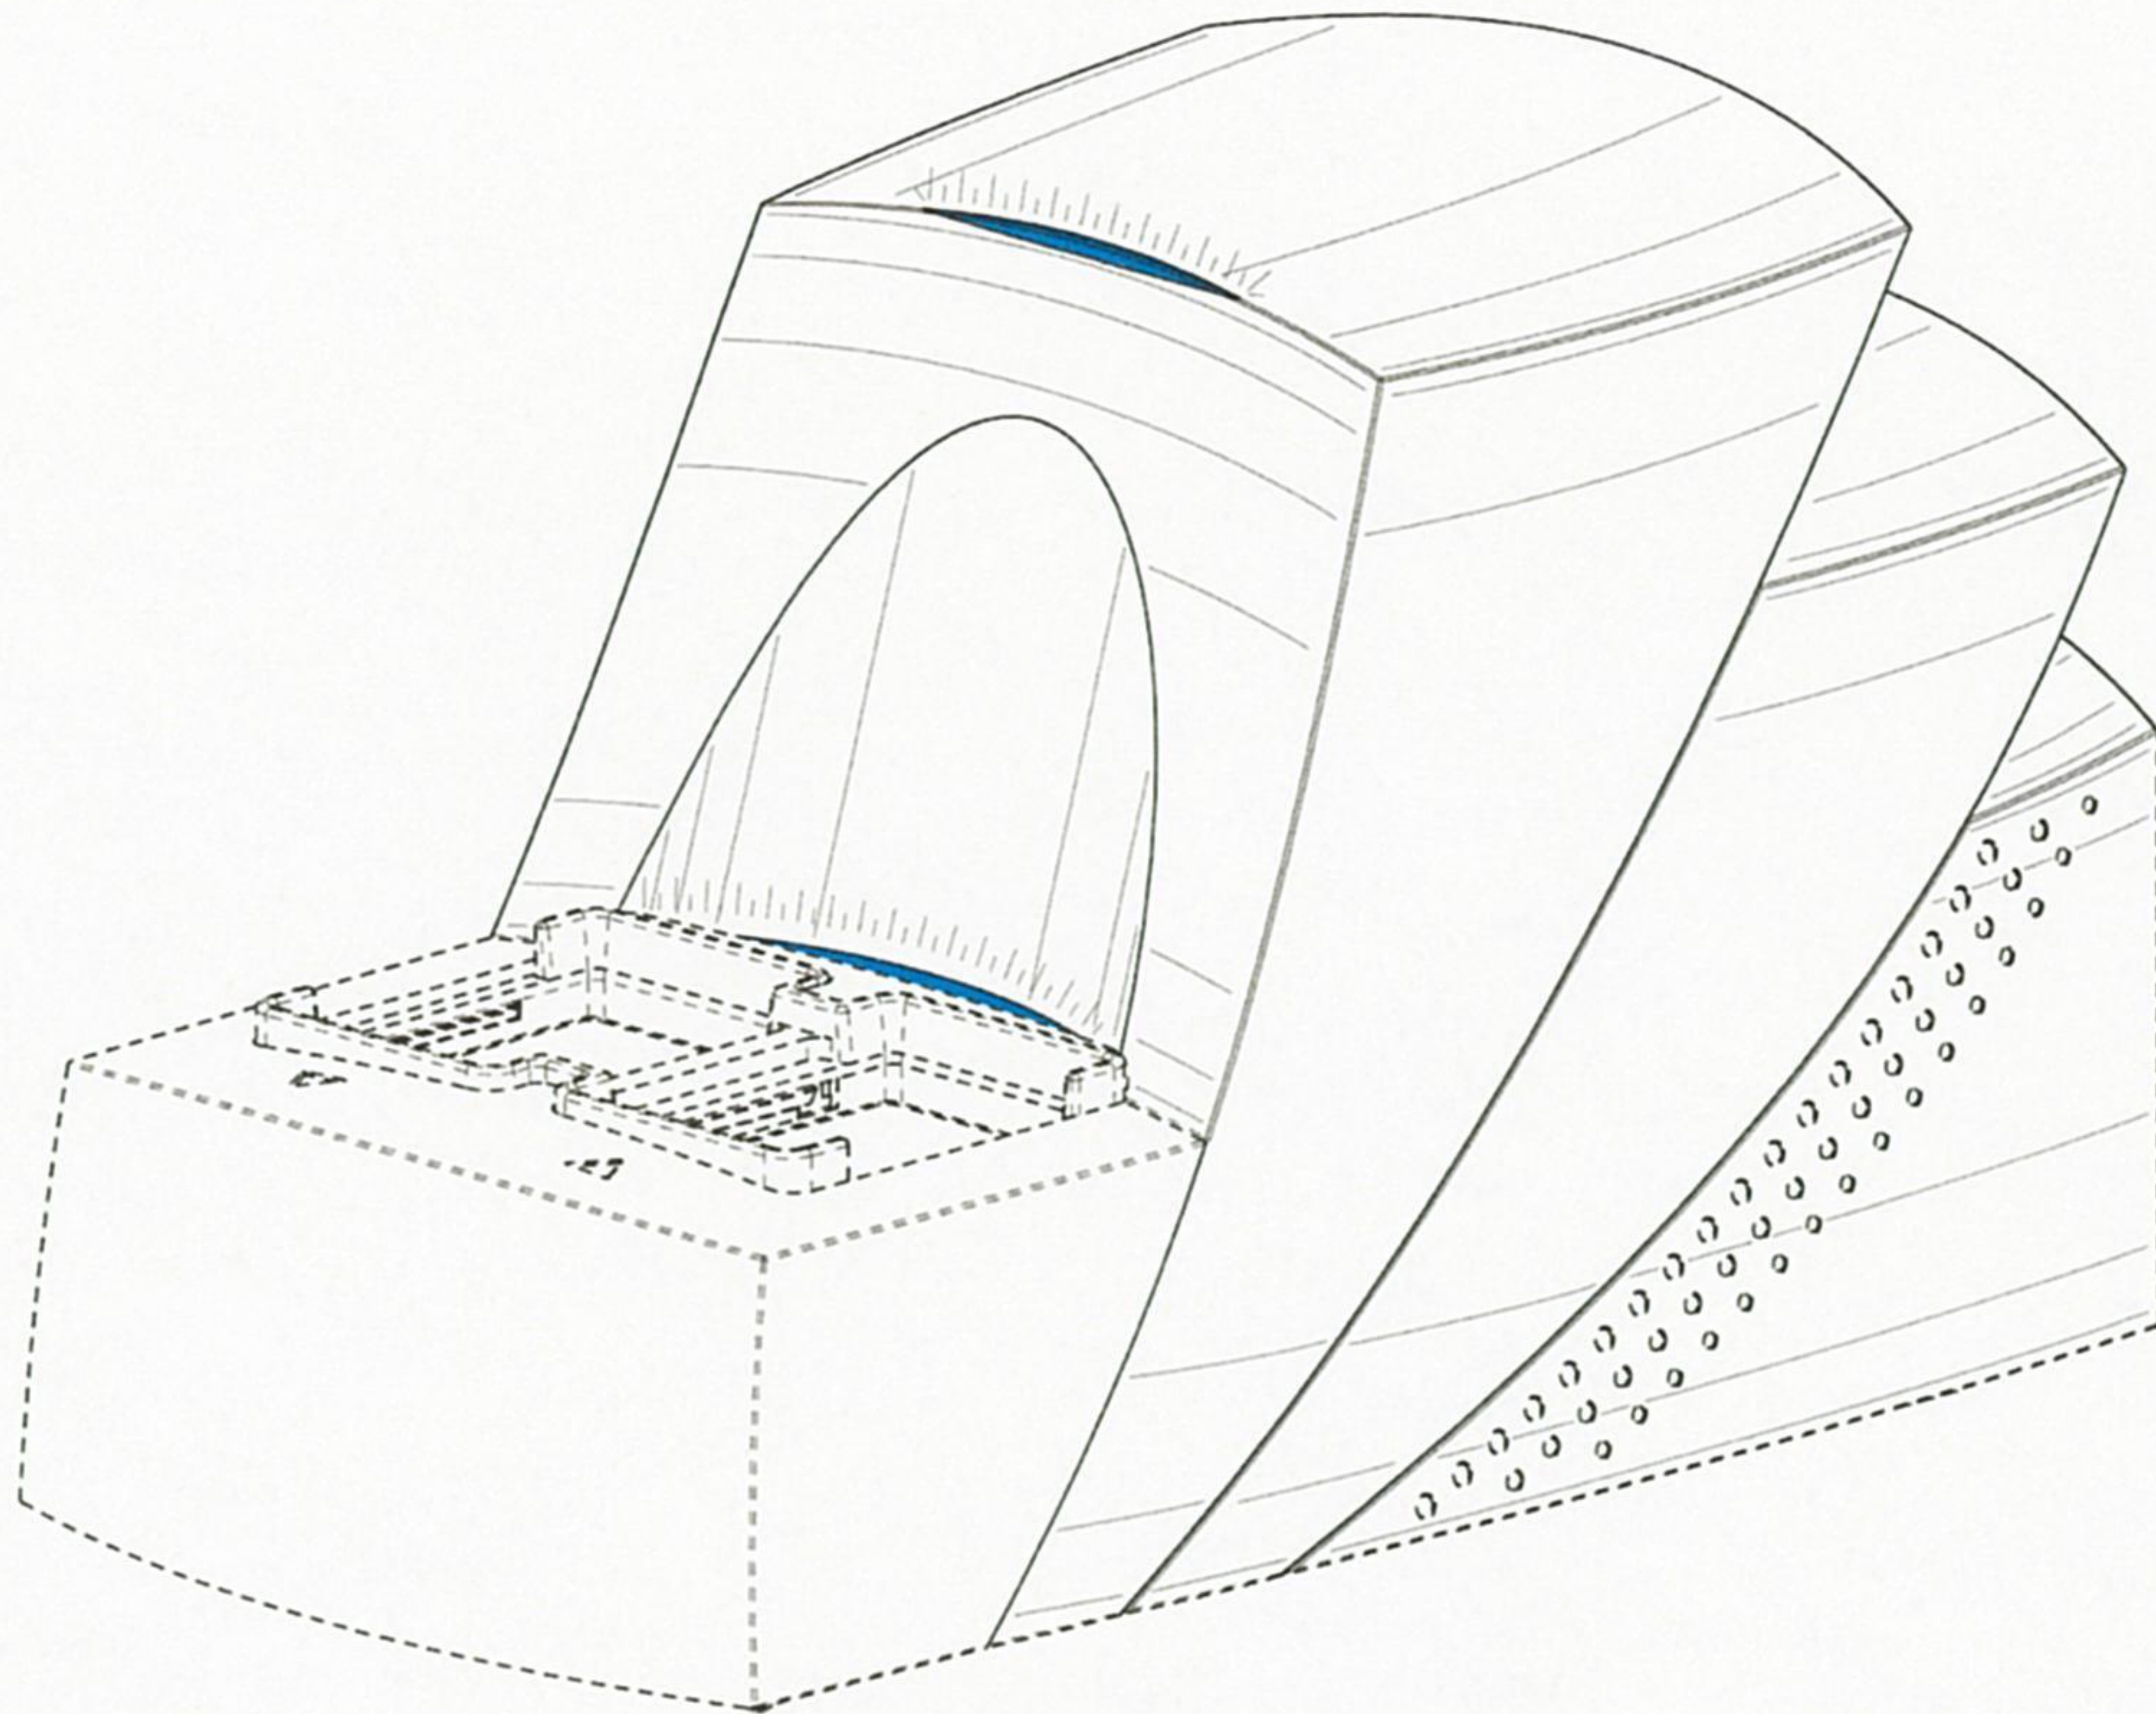


【表示發光部立體參考圖1】

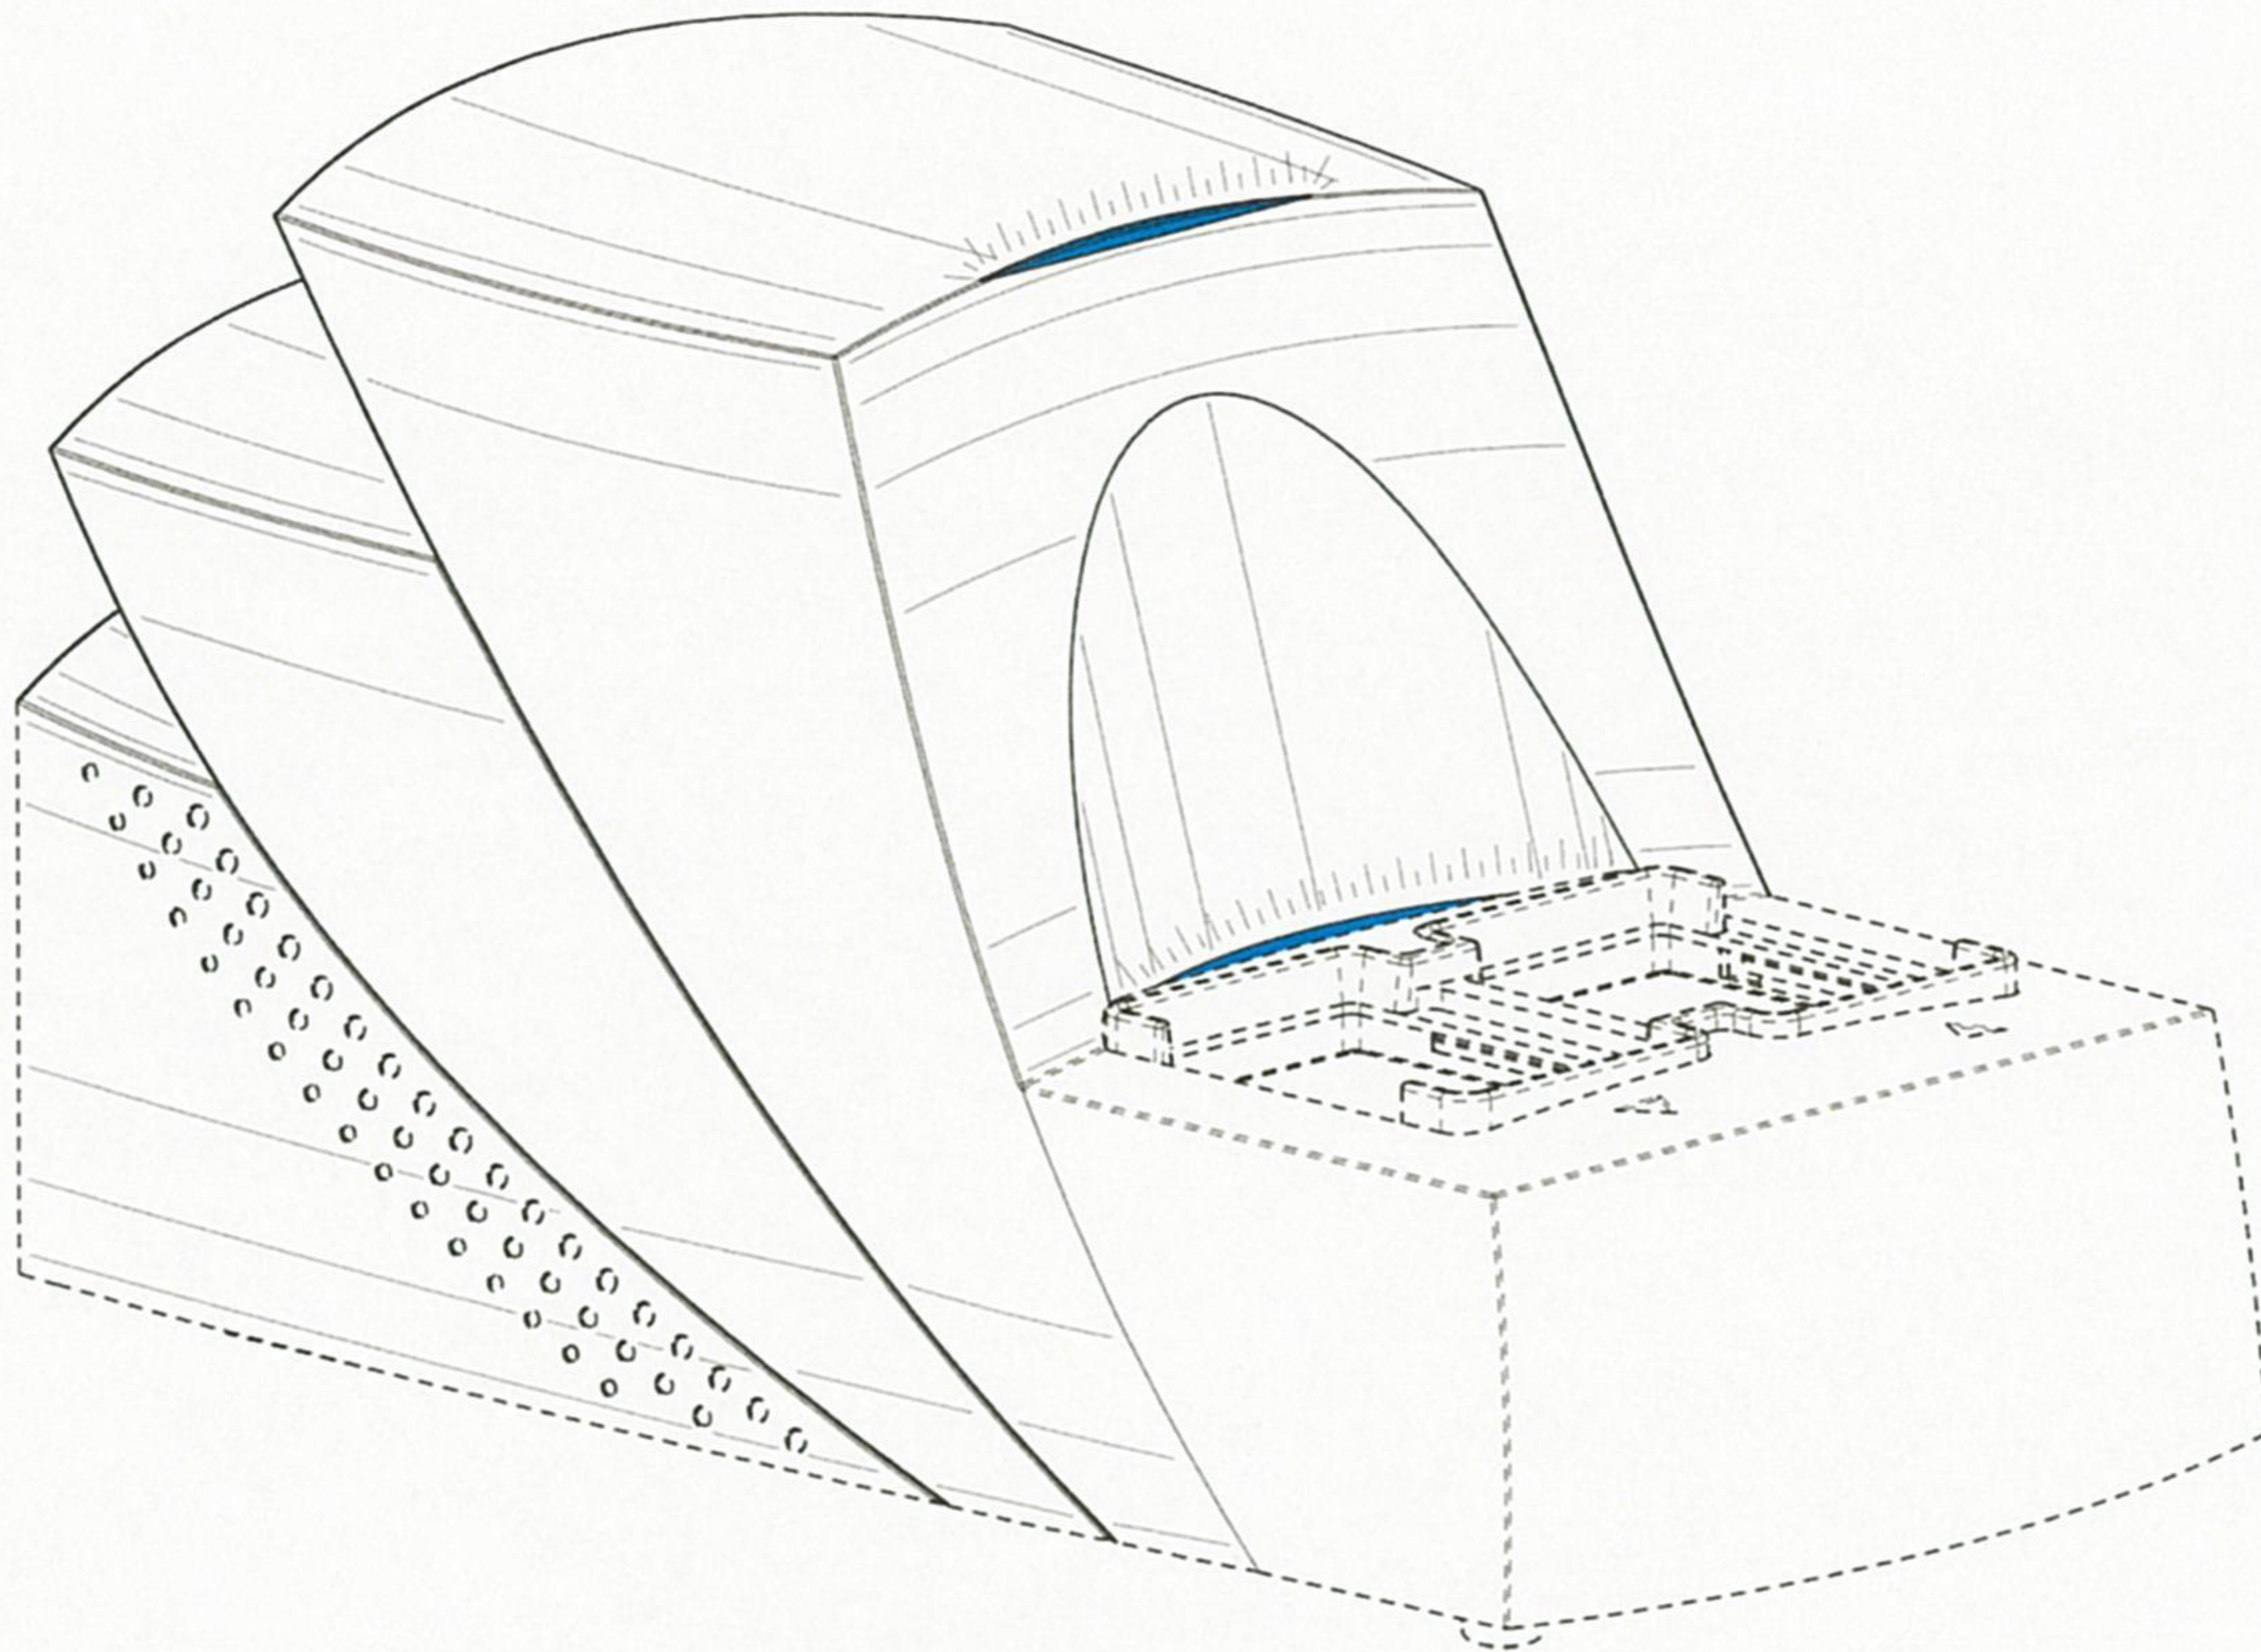


【表示發光部立體參考圖2】

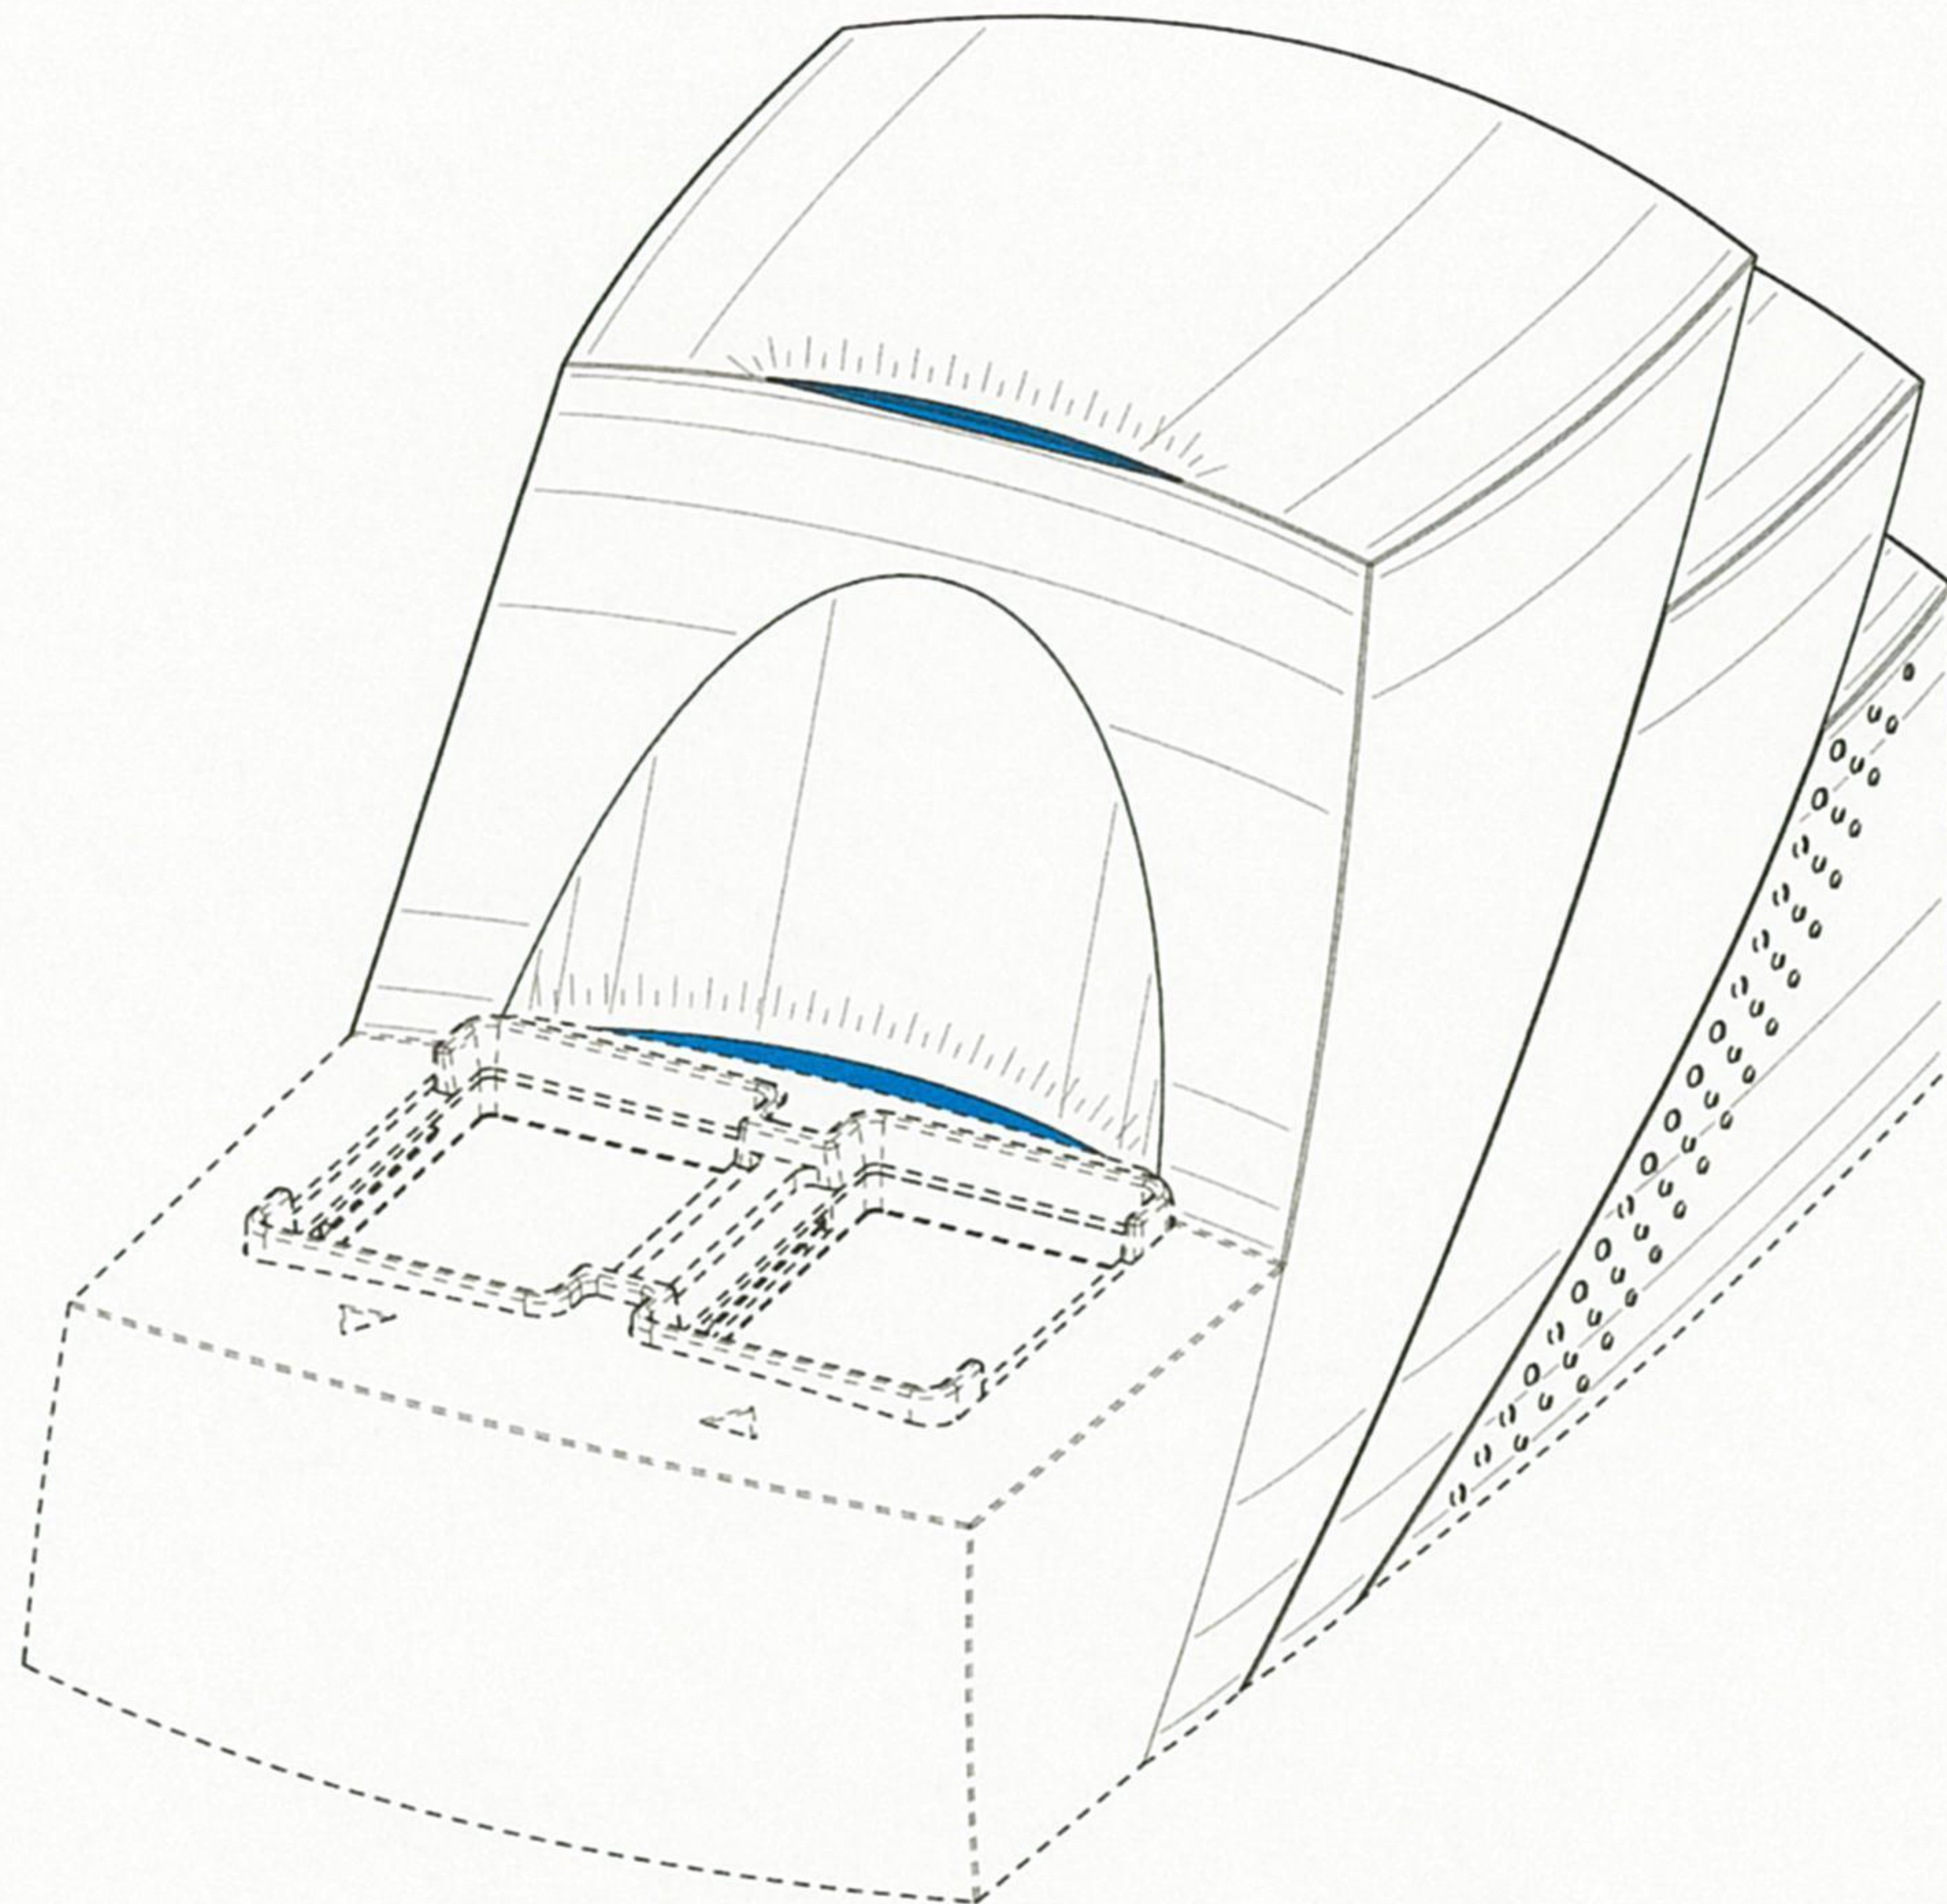


【表示發光部立體參考圖3】

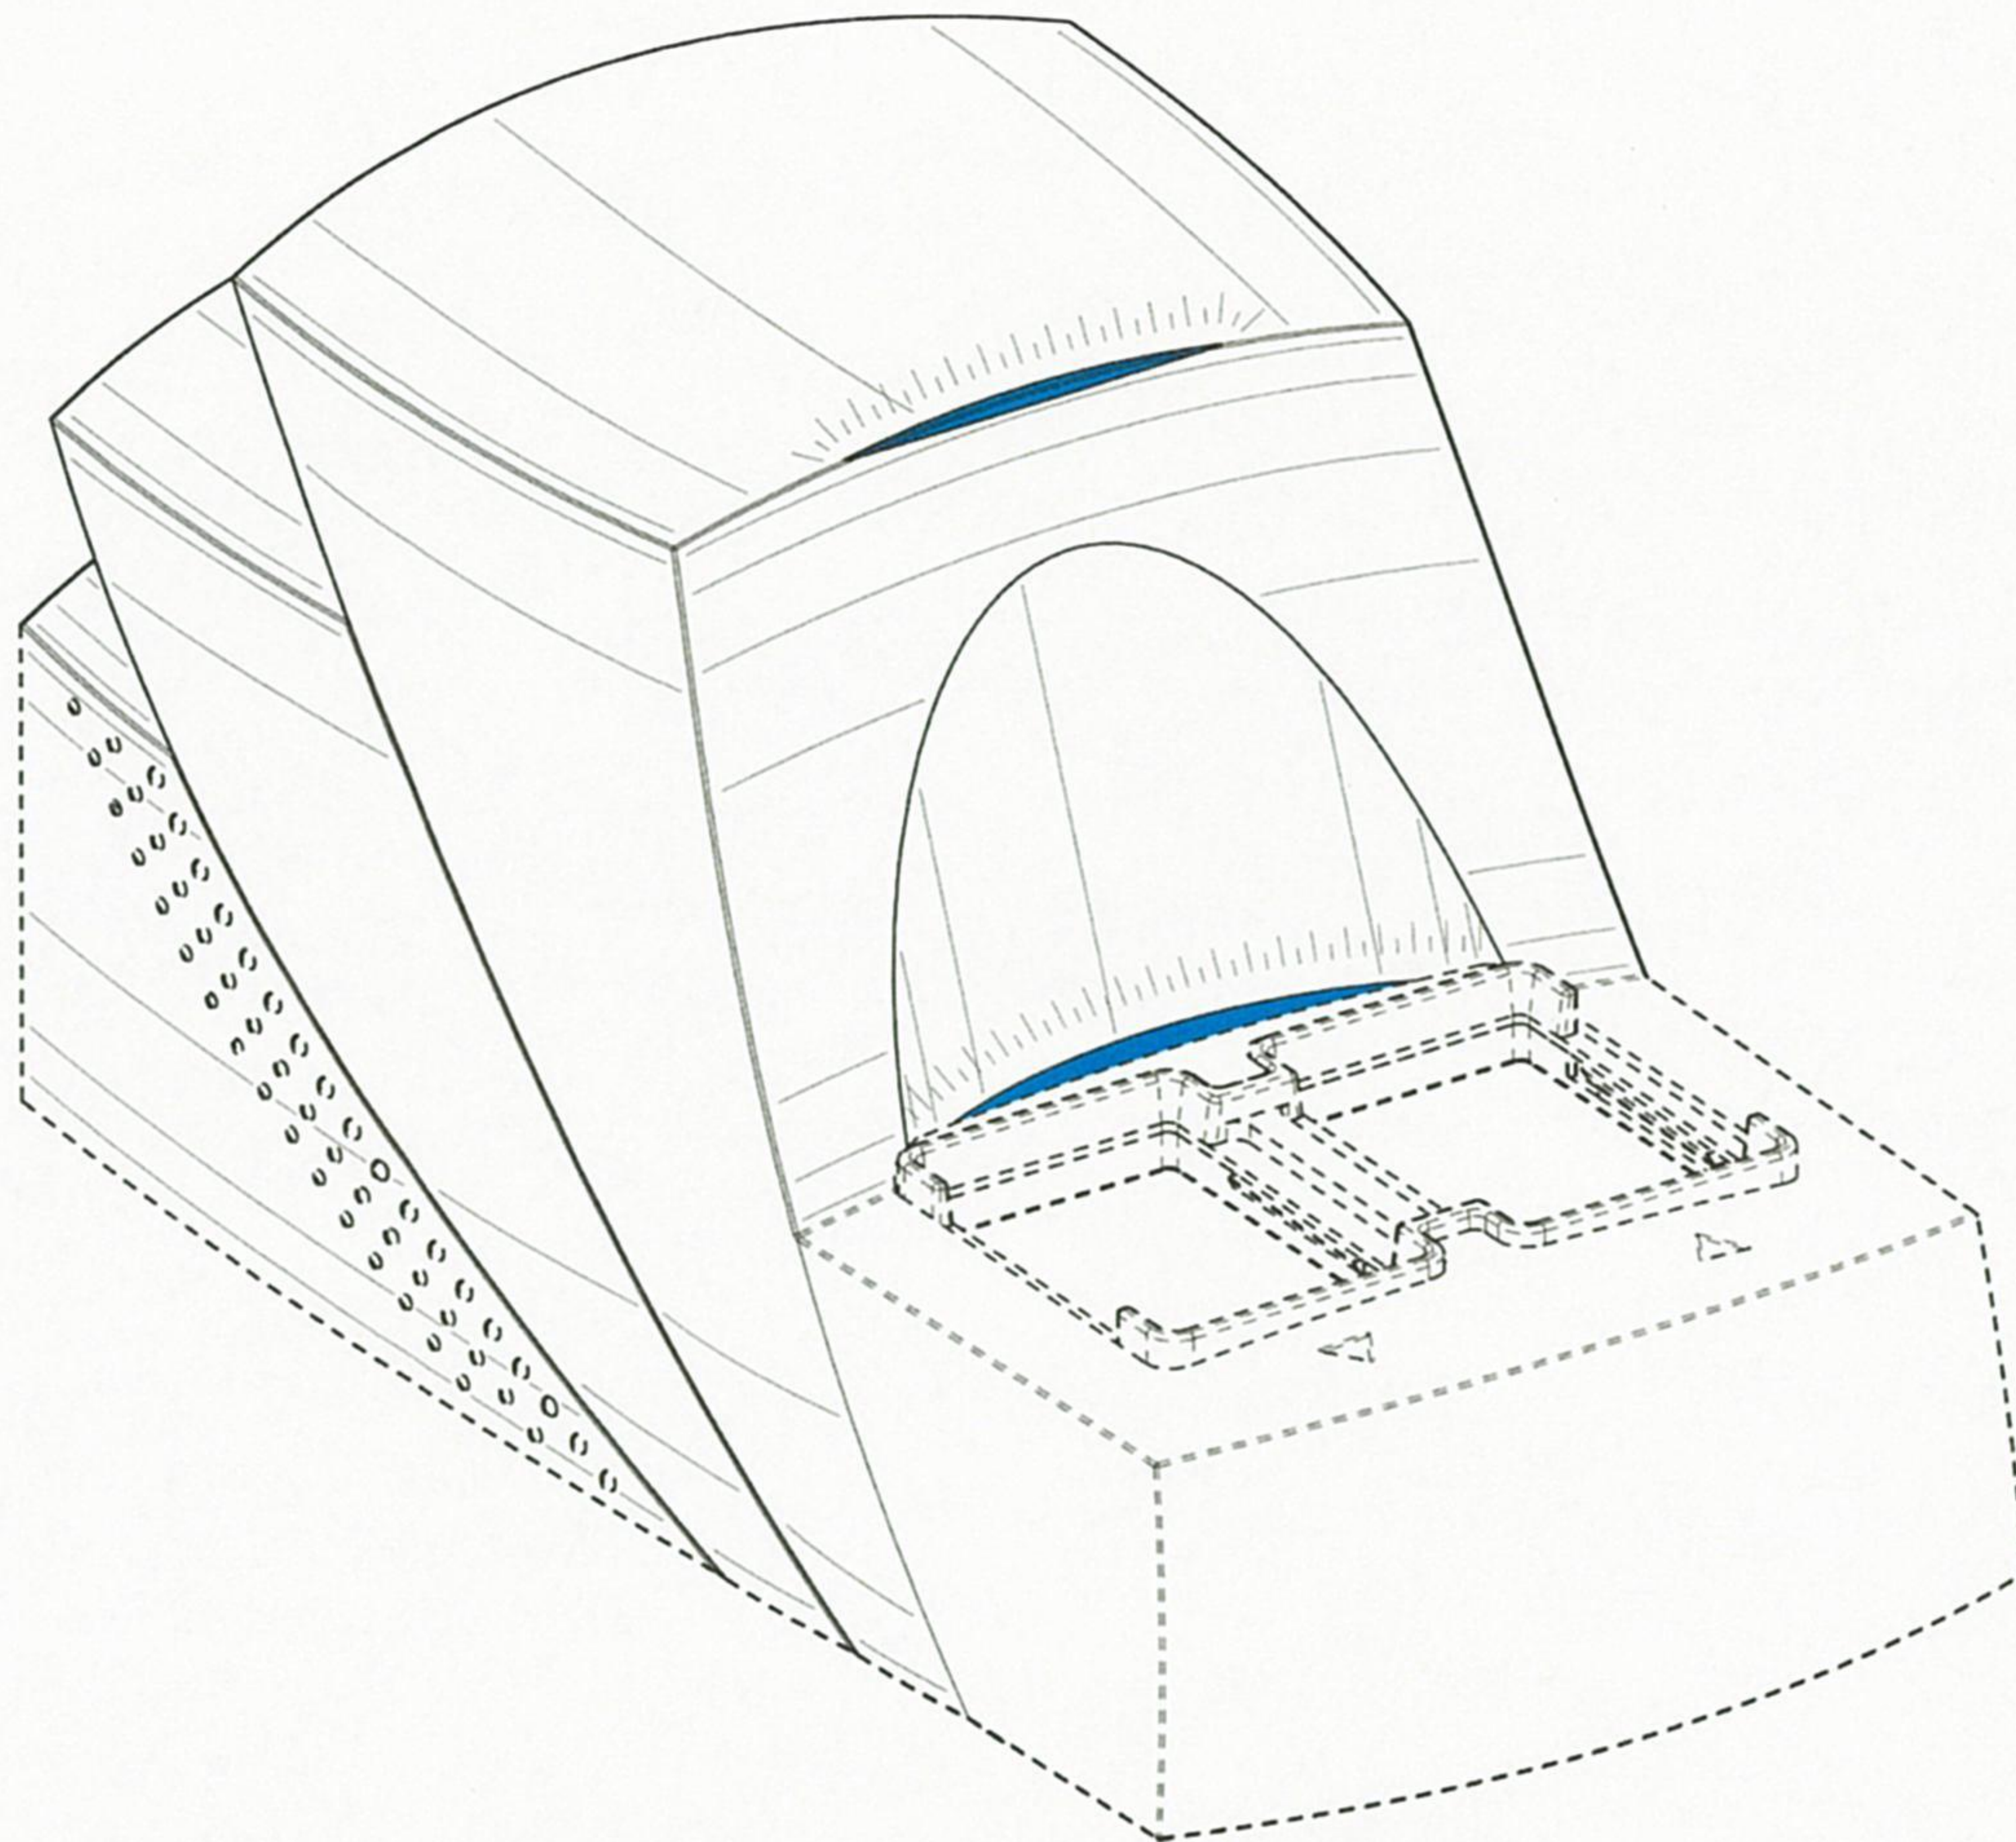


【表示發光部立體參考圖4】

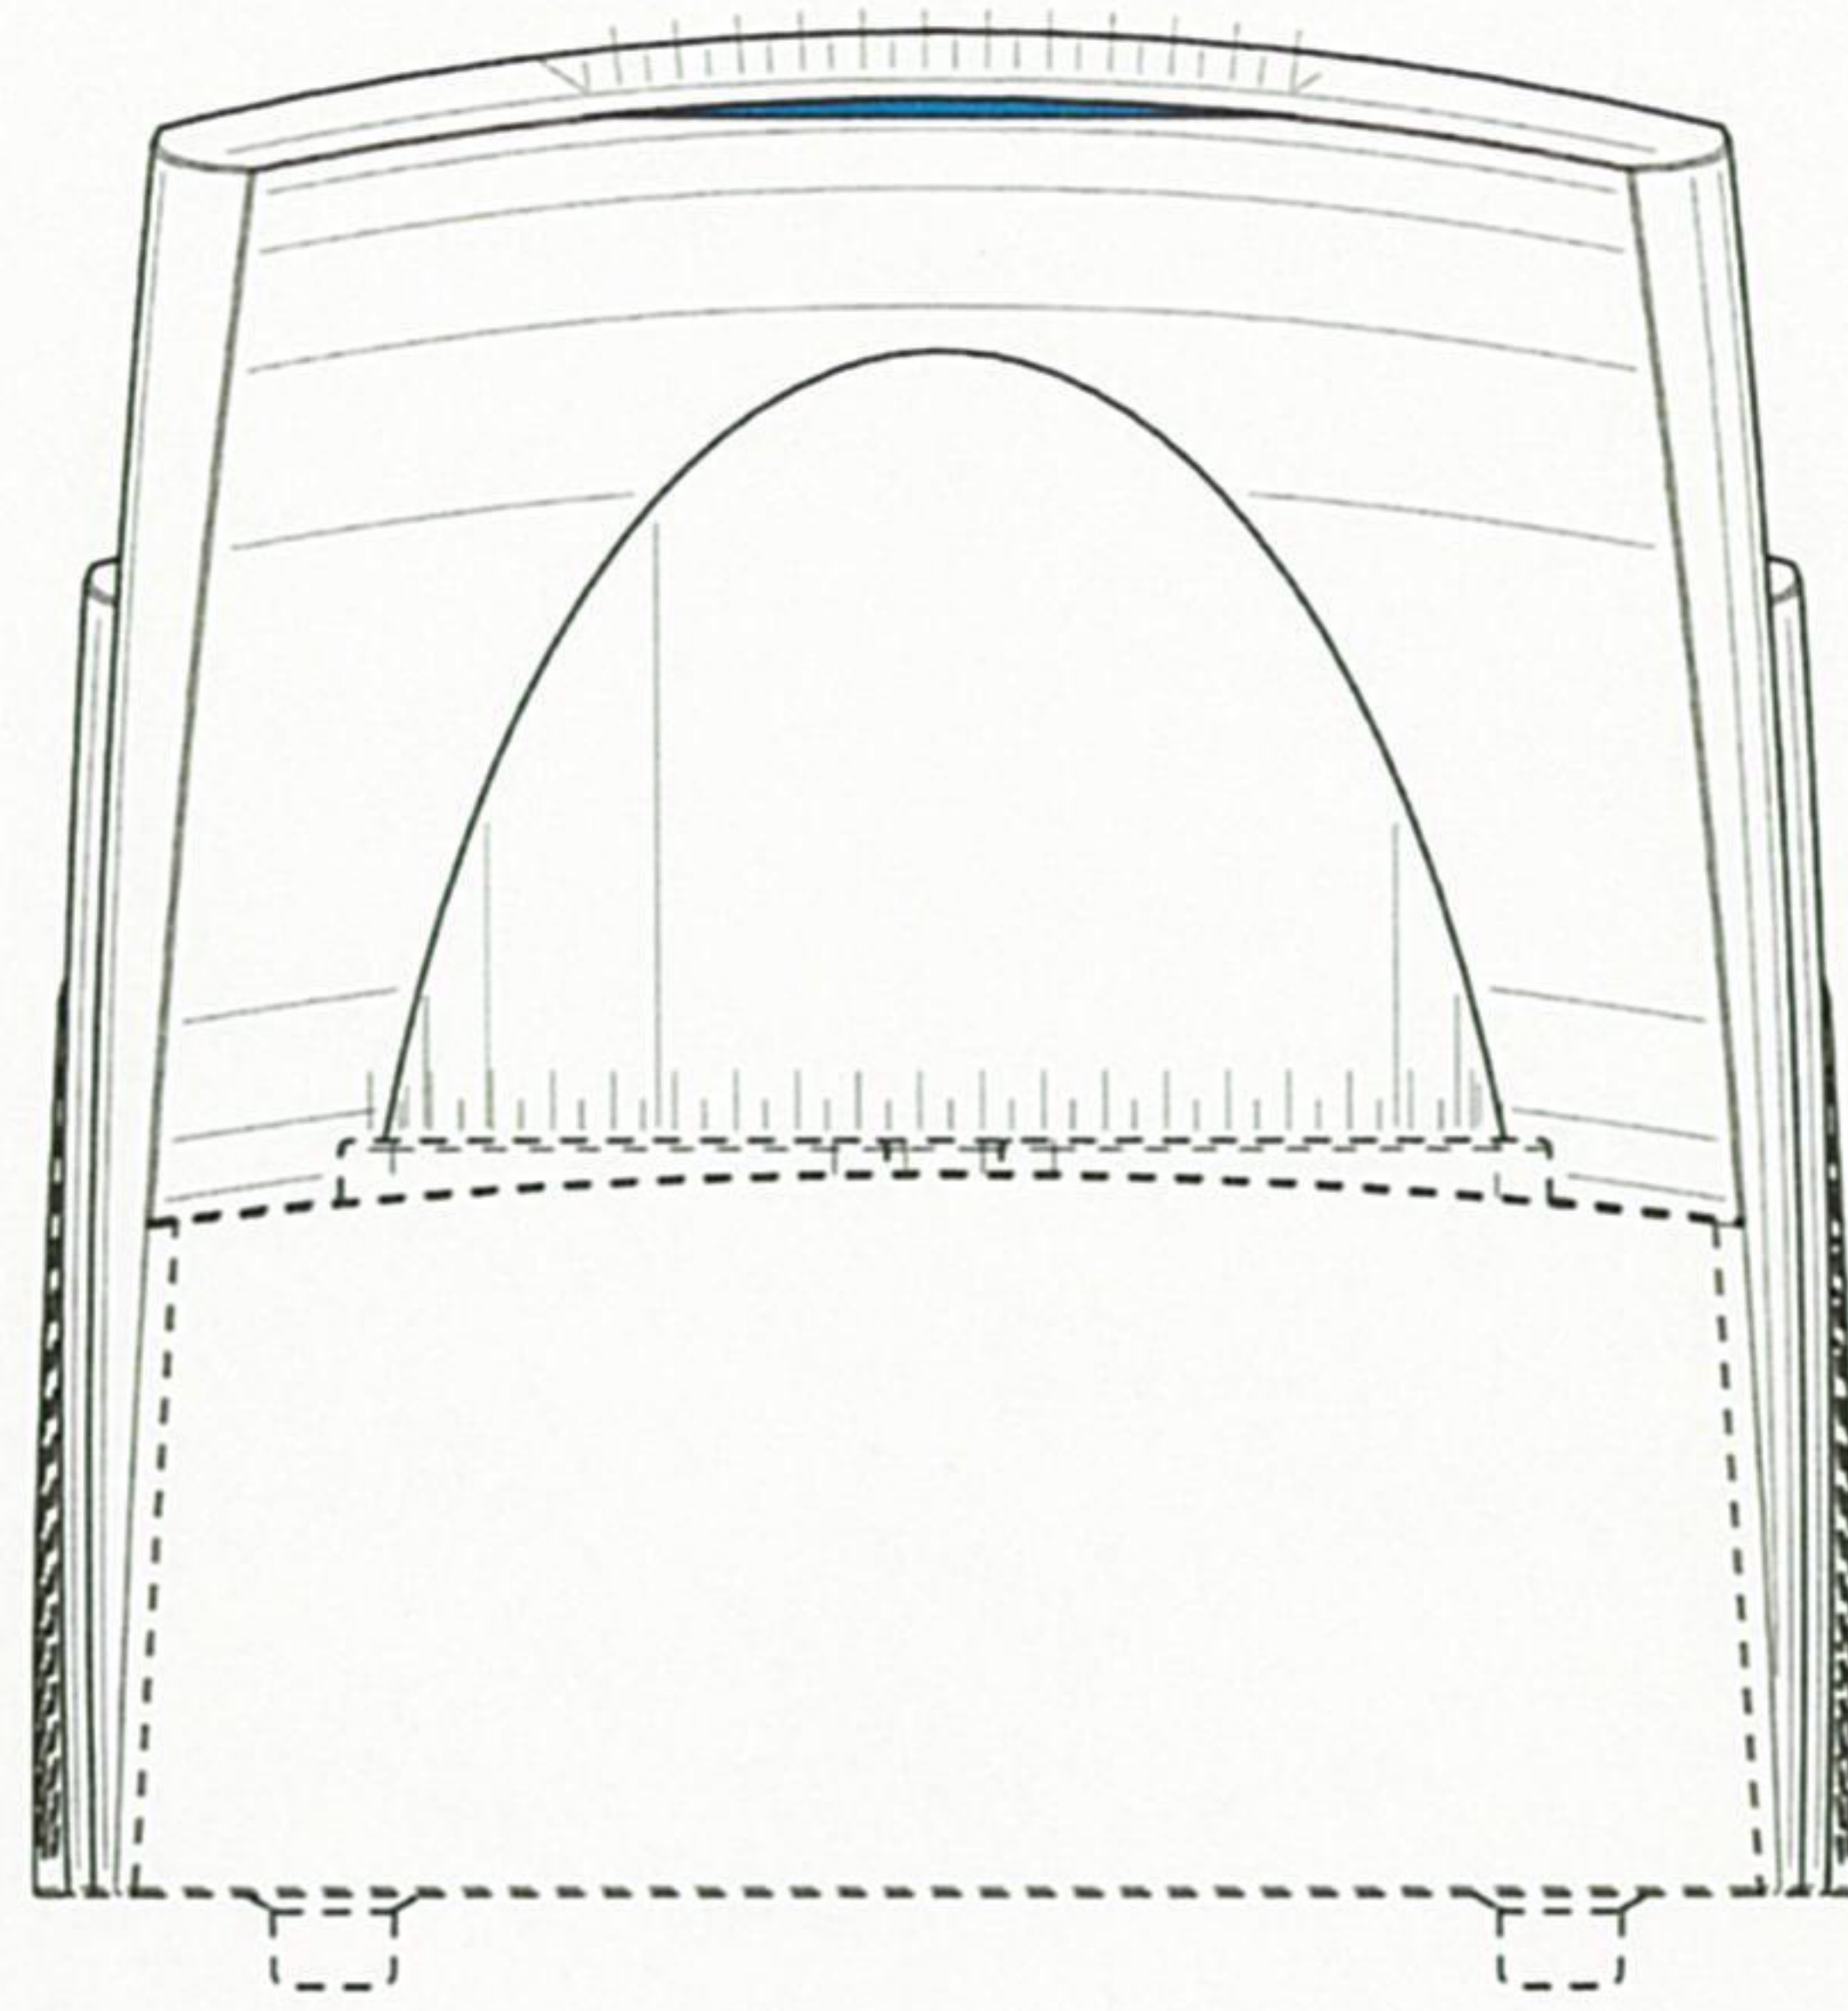


【表示發光部前視參考圖】

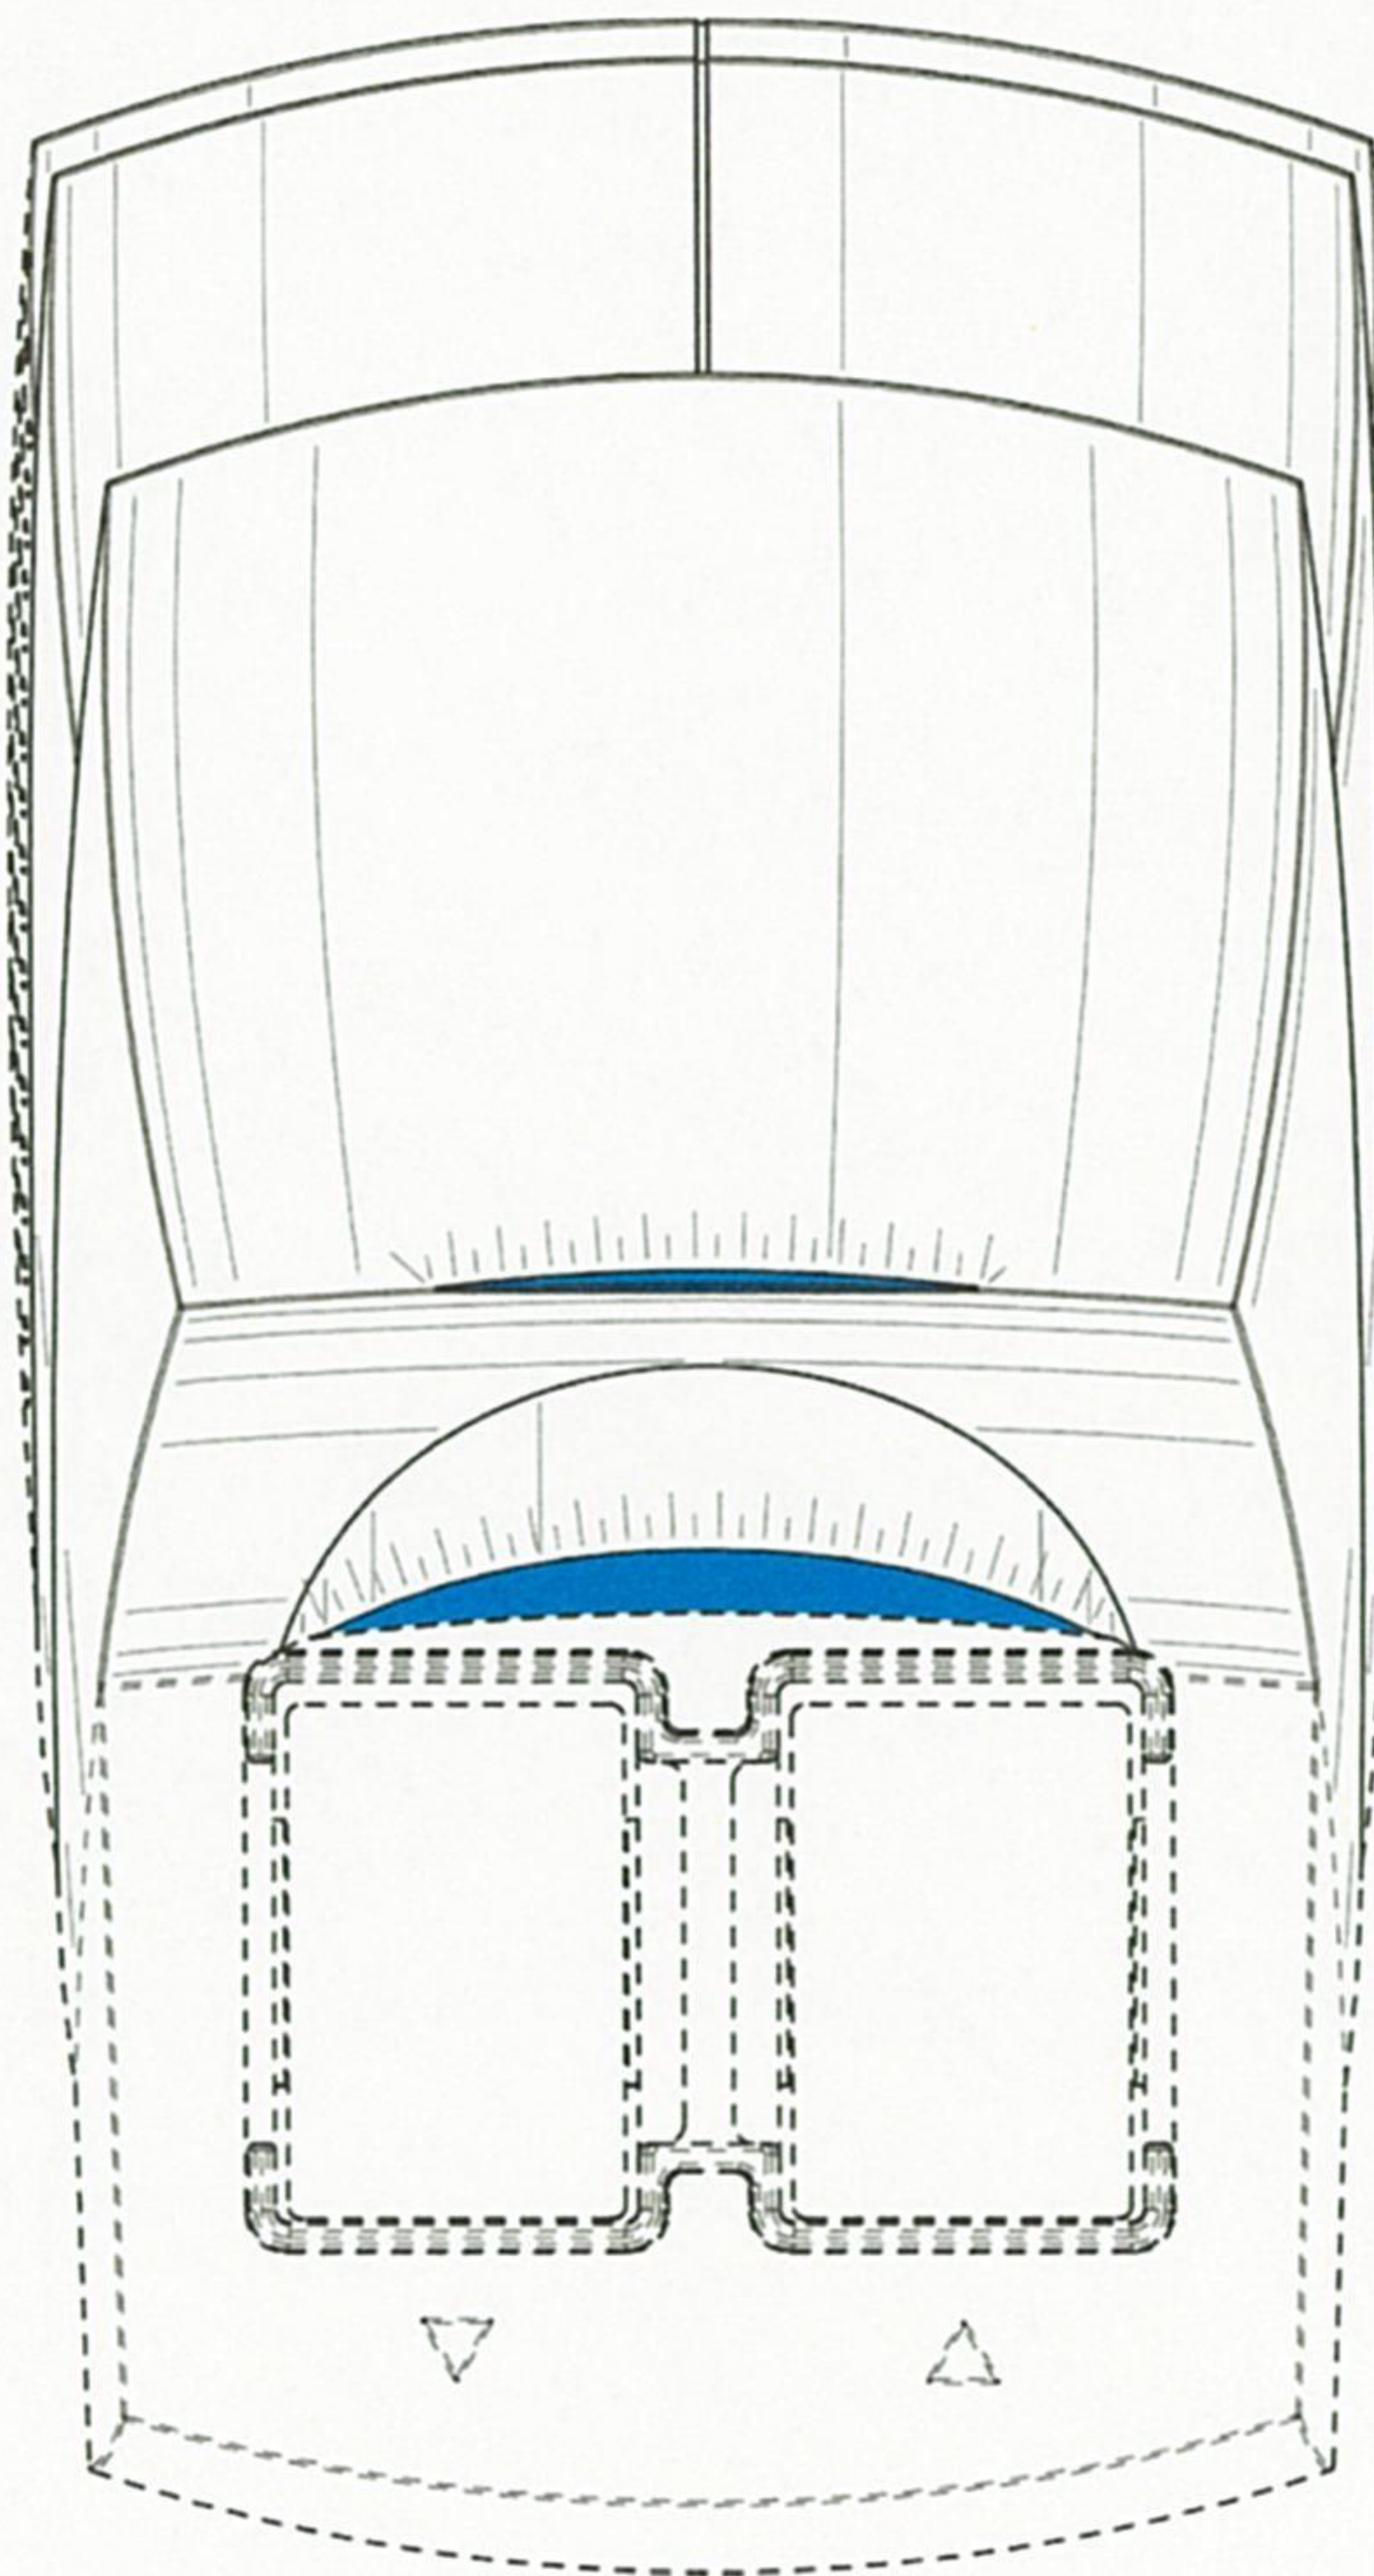

【表示發光部俯視參考圖】

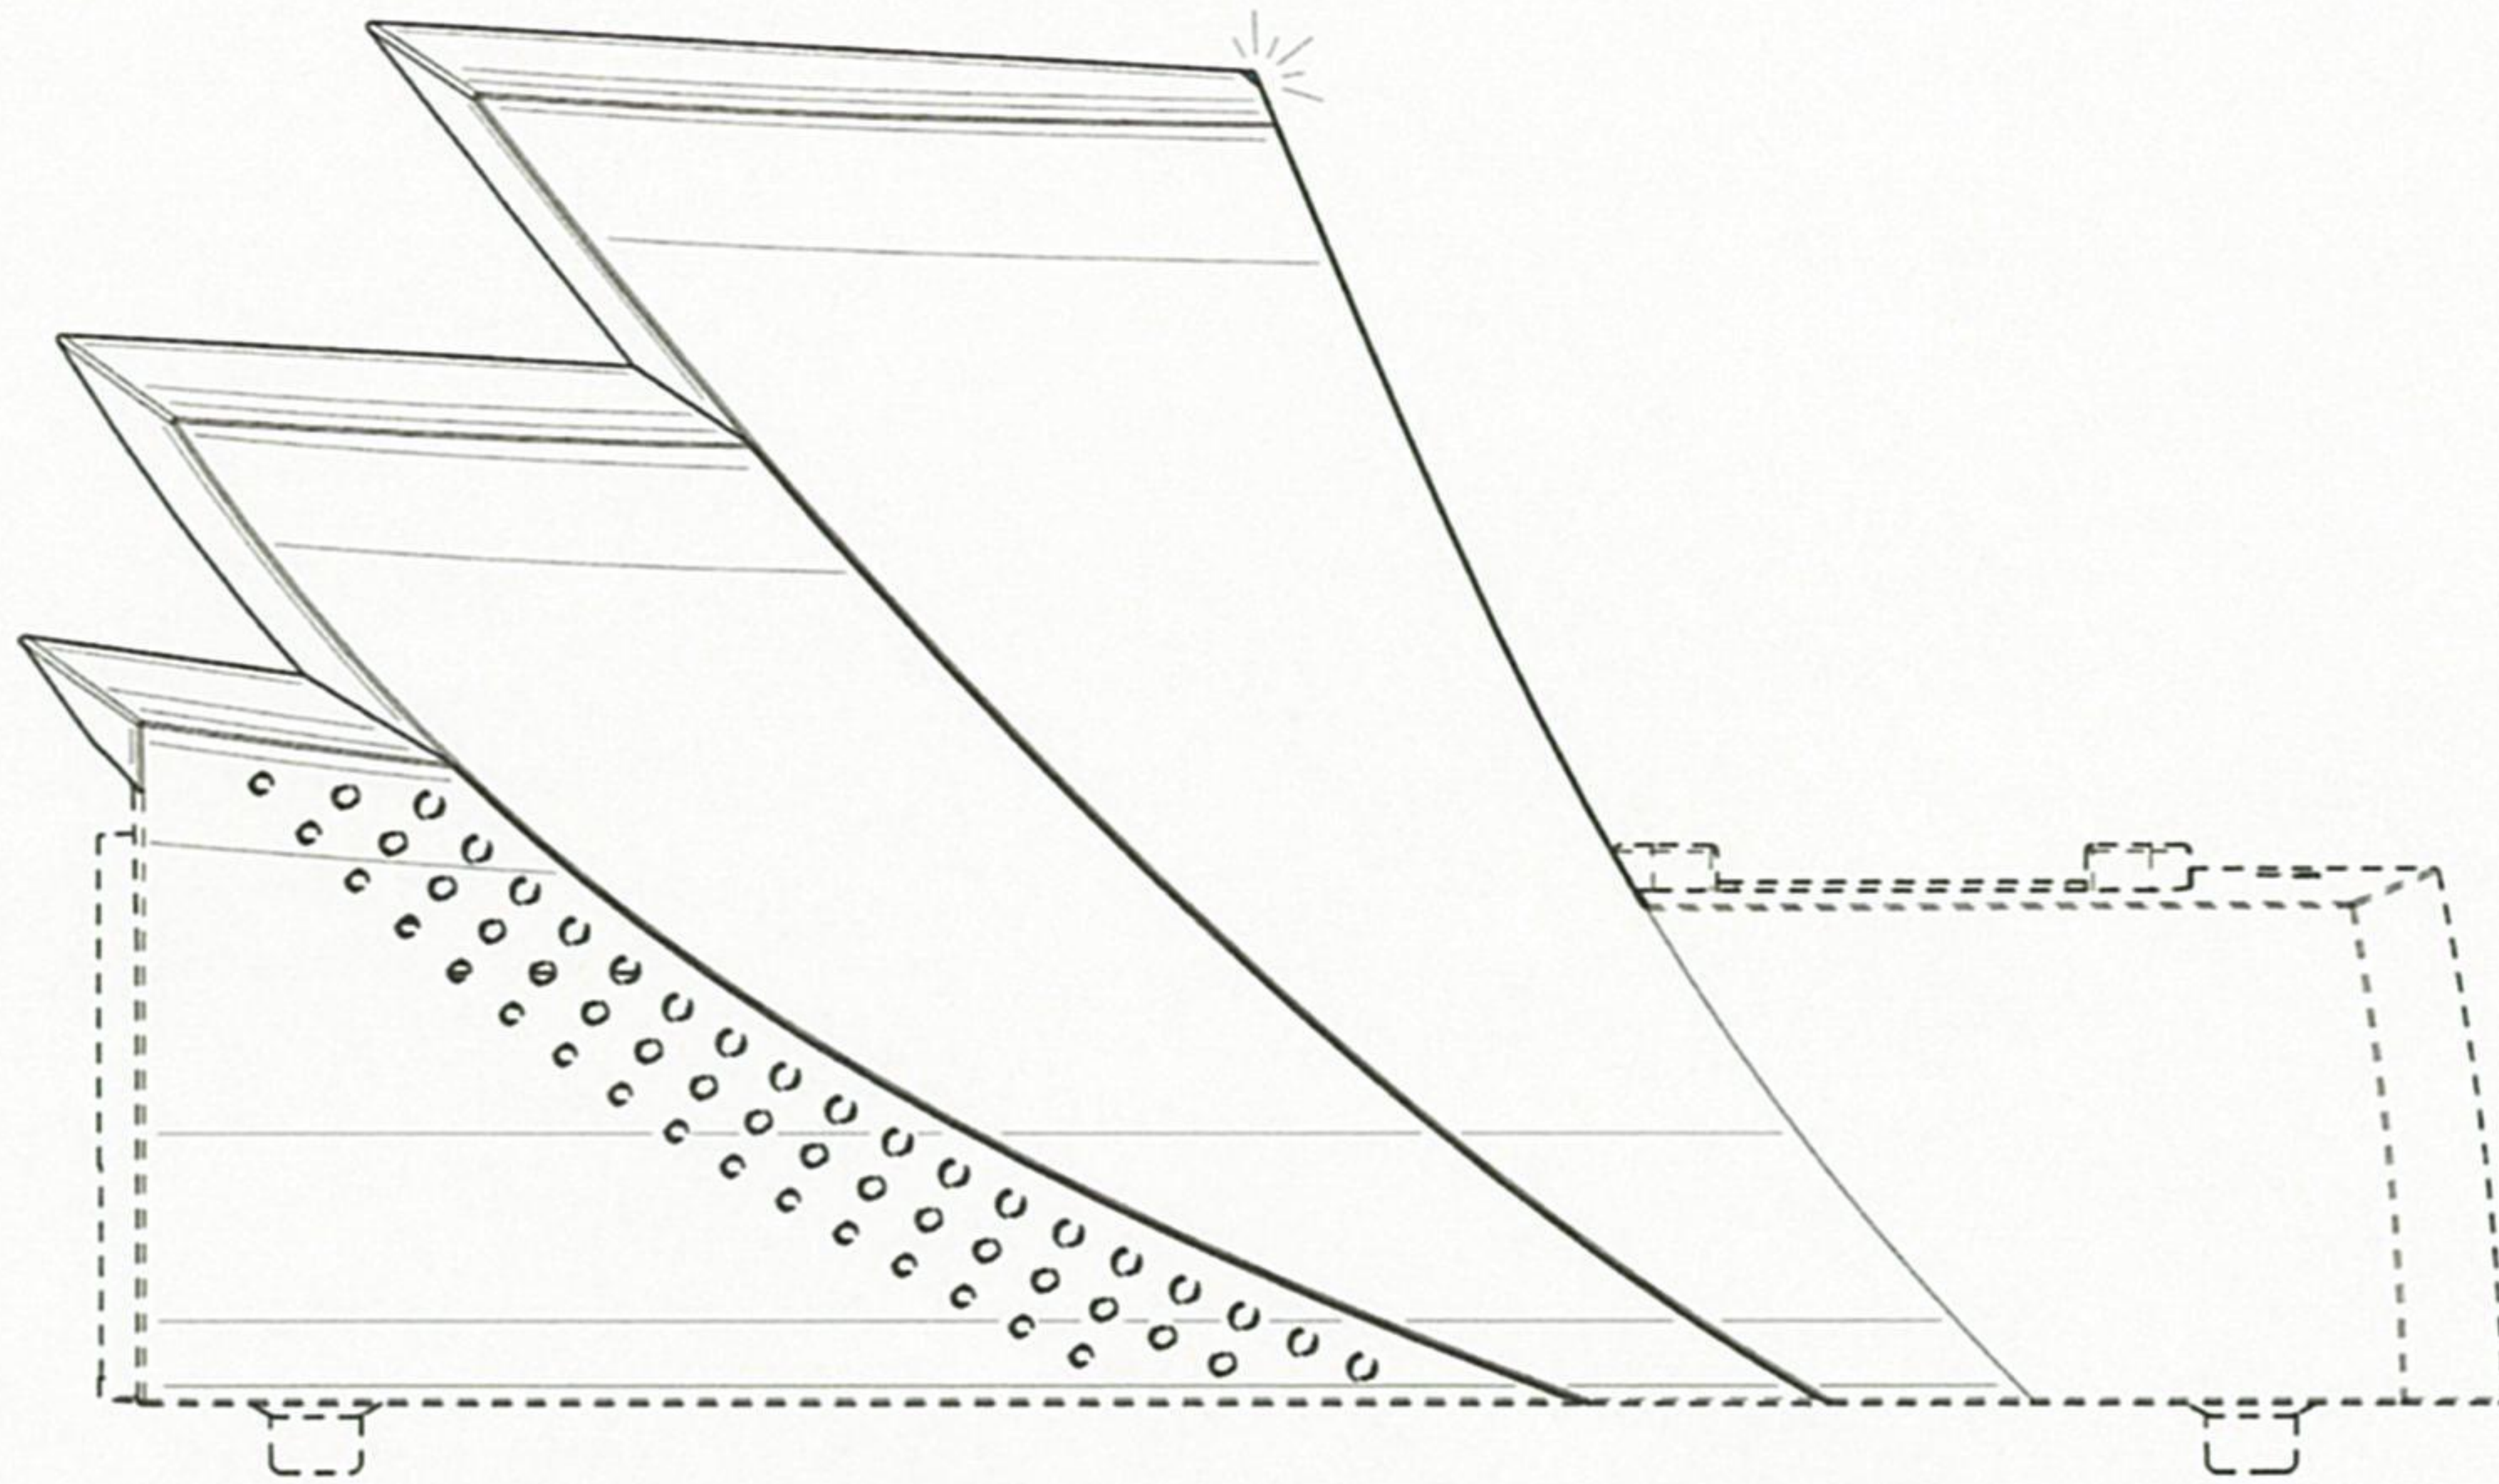

【表示發光部左側視參考圖】

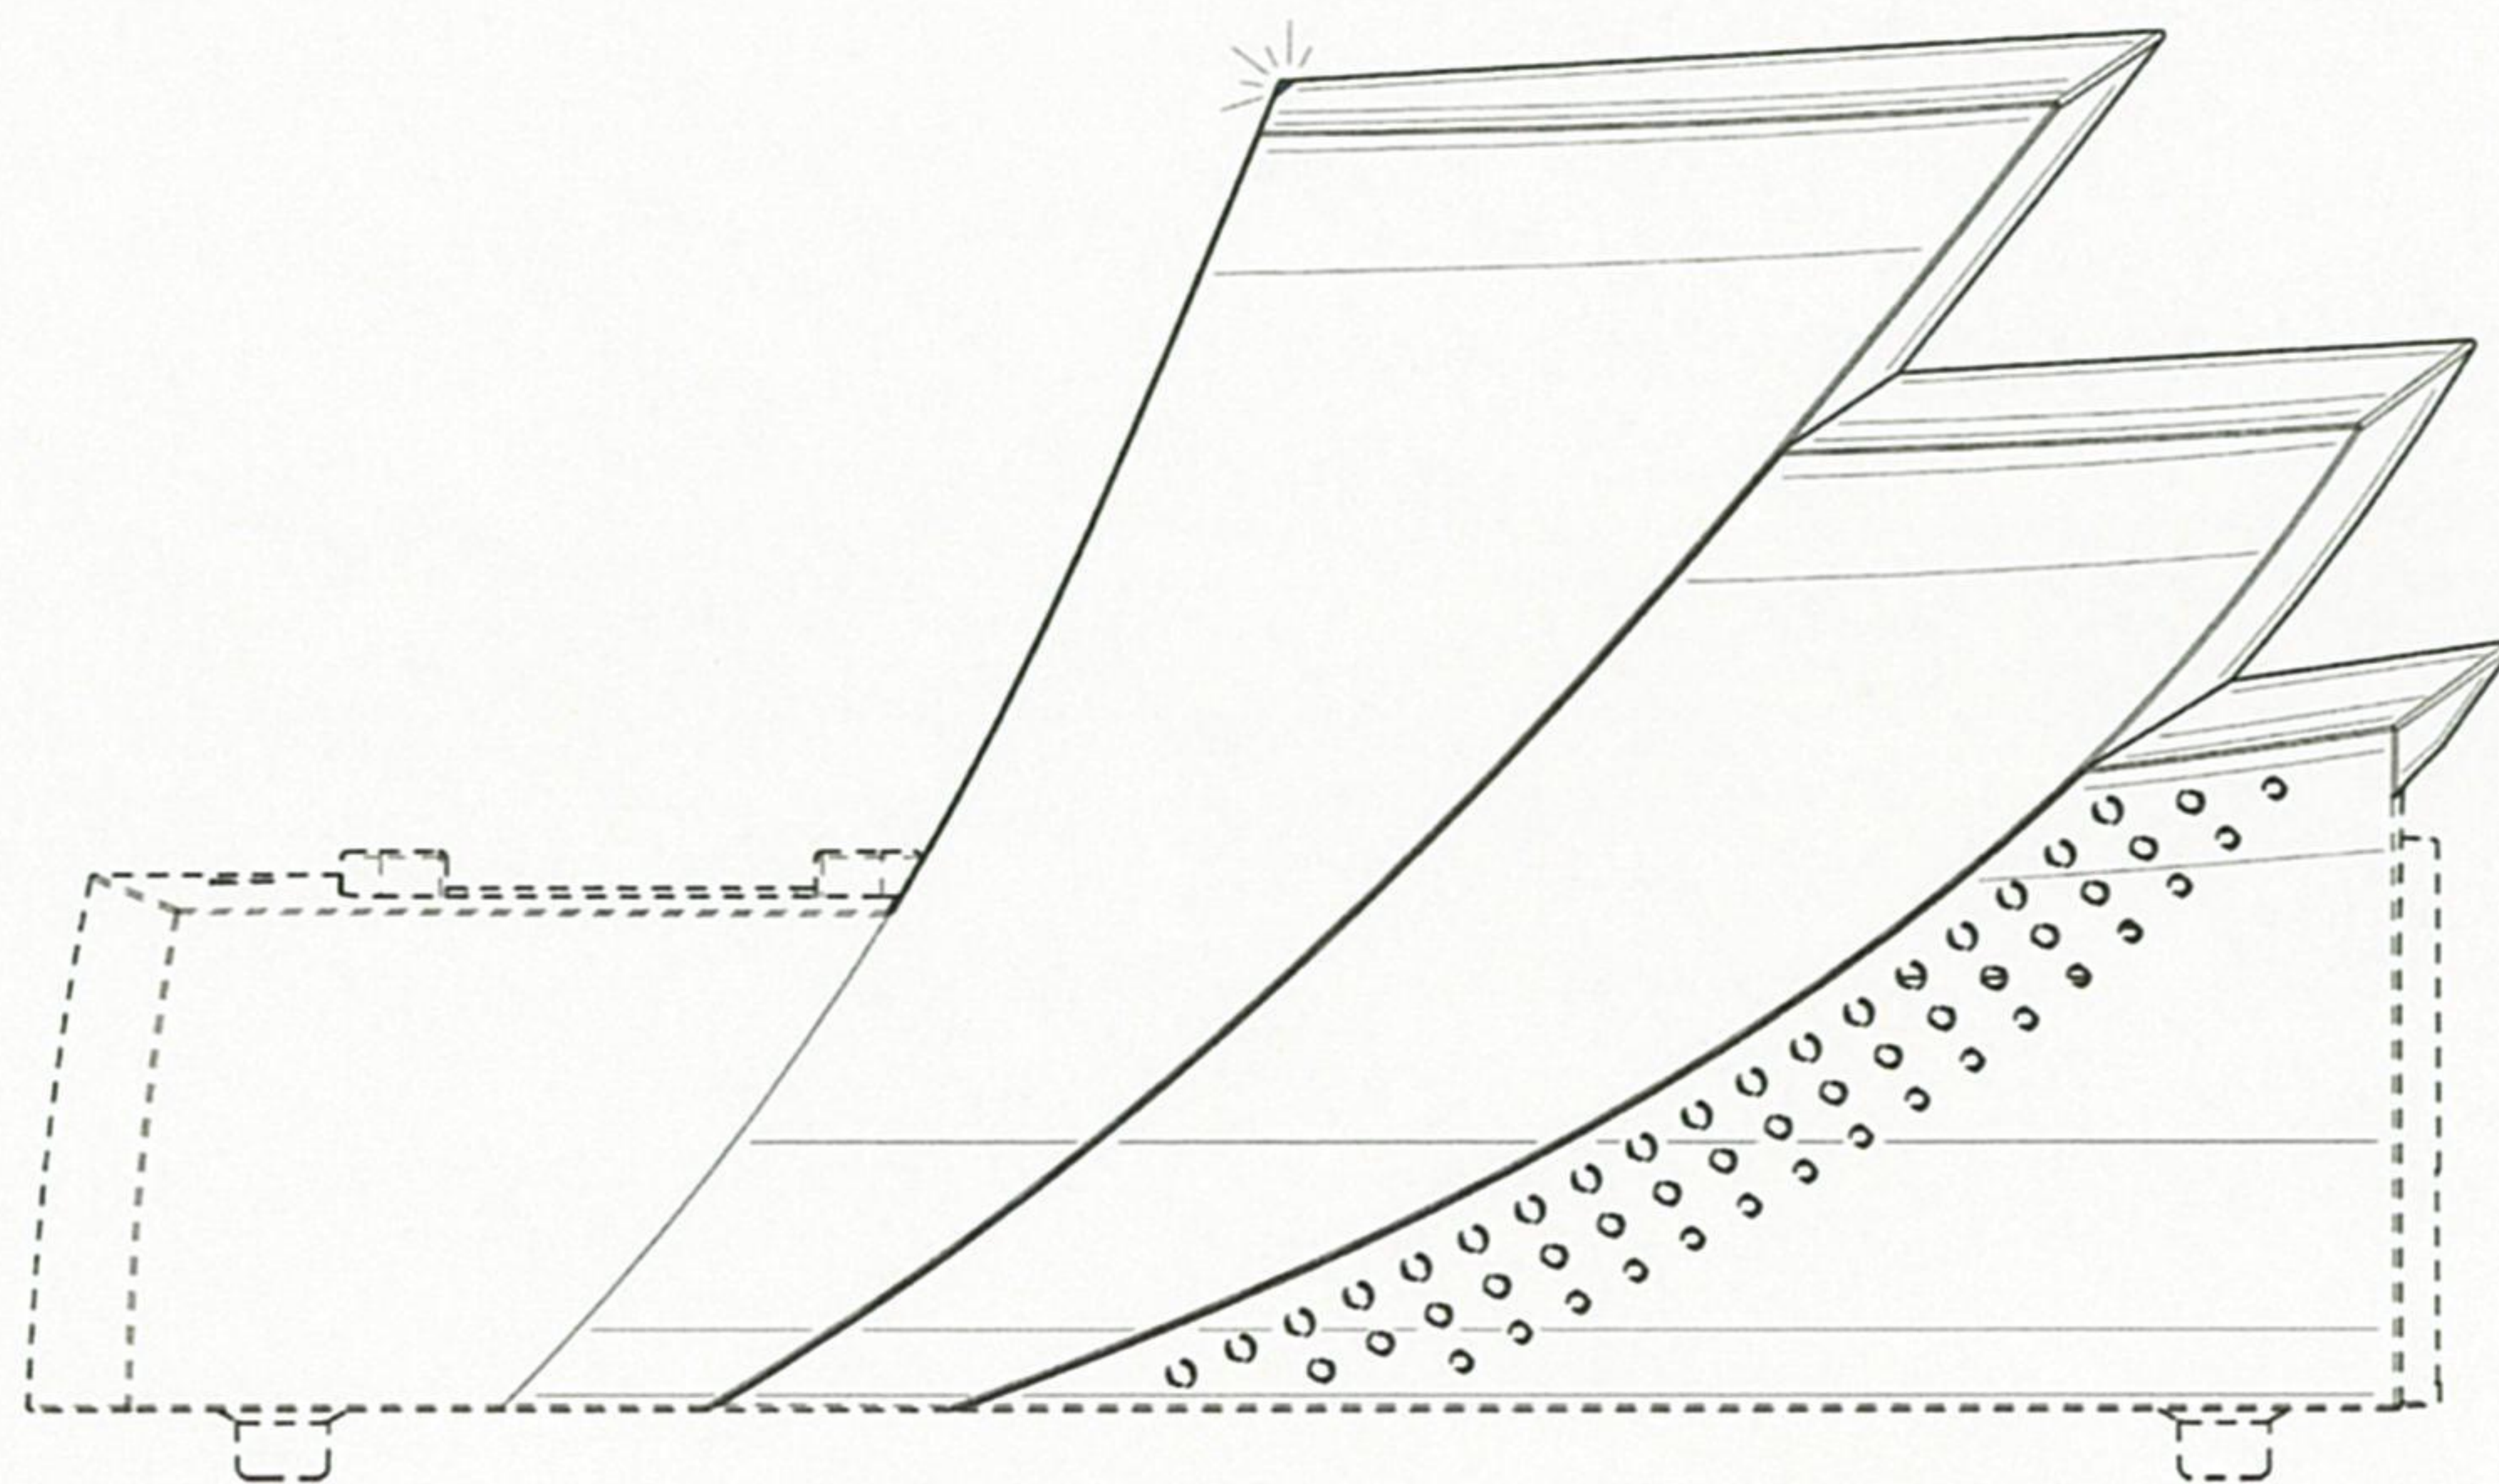

【表示發光部右側視參考圖】