

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2016년 8월 11일 (11.08.2016)



(10) 국제공개번호
WO 2016/126134 A1

- (51) 국제특허분류:
A61B 5/00 (2006.01) *G01N 21/21* (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2016/001294
- (22) 국제출원일: 2016년 2월 5일 (05.02.2016)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2015-0018227 2015년 2월 5일 (05.02.2015) KR
- (71) 출원인: 고려대학교 산학협력단 (KOREA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION) [KR/KR]; 02841 서울시 성북구 안암로 145 (안암동), Seoul (KR). 서울대학교치과병원 (SEOUL NATIONAL UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL) [KR/KR]; 03122 서울시 종로구 대학로 101(연건동), Seoul (KR).
- (72) 발명자: 임재관 (IM, Jae-Gwan); 14600 경기도 부천시 원미구 부흥로 150, 1617 동 902 호(상동, 사랑마을아파트), Gyeonggi-do (KR). 윤승주 (YOON, Seung-Zhoo); 04423 서울시 용산구 이촌로 87 길 13, 103 동 106 호(이촌동, 강촌아파트), Seoul (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 남촌 (NAMCHON INTERNATIONAL PATENT AND LAW FIRM); 110-051 서울시 종로

구 새문안로 5길 37, 도림빌딩 406호 (도림동), Seoul (KR).


(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[다음 쪽 계속]

(54) Title: OPTICAL SYSTEM FOR DETECTING BIOLOGICAL TISSUE BY USING POLARIZING CHARACTERISTIC

(54) 발명의 명칭: 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템

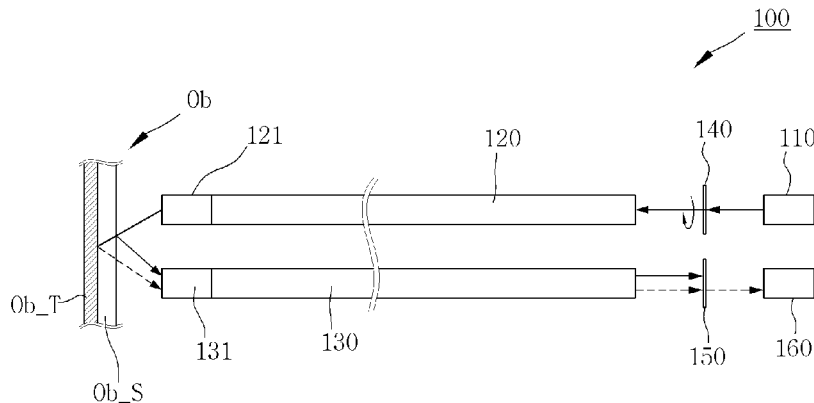

(57) Abstract: The present invention relates to an optical system for detecting a biological tissue by using a polarizing characteristic, the optical system comprising: a light source unit for emitting light; a light guide unit for a light source, the light guide unit being made of a flexible material and in which the light emitted from the light source unit is incident on one side thereof and is emitted at the other side thereof; a photographing unit for photographing the light emitted from the other side of the light guide unit for a light source and reflected from a subject to be measured; a first polarizing plate provided so as to rotate around an optical path of the light, as an axis, moving toward the subject to be measured from the light source unit, and polarizing, in a first polarizing direction, the light moving toward the subject to be measured; a second polarizing plate arranged on an optical path of the light, which is reflected from the subject to be measured so as to move toward the photographing unit, and blocking the transmission of light polarized in the first polarizing direction among lights moving toward the photographing unit by being polarized in a second polarizing direction vertical to the first polarizing direction; and a control unit for rotating the first polarizing plate and controlling the photographing unit such that the photographing unit photographs at least two images, and for detecting a biological tissue on the basis of pixel brightness changes in at least two images. Therefore, a biological tissue can be detected by using a polarizing characteristic capable of detecting a biological tissue in which an outer membrane such as a nerve or a ligament has a polarizing characteristic.

(57) 요약서:

[다음 쪽 계속]

WO 2016/126134 A1

**공개:**

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))

— 청구범위 보정 기한 만료 전의 공개이며, 보정서를 접수하는 경우 그에 관하여 별도 공개함 (규칙 48.2(h))

본 발명은 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템에 관한 것으로, 광을 조사하는 광원부와; 일측으로 상기 광원부로부터 조사되는 광이 입사되어 타측으로 방출되는 플렉시블한 재질의 광원용 광 가이드부와; 상기 광원용 광 가이드부의 타측으로부터 방출되어 측정 대상으로부터 반사되는 광을 촬영하기 위한 촬영부와; 상기 광원부로부터 상기 측정 대상으로 향하는 광의 광 경로를 측으로 회전 가능하게 설치되어, 상기 측정 대상으로 향하는 빛을 제 1 편광 방향으로 편광시키는 제 1 편광판과; 상기 측정 대상으로부터 반사되어 상기 촬영부로 향하는 광의 광 경로 상에 배치되고, 상기 제 1 편광 방향과 수직인 제 2 편광 방향으로 편광되어 상기 촬영부로 향하는 광 중 상기 제 1 편광 방향으로 편광된 광의 투과를 차단하는 제 2 편광판과; 상기 제 1 편광판을 회전시키며 상기 촬영부가 적어도 2 이상의 이미지를 촬영하도록 제어하고, 적어도 2 이상의 이미지 상의 화소의 밝기 변화에 기초하여 상기 생체 조직을 검출하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 신경이나 인대와 같이 외부막이 편광 특성을 갖는 생체 조직을 검출할 수 있는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출할 수 있게 된다.

명세서

발명의 명칭: 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템

기술분야

- [1] 본 발명은 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템에 관한 것으로, 신경이나 인대와 같이 외부막이 편광 특성을 갖는 생체 조직을 검출할 수 있는 광학 시스템에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 현재 의료 분야에서 신경 검출과 관련된 기술 중, 전극을 인가한 후 근육 반응을 이용하여 신경을 검출하는 기술이 이용되고 있다. 일 예로 미국공개특허 제2003-0045808호에 개시된 "Nerve proximity and status detection system and method"에서는 전극에 다중 전류 레벨을 인가하고, 신경의 응답에 따라 신경의 근접도를 검출하는 내용이 개시되어 있다.
- [3] 그러나, 전극을 이용하여 신경을 검출하는 기술에 있어, 전극에 반응하는 운동 신경의 경우 근육 반응을 통해 신경의 위치를 확인할 수 있으나, 감각 신경과 같이 전극에 반응하지 않는 신경의 경우 이를 확인할 수 없는 단점이 있다.
- [4] 의료 분야에서 신경을 검출하는 기술이 중요한 이유는, 갑상선 수술과 같이, 피부 조직을 절개하여 수술을 실시하는 경우, 혈류 때문에 신경을 육안으로 확인하기 어려울 뿐만 아니라, 전극 반응을 통해 신경의 위치를 찾더라도 혈류에 의해 가려져 이를 육안으로 확인하기는 어렵게 된다.
- [5] 이러한 상황에서 수술을 위한 절개나 이상 조직을 절개하는 과정에서 신경을 절개하는 경우가 발생하게 되어 환자에게 심각한 수술 후유증을 야기하는 원인으로 작용하고 있고, 특히 갑상선 수술에서 신경을 절단하여 목소리 기능에 손상을 야기하는 경우가 종종 발생하고 있다.
- [6] 근래에 생체 조직의 검출에 있어 광의 편광 특성을 이용하는 기술이 제안되고 있다. 도 1은 편광 특성을 이용한 종래의 검출 장치를 나타낸 도면이다. 도 1을 참조하여 설명하면, 생체 조직의 표층과 심층에 편광된 광을 조사하여 반사되는 광을 촬영하는 방식을 이용한다.
- [7] 광원(1)으로부터 광이 편광판(2)을 통과하면서 편광된 상태로 생체 조직에 조사되면, 반사글라스(3)를 통해 생체 조직의 표층(S)과 심층(D)에서 반사되어 편광판(4)을 통과한 광을 카메라(5)를 이용하여 촬영하고, 촬영된 이미지를 이용하여 표층(S)과 심층(D)과 관련된 이미지를 얻게 된다.
- [8] 여기서, 두 개의 편광판(2,4)의 편광 방향이 서로 평행한 경우 표층(S)에 대한 정보를 얻게 되고, 두 개의 편광판(2,4)이 서로 수직하게 되면 심층(D)에 대한 정보를 얻게 된다.
- [9] 그러나, 단지 편광된 광을 이용하여 심층(D)에 대한 정보를 얻는다 하더라도,

심층 내에 있는 혈관, 신경, 인대 등의 다양한 조직을 구분하는데는 시술자의 경험에 의존해야 하는 문제가 있으며, 신경 조직만을 검출하는데 사용되기는 부족한 부분이 있다.

[10] 상기와 같은 문제점은 광 섬유와 같은 광 가이드를 이용하는 내시경과 같은 광학 시스템에서도 동일하게 발생하고 있다.

[11] 내시경을 이용한 수술의 경우에도 내시경을 통해 얻어지는 이미지는 단지 흑백 또는 컬러 이미지 만을 얻게 되는데, 내시경을 이용한 수술에서도 자칫 신경과 같은 생체 조직을 절단하게 되면 상술한 바와 같은 후유증이 발생하게 된다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

[12] 이에, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해소하기 위해 안출된 것으로서, 신경이나 인대와 같이 외부막이 편광 특성을 갖는 생체 조직을 검출할 수 있는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.

[13] 또한, 신경이나 인대와 같은 생체 조직을 검출하여 이미지화하는데 있어, 우수한 컬러 이미지를 제공할 수 있는 광학 시스템을 제공하는데 또 다른 목적이 있다.

과제 해결 수단

[14] 상기 목적은 본 발명에 따라, 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템에 있어서, 광을 조사하는 광원부와; 일측으로 상기 광원부로부터 조사되는 광이 입사되어 타측으로 방출되는 플렉시블한 재질의 광원용 광 가이드부와; 상기 광원용 광 가이드부의 타측으로부터 방출되어 측정 대상으로부터 반사되는 광을 촬영하기 위한 촬영부와; 상기 광원부로부터 상기 측정 대상으로 향하는 광의 광 경로를 축으로 회전 가능하게 설치되어, 상기 측정 대상으로 향하는 빛을 제1 편광 방향으로 편광시키는 제1 편광판과; 상기 측정 대상으로부터 반사되어 상기 촬영부로 향하는 광의 광 경로 상에 배치되고, 상기 제1 편광 방향과 수직인 제2 편광 방향으로 편광되어 상기 촬영부로 향하는 광 중 상기 제1 편광 방향으로 편광된 광의 투과를 차단하는 제2 편광판과; 상기 제1 편광판을 회전시키며 상기 촬영부가 적어도 2 이상의 이미지를 촬영하도록 제어하고, 적어도 2 이상의 이미지 상의 화소의 밝기 변화에 기초하여 상기 생체 조직을 검출하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템에 의해서 달성된다.

[15] 여기서, 상기 생체 조직은 편광 특성을 갖는 외부막을 가질 수 있다.

[16] 또한, 상기 측정 대상과 상기 촬영부 사이에 배치되어, 일측으로 상기 측정 대상으로부터 반사된 광이 입사되고 타측으로 방출시켜 상기 촬영부로 향하게 하는 이미지용 광 가이드부를 더 포함할 수 있다.

[17] 그리고, 상기 제1 편광판은 상기 광원부와 상기 광원용 광 가이드부 사이에

- 배치되고; 상기 제2 편광판은 상기 촬영부와 상기 이미지용 광 가이드부 사이에 배치될 수 있다.
- [18] 또한, 상기 광원용 광 가이드부 및 상기 이미지용 광 가이드부는 광 섬유 형태로 마련될 수 있다.
- [19] 그리고, 상기 제1 편광판은 상기 광원용 광 가이드부와 상기 측정 대상 사이의 상기 광원용 광 가이드부의 타측에 배치되고, 상기 제2 편광판은 상기 이미지용 광 가이드부와 상기 측정 대상 사이의 상기 이미지용 광 가이드부의 일측에 설치될 수 있다.
- [20] 그리고, 상기 광학 시스템은 상기 광원용 광 가이드부가 광 섬유 형태로 마련되는 전자 내시경 형태를 가지며; 상기 촬영부는 상기 전자 내시경의 첨단부에 설치되는 CCD 카메라를 포함하며; 상기 제2 편광판은 상기 전자 내시경의 첨단부의 상기 CCD 카메라 전방에 설치될 수 있다.
- [21] 그리고, 상기 촬영부는 상기 신체 조직 내부에서 산란되어 상기 제2 편광판을 투과한 광을 촬영할 수 있다.
- [22] 또한, 상기 생체 조직은 측정 대상의 피하에 위치하고; 상기 제1 편광판에 의해 편광된 후 표층으로부터 반사된 광은 상기 제2 편광판에 의해 차단될 수 있다.
- [23] 그리고, 상기 제어부는 상기 제1 편광판을 상기 제2 편광 방향과 수직한 방향으로부터 상기 제2 편광 방향과 평행한 방향 범위 내에서 회전시킬 수 있다.
- [24] 여기서, 상기 제어부는 적어도 2 이상의 이미지 상의 화소의 밝기 변화가 기 설정된 기준 변화율 이상인 경우, 상기 생체 조직으로 검출할 수 있다.
- [25] 또한, 상기 광원부로부터 조사되는 광 중 기 설정된 파장대만을 투과시키는 파장 필터를 더 포함할 수 있다.
- [26] 또한, 상기 파장 필터는 녹색 광의 파장대만을 투과시키도록 마련될 수 있다.
- [27] 그리고, 상기 광원부는 적색광, 녹색광 및 청색광을 선택적으로 조사 가능하게 마련되며; 상기 제어부는 상기 청색광의 조사에 따라 상기 생체 조직을 검출하고, 상기 청색광의 조사에 따라 상기 촬영부에 의해 촬영된 이미지, 상기 적색광의 조사에 따라 상기 촬영부에 의해 촬영된 이미지, 및 상기 녹색광의 조사에 따라 상기 촬영부에 의해 촬영된 이미지를 합성하여 컬러 이미지를 형성할 수 있다.
- [28] 그리고, 상기 광원부는 적색광, 녹색광 및 청색광을 선택적으로 조사 가능하게 마련되며; 상기 제어부는 광 경로 상에 상기 제1 편광판 및 상기 제2 편광판이 배치된 상태에서 상기 청색광의 조사에 따라 상기 생체 조직을 검출하고, 광 경로 상에서 상기 제1 편광판 및 상기 제2 편광판이 제거된 상태에서 상기 적색광과 상기 녹색광이 각각 조사되도록 상기 광원부를 제어하고, 상기 적색광 및 상기 녹색광의 조사에 따른 이미지가 촬영되도록 상기 촬영부를 제어하며, 상기 청색광의 조사에 따라 상기 촬영부에 의해 촬영된 이미지, 상기 적색광의 조사에 따라 상기 촬영부에 의해 촬영된 이미지, 및 상기 녹색광의 조사에 따라 상기 촬영부에 의해 촬영된 이미지를 합성하여 컬러 이미지를 형성할 수 있다.

- [29] 또한, 상기 광원부는 특정 파장대의 광을 조사 가능한 형태로 마련될 수 있다.
 [30] 그리고, 상기 제2 편광판은 상기 촬영부로 입사되는 광의 광 경로를 축으로 회전 가능하게 설치되며; 상기 제어부는 상기 제1 편광판과 상기 제2 편광판의 편광 방향이 상호 교차되는 상태로 회전하도록 상기 제1 편광판과 상기 제2 편광판을 제어할 수 있다.

발명의 효과

- [31] 상기와 같은 구성에 따라, 본 발명에 따르면, 신경이나 인대와 같이 외부막이 편광 특성을 갖는 생체 조직을 검출할 수 있는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 내시경 시스템과 같은 광학 시스템이 제공된다.
 [32] 또한, 신경이나 인대와 같은 생체 조직을 검출하여 이미지화하는데 있어, 우수한 컬러 이미지를 제공할 수 있는 내시경 시스템과 같은 광학 시스템이 제공된다.

도면의 간단한 설명

- [33] 도 1은 편광 특성을 이용한 종래의 검출 장치를 나타낸 도면이고,
 [34] 도 2는 본 발명에 따른 광학 시스템의 예인 내시경 시스템의 구성을 나타낸 도면이고,
 [35] 도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 내시경 시스템의 구성을 설명하기 위한 도면이고,
 [36] 도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 내시경 시스템의 제어블럭도이고,
 [37] 도 5는 실제 신경 조직의 단면을 나타낸 도면이고,
 [38] 도 6은 신경 조직의 편광 특성을 설명하기 위한 도면이고,
 [39] 도 7은 본 발명의 제1 실시예에 따른 제1 편광판을 회전시키며 촬영한 이미지의 예를 나타낸 도면이고,
 [40] 도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 내시경 시스템의 구성을 설명하기 위한 도면이고,
 [41] 도 9는 본 발명의 제3 실시예에 따른 내시경 시스템의 구성을 설명하기 위한 도면이고,
 [42] 도 10 및 도 11은 본 발명에 따른 내시경 시스템의 다른 예를 나타낸 도면이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

- [43] 본 발명에 따른 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템은 광을 조사하는 광원부와; 일측으로 상기 광원부로부터 조사되는 광이 입사되어 타측으로 방출되는 플렉시블한 재질의 광원용 광 가이드부와; 상기 광원용 광 가이드부의 타측으로부터 방출되어 측정 대상으로부터 반사되는 광을 촬영하기 위한 촬영부와; 상기 광원부로부터 상기 측정 대상으로 향하는 광의 광 경로를 축으로 회전 가능하게 설치되어, 상기 측정 대상으로 향하는 빛을 제1 편광 방향으로 편광시키는 제1 편광판과; 상기 측정 대상으로부터 반사되어 상기 촬영부로 향하는 광의 광 경로 상에 배치되고, 상기 제1 편광 방향과 수직인 제2

편광 방향으로 편광되어 상기 촬영부로 향하는 광 중 상기 제1 편광 방향으로 편광된 광의 투과를 차단하는 제2 편광판과; 상기 제1 편광판을 회전시키며 상기 촬영부가 적어도 2 이상의 이미지를 촬영하도록 제어하고, 적어도 2 이상의 이미지 상의 화소의 밝기 변화에 기초하여 상기 생체 조직을 검출하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

발명의 실시를 위한 형태

- [44] 이하, 본 발명의 실시예를 나타내는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 상세히 설명한다.
- [45] 본 발명에 따른 광학 시스템(100)은 편광 특성을 이용하여 생체 조직(Ob_T)을 검출한다. 본 발명에 따른 광학 시스템(100)은 내시경 시스템(100)과 같이 광 가이드에 의해 광이 안내되는 장치에 적용된다. 또한, 본 발명에 따른 광학 시스템(100)은 신경(N, 도 5 참조)이나 인대와 같이 외부막(M, 도 5 참조)이 편광 특성을 갖는 생체 조직(Ob_T)을 검출한다.
- [46] 이하에서는, 본 발명에 따른 광학 시스템(100)의 실시예들을 설명하는데 있어, 본 발명에 따른 광학 시스템(100)이, 도 2에 도시된 바와 같이, 내시경 시스템(100)인 것을 예로 하여 설명한다.
- [47] 도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 내시경 시스템(100)의 구성을 설명하기 위한 도면이고, 도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 내시경 시스템(100)의 제어블럭도이다. 도 2 내지 도 4를 참조하여 설명하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 내시경 시스템(100)은 광원부(110), 광원용 광 가이드부(120), 촬영부(160), 제1 편광판(140), 제2 편광판(150) 및 제어부(180)를 포함한다.
- [48] 광원부(110)는 측정 대상(Ob), 예를 들어 신체 내부의 표층(Ob_S)이나 신체 내부에서 수술 중 절개된 내부를 비추기 위한 광을 조사한다. 본 발명에서는 광원부(110)가 가시광 영역의 백색광을 조사하는 것을 예로 한다. 본 발명에서는 광원부(110)가 LED 광원(111c)을 사용하는 것을 예로 한다.
- [49] 광원용 광 가이드부(120)는 일측으로 광원부(110)로부터 조사된 광이 입사되고, 입사된 광을 타측으로 방출한다. 본 발명에서는 광원용 광 가이드부(120)가 내시경 시스템(100)에 적용 가능한 플렉시블(Flexible)한 재질로 마련되는 것을 예로 하는데, 광 섬유가 다발로 구성되는 것을 예로 한다. 여기서, 광 가이드부는 플렉시블한 재질의 내시경 튜브 내부에 수용된다.
- [50] 촬영부(160)는 광원용 광 가이드부(120)의 타측으로부터 방출되어 측정 대상(Ob)으로부터 반사되는 광을 촬영하여 이미지를 형성한다. 본 발명의 제1 실시예에서는 촬영부(160)가 이미지용 광 가이드부(130)에 의해 안내되는 광을 촬영하는 것을 예로 한다.
- [51] 도 3을 참조하여 보다 구체적으로 설명하면, 이미지용 광 가이드부(130)는 측정 대상(Ob)과 촬영부(160) 사이에 배치되는데, 일측으로 측정 대상(Ob)으로부터 반사되는 광이 입사되고, 타측으로 입사된 광을 방출하여 촬영부(160)로 향하게

한다. 본 발명의 제1 실시예에 따른 광원용 광 가이드부(120)는 플렉시블한 재질, 예를 들어 광 섬유가 다발로 형성되는 것을 예로 하며, 광원용 광 가이드부(120)와 함께 내시경 튜브 내부에 설치되는 것을 예로 한다.

[52] 제1 편광판(140)은 광원부(110)로부터 측정 대상(Ob)으로 향하는 광의 광 경로를 축으로 회전 가능하게 설치된다. 그리고, 제1 편광판(140)은 광원부(110)로부터 조사되어 측정 대상(Ob)으로 향하는 광을 제1 편광 방향으로 편광시킨다.

[53] 본 발명의 제1 실시예에서는 제1 편광판(140)이 광원부(110)와 광원용 광 가이드부(120) 사이에 배치되는 것을 예로 한다. 즉, 본 발명에 따른 내시경 시스템(100)에서 인체에 삽입되는 부분이 아닌 인체 외부에 배치된 상태에서 광원부(110)로부터 조사된 광을 편광시켜, 편광된 광을 광원용 광 가이드부(120)로 전달하는 것을 예로 한다.

[54] 제2 편광판(150)은 측정 대상(Ob)으로부터 반사되어 촬영부(160)로 향하는 광의 광 경로 상에 배치된다. 그리고, 제2 편광판(150)은 제1 편광 방향과 수직인 제2 편광 방향으로 편광되어 촬영부(160)로 향하는 광 중 제1 편광 방향으로 편광된 광의 투과를 차단하게 된다.

[55] 본 발명의 제1 실시예에서는 제2 편광판(150)이 촬영부(160)와 이미지용 광 가이드부(130) 사이에 배치되는 것을 예로 한다. 즉, 제1 편광판(140)과 마찬가지로 인체에 삽입되는 부분이 아닌 인체 외부에 배치된 상태에서 이미지용 광 가이드부(130)로부터 방출되는 광 중 제2 편광 방향으로 편광된 광이나 편광 특성을 갖지 않는 광을 통과시켜 촬영부(160)로 향하게 하고, 제2 편광 방향과 교차하는 방향으로 편광된 광, 즉 제1 편광 방향으로 편광된 광의 투과를 차단하게 된다.

[56] 한편, 광원용 광 가이드부(120)의 첨단으로부터 방출된 광은 광원용 렌즈 모듈(121)을 통과한 후 측정 대상(Ob)으로 향하는데, 제1 편광판(140)에 의해 편광된 상태를 유지하며 측정 대상(Ob)으로 입사된다. 이 때 측정 대상(Ob)으로 입사되는 광의 일부는 측정 대상(Ob)의 표층(Ob_S)으로부터 반사되고, 일부는 측정 내부로 입사된 후 내부에서 반사된다.

[57] 도 5는 실제 신경 조직(NT)의 단면을 나타낸 도면이다. 도 5를 참조하여 설명하면, 신경 조직(NT)은 내부에 다발을 이루는 신경(N)과, 신경(N)을 감싸는 외부막(M)으로 구성된다. 도 5에 점선으로 표시한 영역이 외부막(M)에 해당하는 영역이다.

[58] 여기서, 신경(N)을 감싸는 외부막(M)은 편광 특성을 갖는다. 도 6에 도시된 바와 같이, 신경(N)을 감싸는 외부막(M)은 조직이 신경(N)의 길이 방향으로 겹겹이 겹쳐진 형태로 신경(N)을 싸고 있어, 편광 특성을 갖게 된다.

[59] 측정 대상(Ob)의 표층(Ob_S)에서 반사되는 광과, 검출 대상인 생체 조직(Ob_T) 예컨대 신경 조직(NT) 내부에서 산란되어 반사된 광은 이미지용 렌즈 모듈(131)을 통과한 후 이미지용 광 가이드부(130)를 통해 제2 편광판(150)으로

향하게 된다.

- [60] 이 때, 제2 편광판(150)은 측정 대상(Ob)으로부터 촬영부(160)로 향하는 광 중 측정 대상(Ob)의 표층(Ob_S)에서 반사되는 광, 즉 제1 편광판(140)에 의해 제1 편광 방향으로 편광된 광의 투과를 차단하게 된다.
- [61] 반면, 생체 조직(Ob_T)의 내부에서 산란되어 반사된 광은 산란에 의해 편광 특성을 상실하게 되어, 제2 편광판(150)을 투과하여 촬영부(160)에 촬영된다. 즉, 촬영부(160)에 의해 촬영된 광은 측정 대상(Ob)의 표층(Ob_S)에 대한 정보는 차단되고 심층에서 반사되는 광만이 촬영하게 된다.
- [62] 제어부(180)는 제1 편광판(140)을 회전시키며 촬영부(160)가 적어도 2 이상의 이미지를 촬영하도록 제어한다. 여기서, 제어부(180)는 제1 편광판(140)을 제2 편광 방향과 수직인 방향으로부터 제2 편광 방향과 평행한 범위 내에서 회전시킬 수 있다. 예컨대, 제1 편광 방향을 0°라 하고, 제2 편광 방향을 90°라 가정할 때, 제어부(180)는 광 경로를 축으로 10°, 20°, 30° 단위로 제1 편광판(140)이 회전하도록 제1 편광 구동부(141)를 제어하면서 각 회전 위치에서 촬영부(160)가 반사되어 오는 광을 촬영하도록 제어함으로써, 적어도 2 이상의 이미지를 얻게 된다.
- [63] 그리고, 제어부(180)는 촬영부(160)에 의해 촬영된 이미지 상의 각 화소의 밝기 변화에 기초하여 생체 조직(Ob_T)을 검출하고, 검출된 이미지를 디스플레이부(170)의 화면 상에 표시하게 된다.
- [64] 보다 구체적으로 설명하면, 측정 대상(Ob) 내부로 입사되는 편광된 광은 그 편광 방향과 생체 조직(Ob_T), 예컨대 신경 조직(NT)의 외부막(M)의 겹쳐진 방향에 따라 외부막(M)을 투과하여 신경(N)으로 향하는 광의 특성이 바뀌게 된다. 예를 들어, 입사되는 광의 편광 방향과 외부막(M)의 겹쳐진 방향이 일치하게 되면 대부분의 광이 신경(N)으로 입사된다.
- [65] 반면, 측정 대상(Ob) 내부로 입사되는 광의 편광 방향과 외부막(M)의 겹쳐진 방향이 불일치하는 경우, 예컨대 직교하는 경우 대부분이 신경(N) 내부로 입사되지 않는다. 즉, 광의 편광 방향과 외부막(M)의 겹쳐진 방향 간의 편광 방향의 편차에 따라 신경(N) 내부로 입사되는 광이 달라지게 된다.
- [66] 따라서, 외부막(M)을 통과하는 광, 즉 신경 조직(NT) 내부로 입사되는 광이 제1 편광판(140)에 의해 편광된 편광 특성에 따라 달라지게 되고, 내부에서 산란되어 반사되는 광의 밝기 등의 특성 또한 달라지게 된다.
- [67] 도 7은 제1 편광판(140)을 회전시키며 촬영한 이미지의 예를 나타낸 도면이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 편광 특성을 갖는 외부막(M)을 갖는 신경 조직(NT)의 경우, 제1 편광판(140)의 회전에 따라 밝기가 변화되는 것을 확인할 수 있으나, 편광 특성을 갖지 않는 신경 조직(NT)(NT) 이외의 주변 조직의 밝기는 변화하지 않는 것을 확인할 수 있다.
- [68] 이와 같은 특성을 이용하여, 제어부(180)는 제1 편광판(140)을 회전시키며 얻은 이미지 상의 각 화소를 비교하여 밝기의 변화가 발생하는 화소들을 신경

조직(NT)으로 검출하게 된다. 여기서, 제어부(180)는 화소의 밝기 변화가 기 설정된 기준 변화율 이상인 경우에 생체 조직(Ob_T)으로 검출함으로써, 검출 조건에 따라 미세하게 변화하는 노이즈를 제거할 수 있다.

[69] 상기와 같은 구성을 통해, 외부막(M)이 편광 특성을 갖는 생체 조직(Ob_T), 예컨대, 신경 조직(NT)이나 인대 조직이 편광 특성을 갖지 않는 주변 조직과 구별되게 검출이 가능하게 된다.

[70] 한편, 본 발명의 제1 실시예에 따른 내시경 시스템(100)의 제2 편광판(150)은 촬영부(160)로 입사되는 광의 광 경로를 축으로 회전 가능하게 설치될 수 있다. 이 때, 제어부(180)는 제1 편광판(140)과 제2 편광판(150)의 편광 방향이 상호 교차, 바람직하게는 직교하는 상태로 회전하도록 제1 편광 구동부(141)와 제2 편광 구동부(151)를 제어할 수 있다.

[71] 이를 통해, 제1 편광판(140)과 제2 편광판(150)의 편광 방향, 즉 제1 편광 방향과 제2 편광 방향이 직교하는 상태가 유지됨으로써, 측정 대상(Ob)의 표층(Ob_S)에서 반사되는 광, 즉 제1 편광 방향으로 편광된 상태를 유지하는 광이 제2 편광판(150)에 의해 보다 완전히 차단되도록 함으로써, 표층(Ob_S)에서 반사되는 광에 의한 영향을 최소화시킬 수 있다.

[72] 이하에서는, 도 8을 참조하여 본 발명의 제2 실시예에 따른 내시경 시스템(100a)에 대해 상세히 설명한다. 본 발명의 제2 실시예에 따른 내시경 시스템(100a)을 설명하는데 있어, 도 4를 함께 참조하여 설명한다.

[73] 본 발명이 제2 실시예에 따른 내시경 시스템(100a)은, 광원부(110), 광원용 광 가이드부(120), 촬영부(160), 제1 편광판(140a), 제2 편광판(150a) 및 제어부(180)를 포함한다. 또한, 본 발명의 제2 실시예에서도 제1 실시예에서와 마찬가지로 이미지용 광 가이드부(130)가 촬영부(160)와 측정 대상(Ob) 사이에서 측정 대상(Ob)으로부터 반사되는 광을 촬영부(160)로 안내한다.

[74] 본 발명의 제2 실시예에서는 제1 편광판(140a)이 광원용 광 가이드부(120)와, 측정 대상(Ob) 사이의 광원용 광 가이드부(120)의 침단에 설치되는 것을 예로 한다. 본 발명에서는 제1 편광판(140a)이 광원용 광 가이드부(120)와 광원용 렌즈 모듈(121) 사이에 설치되는 것을 예로 한다.

[75] 또한, 제2 편광판(150a)은 이미지용 광 가이드부(130)와 측정 대상(Ob) 사이의 이미지용 광 가이드부(130)의 침단에 설치되는 것을 예로 한다. 본 발명에서는 제2 편광판(150a)이 이미지용 광 가이드부(130)와 이미지용 렌즈 모듈(131) 사이에 설치되는 것을 예로 한다.

[76] 상기와 같은 구성에 따라, 광원부(110)로부터 조사된 광은 광원용 광 가이드부(120)를 통해 측정 대상(Ob)으로 향하게 되고, 광원용 광 가이드부(120)의 말단으로부터 방출되는 광은 제1 편광판(140a)에 의해 제1 편광 방향으로 편광된 상태로 광원용 렌즈 모듈(121)을 통과하여 측정 대상(Ob)으로 조사된다.

[77] 그리고, 측정 대상(Ob)의 표층(Ob_S)과 내부의 생체 조직(Ob_T)으로부터

반사된 광은 이미지용 렌즈 모듈(131)을 거쳐 제2 편광판(150a)을 통과하게 되는데, 측정 대상(Ob)의 표층(Ob_S)으로부터 반사되는 광은 제1 편광판(140a)에 의해 편광된 특성을 유지하여 제2 편광판(150a)에 의해 투과가 차단된다.

[78] 반면, 생체 조직(Ob_T) 내부로 입사되어 산란된 광은 편광 특성을 상실하여 제2 편광판(150a)을 투과한 후 이미지용 광 가이드부(130)를 통해 촬영부(160)로 향하게 되어, 촬영부(160)에 의해 이미지로 형성된다.

[79] 이 때, 제어부(180)는, 제1 실시예에서와 마찬가지로, 제1 편광판(140a)을 광 경로를 축으로 회전시키며 2 이상의 이미지를 촬영하고, 화소 간의 밝기의 변화에 기초하여 신경 조직(NT)을 검출하게 된다.

[80] 여기서, 본 발명의 제2 실시예에 따른 광학 시스템(100a)은 제1 실시예에서와 마찬가지로, 제2 편광판(150a)이 촬영부(160)로 입사되는 광의 광 경로를 축으로 회전 가능하게 설치될 수 있다. 이 때, 제어부(180)는 제1 편광판(140a)과 제2 편광판(150a)의 편광 방향이 상호 교차, 바람직하게는 직교하는 상태로 회전하도록 제1 편광 구동부(141)와 제2 편광 구동부(151)를 제어할 수 있다.

[81] 이를 통해, 제1 편광판(140a)과 제2 편광판(150a)의 편광 방향, 즉 제1 편광 방향과 제2 편광 방향이 직교하는 상태가 유지됨으로써, 측정 대상(Ob)의 표층(Ob_S)에서 반사되는 광, 즉 제1 편광 방향으로 편광된 상태를 유지하는 광이 제2 편광판(150a)에 의해 보다 완전히 차단되도록 함으로써, 표층(Ob_S)에서 반사되는 광에 의한 영향을 최소화시킬 수 있다.

[82] 이하에서는, 도 9를 참조하여 본 발명의 제3 실시예에 따른 내시경 시스템(100b)에 대해 상세히 설명한다. 본 발명의 제3 실시예에 따른 내시경 시스템(100b)을 설명하는데 있어, 도 4를 함께 참조하여 설명한다.

[83] 본 발명이 제3 실시예에 따른 내시경 시스템(100b)은, 광원부(110b), 광원용 광 가이드부(120), 촬영부(160b), 제1 편광판(140b), 제2 편광판(150b) 및 제어부(180)를 포함한다. 본 발명의 제3 실시예에서는 촬영부(160b)가 CCD 카메라 형태로 마련되는 전자 내시경 형태를 갖는 것을 예로 한다. 즉, 촬영부(160)가 전자 내시경 시스템(100b)의 첨단부에 설치되고, 촬영된 이미지를 케이블을 통해 디스플레이부(170)로 전달하게 된다

[84] 이 때, 제2 편광판(150b)은 전자 내시경 시스템(100b)의 첨단부의 CCD 카메라 전방에 설치되는 것을 예로 한다. 도 9에서는 제2 편광판(150b)이 CCD 카메라, 즉 촬영부(160b)와 이미지용 렌즈 모듈(131) 사이의 촬영부(160b)의 전방에 설치되는 것을 예로 한다.

[85] 또한, 도 9에서는 제1 편광판(140b)이 광원용 광 가이드부(120)와 광원부(110) 사이에 설치되는 것을 예로 하고 있으나, 광원용 광 가이드부(120)와 측정 대상(Ob) 사이, 즉, 도 8에 도시된 실시예에서와 같이 광원용 광 가이드부(120)와 광원용 렌즈 모듈(121) 사이에 설치될 수 있음은 물론이다.

[86] 상기과 같은 구성에 따라, 제어부(180)가 제1 편광판(140b)을 회전시키며 2 이상의 이미지를 촬영하고, 화소의 밝기의 변화에 따라 신경 조직(NT)의 검출이

가능하게 된다.

- [87] 이하에서는 도 10 및 도 11을 참조하여, 전술한 실시예들에서의 구성에서 컬러 이미지를 획득할 수 있는 광학 시스템(100c)에 대한 실시예에 대해 상세히 설명한다. 본 실시예를 설명하는데 있어 광학 시스템(110c)의 구성은 전술한 제1 실시예를 기본으로 하여 설명하며, 기술적 사상은 제2 실시예 및 제3 실시예에 적용될 수 있다.
- [88] 본 실시예에 따른 광학 시스템(100)의 광원부(110c)는 특정 파장대의 광을 조사 가능하게 마련될 수 있다. 일 예로, 광원부(110c)는 실제 광을 조사하는 광원(111c)과, 광원(111c)으로부터 조사되는 광 중 특정 파장대만을 투과시키는 파장 필터(112c)를 포함할 수 있다.
- [89] 일 예로, 파장 필터(112c)가 410nm 파장대의 광만을 투과시키도록 마련될 수 있다. 신경 조직(NT)의 경우, 410nm 파장대에서의 반사율이 가장 낮은 것으로 알려져 있으며, 이는 신경 조직(NT) 내부로 입사되는 광량을 증가시켜 조직 내부에서 산란되어 촬영부(160)에 의해 촬영되는 이미지의 밝기를 보다 높일 수 있게 된다.
- [90] 다른 예로, 파장 필터(112c)가 청색 계열의 파장을 갖는 청색광을 투과시키도록 마련될 수 있다. 청색광을 조사하는 경우, 신경 조직(NT)의 주변 조직, 즉 적색 계열을 나타내는 혈관 등의 주변 조직이 청색광을 모두 흡수하여 어둡게 나타남으로써, 상대적으로 신경 조직(NT)이 주변에 비해 보다 명확하게 나타날 수 있게 된다.
- [91] 또한, 본 실시예에 따른 광학 시스템(100c)에서는 제어부(180)가 청색광을 이용하여 상술한 바와 같은 과정을 통해 생체 조직(Ob_T)을 검출한 후, 녹색광을 조사하여 촬영한 이미지, 적색광을 조사하여 촬영한 이미지와 함께 컬러 이미지를 형성할 수 있다.
- [92] 보다 구체적으로 설명하면, 광원부(110)는 적색광, 녹색광 및 청색광을 선택적으로 조사 가능하게 마련된다. 일 예로, 광원부(110)는 백색광을 조사하는 광원(111c), 적색광을 투과하는 적색 파장 필터(R), 청색광을 투과하는 청색 파장 필터(B), 녹색광을 투과하는 녹색 파장 필터(G)를 포함할 수 있다.
- [93] 그리고, 제어부(180)의 제어에 따라 파장 구동부가 적색 파장 필터(R), 청색 파장 필터(B) 및 녹색 파장 필터(G) 중 하나를 광원(111c)으로부터 조사되는 광의 광 경로 상에 선택적으로 위치시키도록 마련될 수 있다. 도 10에서는 원판 형의 플레이트에 3개의 파장 필터(R,G,B)가 원주 방향을 따라 배치되고, 파장 구동부(113c)가 플레이트를 회전시켜 3개의 파장 필터(R,G,B) 중 하나를 광원(111c) 전방에 위치하도록 마련되는 것을 예로 하고 있다.
- [94] 이러한 구성을 통해, 제어부(180)는 청색광을 조사하는 상태에서, 상술한 바와 같이, 제1 편광판(140)을 회전시키며 적어도 2 이상의 이미지를 촬영하여 생체 조직(Ob_T)을 검출하게 된다.
- [95] 그런 다음, 제어부(180)는 파장 구동부(113c)를 구동하여 적색 파장 필터(R)를

광원(111c) 전방에 배치시킨 후 적색광의 조사를 통해 한 장의 이미지를 얻을 수 있다. 마찬가지로, 제어부(180)는 파장 구동부(113c)를 구동하여 녹색 파장 필터(G)를 광원(111c) 전방에 배치시킨 후 녹색광의 조사를 통해 한 장의 이미지를 얻을 수 있다.

[96] 그리고, 제어부(180)는 청색광의 조사에 따라 촬영부(160)에 의해 촬영된 이미지 한 장, 적색광의 조사에 따라 촬영부(160)에 의해 촬영된 이미지 한 장, 그리고 녹색광의 조사에 따라 촬영부(160)에 의해 촬영된 이미지 한 장을 서로 합성하여 컬러 이미지를 형성할 수 있다.

[97] 즉, 각각의 이미지 상의 화소는 밝기 정보를 갖게 되는데, 3장의 이미지 상의 화소가 각각 적색, 녹색, 청색의 밝기 정보를 갖게 되고, 이를 컬러 이미지의 하나의 화소를 구성하는 R,G,B 데이터로 인식함으로써, 컬러 이미지를 형성하게 된다.

[98] 전술한 실시예에서는 컬러 이미지를 획득하는데 제1 편광판(140)과 제2 편광판(150)이 광 경로 상에 배치된 상태에서 촬영되는 것을 예로 하고 있다. 이외에도, 생체 조직(Ob_T)을 검출하는 과정에서는 제1 편광판(140)과 제2 편광판(150)을 광 경로 상에 배치한 상태로 촬영하고, 나머지 2장의 이미지, 즉 적색광의 조사에 따라 촬영부(160)에 의해 촬영된 이미지와, 녹색광의 조사에 따라 촬영부(160)에 의해 촬영된 이미지를 촬영할 때 제1 편광판(140)과 제2 편광판(150)을 제거한 후 촬영하도록 마련될 수 있다.

[99] 이 경우, 편광판을 투과하는 광은 그 밝기가 감소하는 특성을 반영하기 위해, 생체 조직(Ob_T)을 검출하는 과정에서의 청색광은 녹색광과 적색광의 광량보다 밝게 조사하도록 마련되는 것이 바람직하다.

[100] 비록 본 발명의 몇몇 실시예들이 도시되고 설명되었지만, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 당업자라면 본 발명의 원칙이나 정신에서 벗어나지 않으면서 본 실시예를 변형할 수 있음을 알 수 있을 것이다. 발명의 범위는 첨부된 청구항과 그 균등물에 의해 정해질 것이다.

[101] [부호의 설명]

[102] 100,100a,100b,100c : 내시경 시스템

[103] 110,110c : 광원부

[104] 111c : 광원 112c : 파장 필터

[105] 113c : 파장 구동부 120 : 광원용 광 가이드부

[106] 121 : 광원용 렌즈 모듈 130 : 이미지용 광 가이드부

[107] 131 : 이미지용 렌즈 모듈 140,140a,140b : 제1 편광판

[108] 150,150a,150b : 제2 편광판 160 : 촬영부

[109] 170 : 디스플레이부 180 : 제어부

산업상 이용가능성

[110] 본 발명은 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템에 적용

가능하다.

청구범위

- [청구항 1] 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템에 있어서,
 광을 조사하는 광원부와;
 일측으로 상기 광원부로부터 조사되는 광이 입사되어 타측으로 방출되는
 플렉시블한 재질의 광원용 광 가이드부와;
 상기 광원용 광 가이드부의 타측으로부터 방출되어 측정 대상으로부터
 반사되는 광을 촬영하기 위한 촬영부와;
 상기 광원부로부터 상기 측정 대상으로 향하는 광의 광 경로를 축으로
 회전 가능하게 설치되어, 상기 측정 대상으로 향하는 빛을 제1 편광
 방향으로 편광시키는 제1 편광판과;
 상기 측정 대상으로부터 반사되어 상기 촬영부로 향하는 광의 광 경로
 상에 배치되고, 상기 제1 편광 방향과 수직인 제2 편광 방향으로 편광되어
 상기 촬영부로 향하는 광 중 상기 제1 편광 방향으로 편광된 광의 투과를
 차단하는 제2 편광판과;
 상기 제1 편광판을 회전시키며 상기 촬영부가 적어도 2 이상의 이미지를
 촬영하도록 제어하고, 적어도 2 이상의 이미지 상의 화소의 밝기 변화에
 기초하여 상기 생체 조직을 검출하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로
 하는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템.
- [청구항 2] 제1항에 있어서,
 상기 생체 조직은 편광 특성을 갖는 외부막을 갖는 것을 특징으로 하는
 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템.
- [청구항 3] 제2항에 있어서,
 상기 측정 대상과 상기 촬영부 사이에 배치되어, 일측으로 상기 측정
 대상으로부터 반사된 광이 입사되고 타측으로 방출시켜 상기 촬영부로
 향하게 하는 이미지용 광 가이드부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템.
- [청구항 4] 제3항에 있어서,
 상기 제1 편광판은 상기 광원부와 상기 광원용 광 가이드부 사이에
 배치되고;
 상기 제2 편광판은 상기 촬영부와 상기 이미지용 광 가이드부 사이에
 배치되는 것을 특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을
 검출하는 광학 시스템.
- [청구항 5] 제4항에 있어서,
 상기 광원용 광 가이드부 및 상기 이미지용 광 가이드부는 광 섬유 형태로
 마련되는 것을 특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을
 검출하는 광학 시스템.
- [청구항 6] 제3항에 있어서,

상기 제1 편광판은 상기 광원용 광 가이드부와 상기 측정 대상 사이의
상기 광원용 광 가이드부의 타측에 배치되고,
상기 제2 편광판은 상기 이미지용 광 가이드부와 상기 측정 대상 사이의
상기 이미지용 광 가이드부의 일측에 설치되는 것을 특징으로 하는 편광
특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템.

[청구항 7] 제2항에 있어서,
상기 광학 시스템은 상기 광원용 광 가이드부가 광 섬유 형태로 마련되는
전자 내시경 형태를 가지며;
상기 촬영부는 상기 전자 내시경의 첨단부에 설치되는 CCD 카메라를
포함하며;
상기 제2 편광판은 상기 전자 내시경의 첨단부의 상기 CCD 카메라
전방에 설치되는 것을 특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을
검출하는 광학 시스템.

[청구항 8] 제2항에 있어서,
상기 촬영부는 상기 신체 조직 내부에서 산란되어 상기 제2 편광판을
투과한 광을 촬영하는 것을 특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체
조직을 검출하는 광학 시스템.

[청구항 9] 제8항에 있어서,
상기 생체 조직은 측정 대상의 피하에 위치하고;
상기 제1 편광판에 의해 편광된 후 표층으로부터 반사된 광은 상기 제2
편광판에 의해 차단되는 것을 특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체
조직을 검출하는 광학 시스템.

[청구항 10] 제8항에 있어서,
상기 제어부는 상기 제1 편광판을 상기 제2 편광 방향과 수직한
방향으로부터 상기 제2 편광 방향과 평행한 방향 범위 내에서 회전시키는
것을 특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학
시스템.


[청구항 11] 제8항에 있어서,
상기 제어부는 적어도 2 이상의 이미지 상의 화소의 밝기 변화가 기
설정된 기준 변화율 이상인 경우, 상기 생체 조직으로 검출하는 것을
특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템.

[청구항 12] 제8항에 있어서,
상기 광원부로부터 조사되는 광 중 기 설정된 파장대만을 투과시키는
파장 필터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체
조직을 검출하는 광학 시스템.


[청구항 13] 제12항에 있어서,
상기 파장 필터는 녹색 광의 파장대만을 투과시키도록 마련되는 것을
특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템.

- [청구항 14] 제8항에 있어서,
 상기 광원부는 적색광, 녹색광 및 청색광을 선택적으로 조사 가능하게 마련되며;
 상기 제어부는
 상기 청색광의 조사에 따라 상기 생체 조직을 검출하고,
 상기 청색광의 조사에 따라 상기 촬영부에 의해 촬영된 이미지, 상기 적색광의 조사에 따라 상기 촬영부에 의해 촬영된 이미지, 및 상기 녹색광의 조사에 따라 상기 촬영부에 의해 촬영된 이미지를 합성하여 컬러 이미지를 형성하는 것을 특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템.
- [청구항 15] 제8항에 있어서,
 상기 광원부는 적색광, 녹색광 및 청색광을 선택적으로 조사 가능하게 마련되며;
 상기 제어부는
 광 경로 상에 상기 제1 편광판 및 상기 제2 편광판이 배치된 상태에서
 상기 청색광의 조사에 따라 상기 생체 조직을 검출하고,
 광 경로 상에서 상기 제1 편광판 및 상기 제2 편광판이 제거된 상태에서
 상기 적색광과 상기 녹색광이 각각 조사되도록 상기 광원부를 제어하고,
 상기 적색광 및 상기 녹색광의 조사에 따른 이미지가 촬영되도록 상기 촬영부를 제어하며,
 상기 청색광의 조사에 따라 상기 촬영부에 의해 촬영된 이미지, 상기 적색광의 조사에 따라 상기 촬영부에 의해 촬영된 이미지, 및 상기 녹색광의 조사에 따라 상기 촬영부에 의해 촬영된 이미지를 합성하여 컬러 이미지를 형성하는 것을 특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템.
- [청구항 16] 제8항에 있어서,
 상기 광원부는 특정 파장대의 광을 조사 가능한 형태로 마련되는 것을 특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템.
- [청구항 17] 제8항에 있어서,
 상기 제2 편광판은 상기 촬영부로 입사되는 광의 광 경로를 축으로 회전 가능하게 설치되며;
 상기 제어부는 상기 제1 편광판과 상기 제2 편광판의 편광 방향이 상호 교차되는 상태로 회전하도록 상기 제1 편광판과 상기 제2 편광판을 제어하는 것을 특징으로 하는 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템.


[도1]

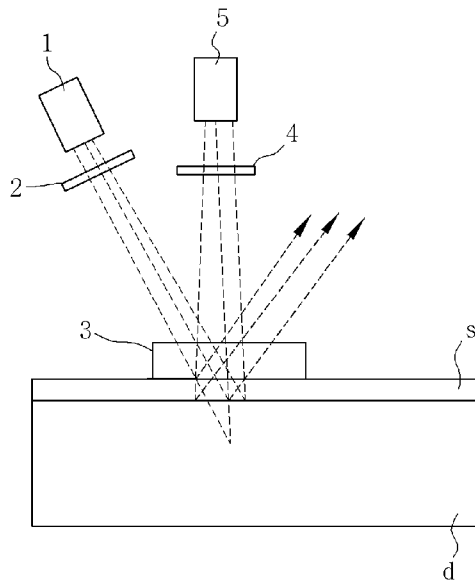


[도2]

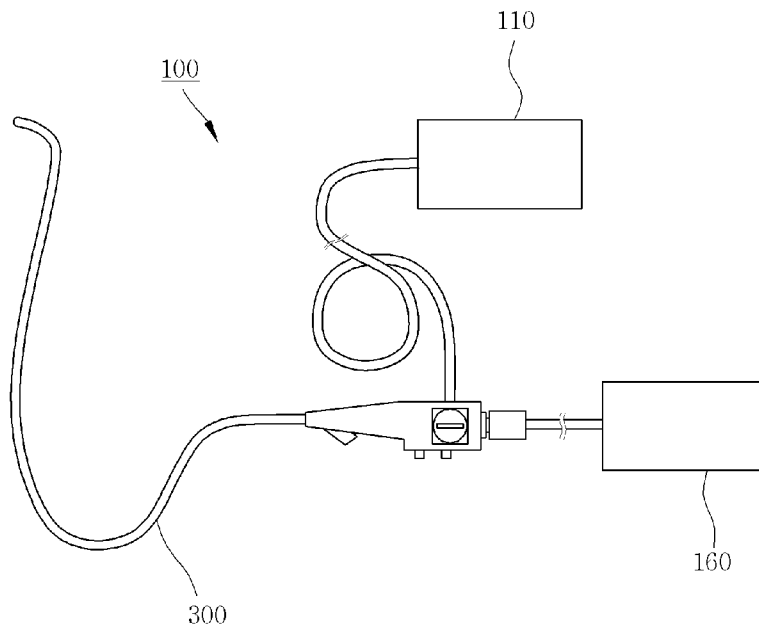


[도3]

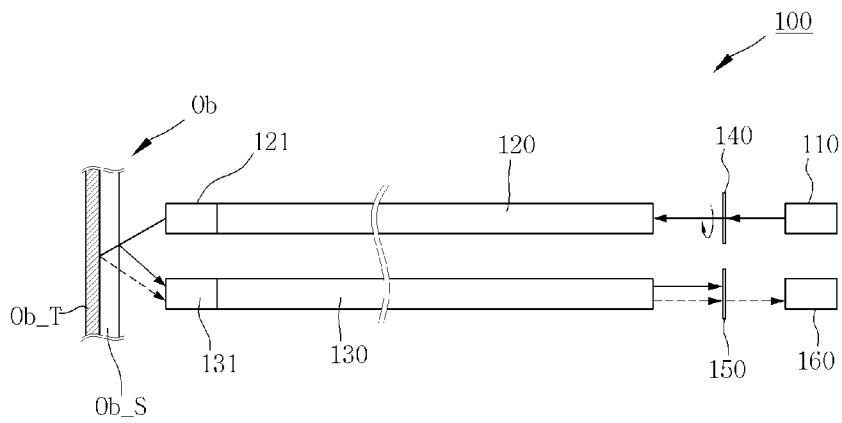


[도4]

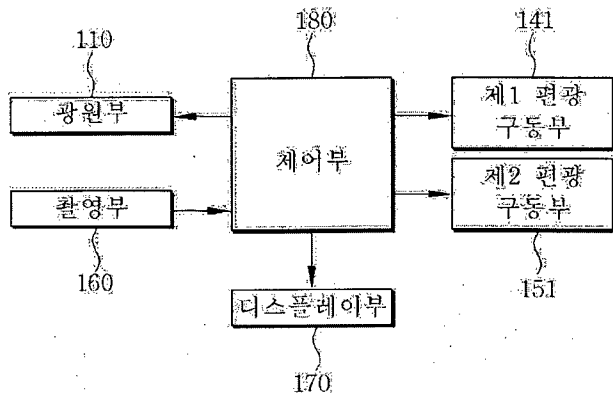


[도5]

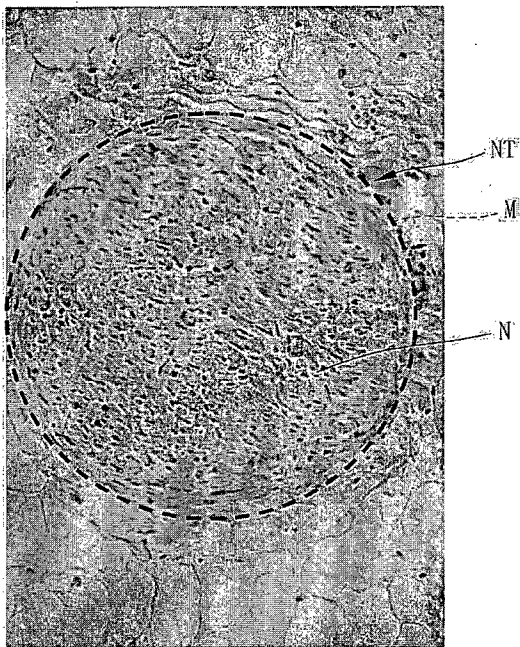


[도6]

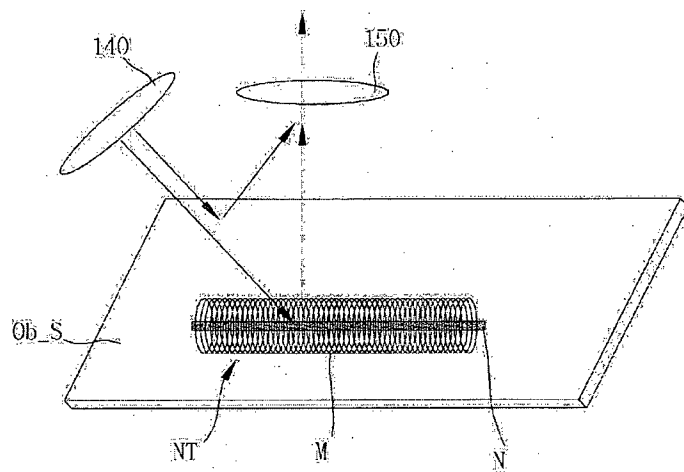


[도7]

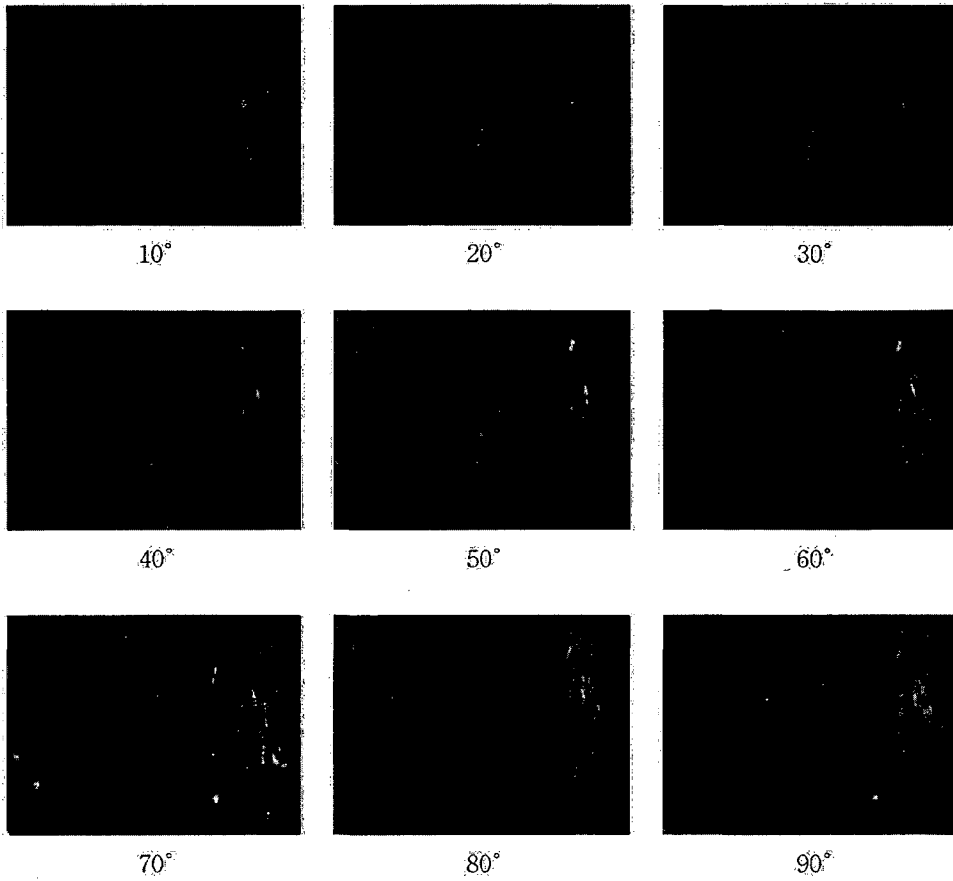


[도8]

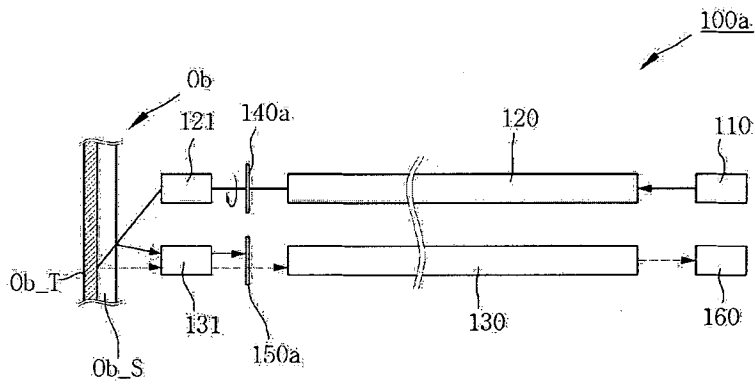


[도9]

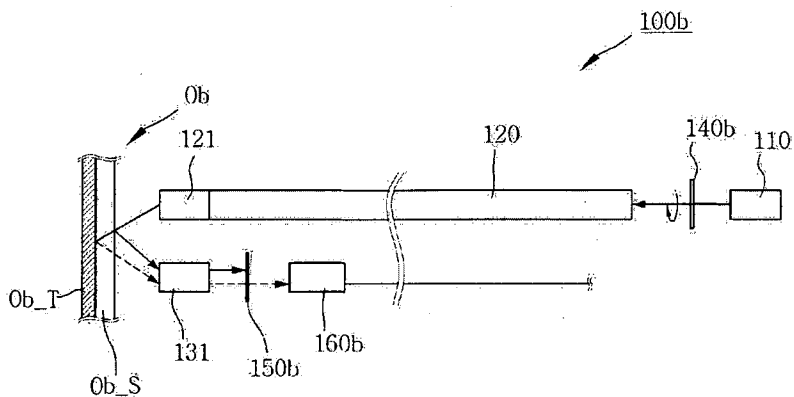

[도10]

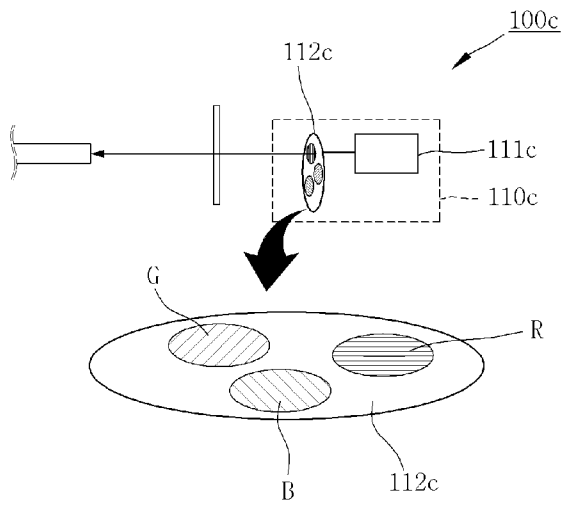

[도11]

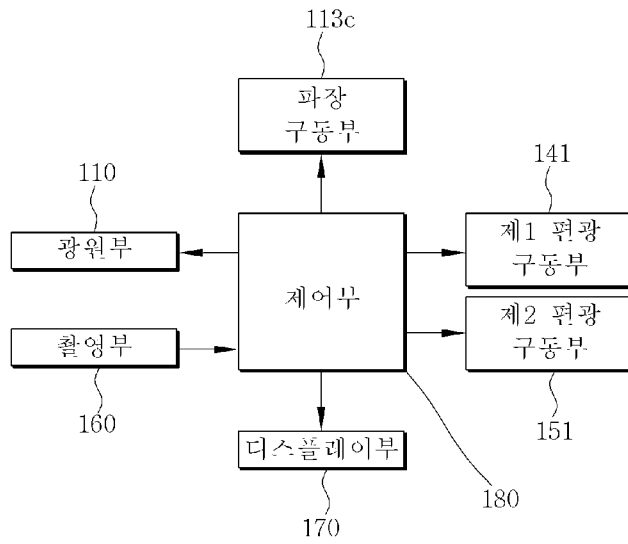

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2016/001294**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER****A61B 5/00(2006.01)i, G01N 21/21(2006.01)i**

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61B 5/00; A61B 1/00; G01B 11/24; A61B 10/00; A61B 5/117; A61B 1/06; A61B 1/012; G01N 21/21

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: body, light source, polarization, optical guide, camera

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	KR 10-0406169 B1 (KOREA ATOMIC ENERGY RESEARCH INSTITUTE et al.) 17 November 2003 See abstract, pages 2-3, claim 1 and figures 1, 2.	1-17
Y	JP 08-224210 A (OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.) 03 September 1996 See abstract, paragraphs [11]-[38], claim 1 and figure 4.	1-17
Y	KR 10-1035667 B1 (SONY CORP.) 19 May 2011 See abstract, paragraph [32] and figure 4.	2-17
Y	KR 10-2014-0028358 A (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE) 10 March 2014 See abstract, paragraphs [7]-[38], claims 1-10 and figures 1-5.	8-17
A	KR 10-0886205 B1 (KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE) 27 February 2009 See abstract, claims 1-4 and figure 1.	1-7



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 MAY 2016 (27.05.2016)

Date of mailing of the international search report

27 MAY 2016 (27.05.2016)

Name and mailing address of the ISA/KR

Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon, 189 Seonsa-ro, Daejeon 302-701,
Republic of Korea

Facsimile No. 82-42-472-7140

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2016/001294

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-0406169 B1	17/11/2003	KR 10-2001-0038688 A	15/05/2001
JP 08-224210 A	03/09/1996	NONE	
KR 10-1035667 B1	19/05/2011	CN 101231690 A	30/07/2008
		CN 101520844 A	02/09/2009
		CN 101520844 B	30/05/2012
		EP 1503330 A1	02/02/2005
		EP 1503330 B1	02/06/2010
		EP 2098977 A1	09/09/2009
		EP 2098977 B1	21/11/2012
		EP 2328111 A1	01/06/2011
		JP 2003-331270 A	21/11/2003
		JP 2003-331271 A	21/11/2003
		JP 4247656 B2	02/04/2009
		JP 4499341 B2	07/07/2010
		KR 10-1044029 B1	23/06/2011
		US 2005-0180620 A1	18/08/2005
		US 2007-0116330 A1	24/05/2007
		US 2008-0118114 A1	22/05/2008
		US 2011-0038511 A1	17/02/2011
		US 2012-0148143 A1	14/06/2012
		US 2014-0301610 A1	09/10/2014
		US 7415139 B2	19/08/2008
		US 7869624 B2	11/01/2011
		US 8144942 B2	27/03/2012
		US 8811680 B2	19/08/2014
		US 9234842 B2	12/01/2016
		WO 03-096272 A1	20/11/2003
KR 10-2014-0028358 A	10/03/2014	US 2014-0066781 A1	06/03/2014
KR 10-0886205 B1	27/02/2009	KR 10-2008-0098248 A	07/11/2008

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

A61B 5/00(2006.01)i, G01N 21/21(2006.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

A61B 5/00; A61B 1/00; G01B 11/24; A61B 10/00; A61B 5/117; A61B 1/06; A61B 1/012; G01N 21/21

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC
일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))

eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 생체, 광원, 편광, 광가이드, 카메라

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
Y	KR 10-0406169 B1 (한국원자력연구소 등) 2003.11.17 요약, 페이지 2-3, 청구항 1 및 도면 1,2 참조.	1-17
Y	JP 08-224210 A (OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.) 1996.09.03 요약, 문단번호 [11]-[38], 청구항 1 및 도면 4 참조.	1-17
Y	KR 10-1035667 B1 (소니 주식회사) 2011.05.19 요약, 문단번호 [32] 및 도면 4 참조.	2-17
Y	KR 10-2014-0028358 A (한국전자통신연구원) 2014.03.10 요약, 문단번호 [7]-[38], 청구항 1-10 및 도면 1-5 참조.	8-17
A	KR 10-0886205 B1 (한국전기연구원) 2009.02.27 요약, 청구항 1-4 및 도면 1 참조.	1-7

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.

☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

“A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

“T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

“E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

“X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

“L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

“Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

“O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

“&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

“P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

국제조사의 실제 완료일

2016년 05월 27일 (27.05.2016)

국제조사보고서 발송일

2016년 05월 27일 (27.05.2016)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소



대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스 번호 +82-42-481-8578

심사관

김연정

전화번호 +82-42-481-3325



국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-0406169 B1	2003/11/17	KR 10-2001-0038688 A	2001/05/15
JP 08-224210 A	1996/09/03	없음	
KR 10-1035667 B1	2011/05/19	CN 101231690 A	2008/07/30
		CN 101520844 A	2009/09/02
		CN 101520844 B	2012/05/30
		EP 1503330 A1	2005/02/02
		EP 1503330 B1	2010/06/02
		EP 2098977 A1	2009/09/09
		EP 2098977 B1	2012/11/21
		EP 2328111 A1	2011/06/01
		JP 2003-331270 A	2003/11/21
		JP 2003-331271 A	2003/11/21
		JP 4247656 B2	2009/04/02
		JP 4499341 B2	2010/07/07
		KR 10-1044029 B1	2011/06/23
		US 2005-0180620 A1	2005/08/18
		US 2007-0116330 A1	2007/05/24
		US 2008-0118114 A1	2008/05/22
		US 2011-0038511 A1	2011/02/17
		US 2012-0148143 A1	2012/06/14
		US 2014-0301610 A1	2014/10/09
		US 7415139 B2	2008/08/19
		US 7869624 B2	2011/01/11
		US 8144942 B2	2012/03/27
		US 8811680 B2	2014/08/19
		US 9234842 B2	2016/01/12
		WO 03-096272 A1	2003/11/20
KR 10-2014-0028358 A	2014/03/10	US 2014-0066781 A1	2014/03/06
KR 10-0886205 B1	2009/02/27	KR 10-2008-0098248 A	2008/11/07