(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202665579 U
(45)授权公告日 2013.01.16

(21)申请号 201220255383.3

(22)申请日 2012.06.01

(73)专利权人 任知良
地址 266000 山东省即墨市健民街 4 号

(72)发明人 任知良

(51)Int.Cl.
*A61B 10/00*(2006.01)
*A61F 5/44*(2006.01)
*A61M 1/00*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种新型尿液引流装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种医疗卫生用具，尤其是一种用于对尿液进行引流的新型尿液引流装置。其包括引流管、集尿袋和取样袋，所述引流管呈倒立的Y字形，所述引流管具有一个输入端和两个输出端，所述引流管上设有球囊，所述引流管的输入端和输出端均连接有接头，所述引流管的一个输出端与集尿袋连接，另一个输出端与取样袋连接，所述引流管的两个输出端处均设有搓轮开关。它结构简单，可随时对患者尿液进行取样检测，方便医护人员的护理提高了工作效率，产生了一定的有益效果。

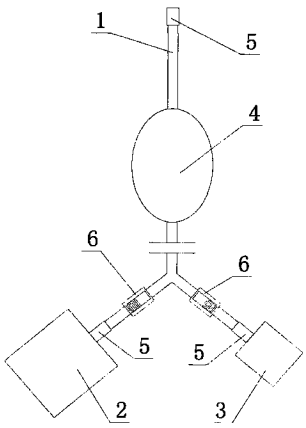


CN 202665579 U

1. 一种新型尿液引流装置，其特征在于：包括引流管、集尿袋和取样袋，所述引流管呈倒立的 Y 字形，所述引流管具有一个输入端和两个输出端，所述引流管上设有球囊，所述引流管的输入端和输出端均连接有接头，所述引流管的一个输出端与集尿袋连接，另一个输出端与取样袋连接，所述引流管的两个输出端处均设有搓轮开关。

# 一种新型尿液引流装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗卫生用具，尤其是一种用于对尿液进行引流的新型尿液引流装置。

## 背景技术

[0002] 传统的尿液引流装置是由引流管和集尿袋组成，在使用过程中无法随时对患者的尿液进行取样检测，造成数据采集不准确。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型旨在解决上述问题，提供了一种新型尿液引流装置，它克服了传统尿液引流装置无法随时取样的弊端，其采用的技术方案如下：

[0004] 一种新型尿液引流装置，包括引流管、集尿袋和取样袋，所述引流管呈倒立的 Y 字形，所述引流管具有一个输入端和两个输出端，所述引流管上设有球囊，所述引流管的输入端和输出端均连接有接头，所述引流管的一个输出端与集尿袋连接，另一个输出端与取样袋连接，所述引流管的两个输出端处均设有搓轮开关。

[0005] 本实用新型具有如下优点：结构简单，可随时对患者尿液进行取样检测，方便医护人员的护理提高了工作效率。

## 附图说明

[0006] 图 1：本实用新型的结构示意图；

[0007] 符号说明

[0008] 1. 引流管，2. 集尿袋，3. 取样袋，4. 球囊，5. 接头，6. 搓轮开关。

## 具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实例对本实用新型作进一步说明：

[0010] 如图 1 所示，本实用新型的一种新型尿液引流装置，包括引流管 1、集尿袋 2 和取样袋 3，所述引流管 1 呈倒立的 Y 字形，所述引流管 1 具有一个输入端和两个输出端，所述引流管 1 上设有球囊 4，所述引流管 1 的输入端和输出端均连接有接头 5，所述引流管 1 的一个输出端与集尿袋 2 连接，另一个输出端与取样袋 3 连接，所述引流管 1 的两个输出端处均设有搓轮开关 6，使用时将集尿袋 2 和取样袋 3 与引流管 1 输出端的接头 5 螺纹连接，将引流管 1 输入端的接头 5 与尿液导出装置（图中未示出）连接，打开位于集尿袋 2 一侧的搓轮开关 6，关闭位于取样袋 3 一侧的搓轮开关 6，可对尿液进行收集，若需对尿液进行取样只需关闭位于集尿袋 2 一侧的搓轮开关 6，打开位于取样袋 3 一侧的搓轮开关 6，取样完毕关闭位于取样袋 3 一侧的搓轮开关 6，拧下取样袋 3 即可。

[0011] 上面以举例方式对本实用新型进行了说明，但本实用新型不限于上述具体实施例，凡基于本实用新型所做的任何改动或变型均属于本实用新型要求保护的范围。

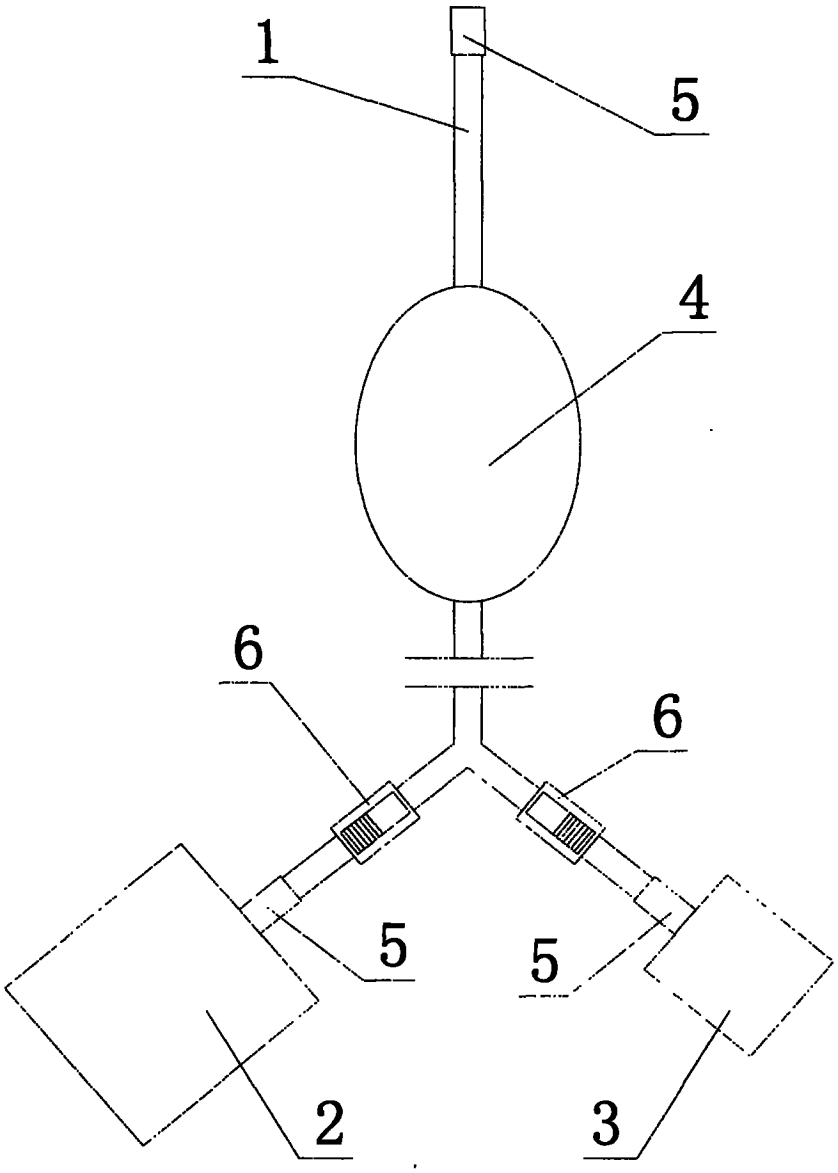



图 1