



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221013680 U

(45) 授权公告日 2024. 05. 28

(21) 申请号 202321941121.7

(22) 申请日 2023.07.24

(73) 专利权人 南方医科大学顺德医院(佛山市
顺德区第一人民医院)

地址 528300 广东省佛山市顺德区大良镇
东建路42号

(72) 发明人 李春艳 卢翠泮 吴玉婵 邓凯贤

(74) 专利代理机构 北京领时辉专利代理事务所
(普通合伙) 33330

专利代理师 黄思荣

(51) Int.Cl.

A61F 13/36 (2006.01)

A61B 17/12 (2006.01)

A61B 17/42 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球

(57) 摘要

本实用新型公开了一种妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球,包括止血纱套,所述止血纱套底端开口处安装有束紧环边,所述束紧环边内开设有穿孔。有益效果在于:本实用新型一方面能够通过将止血纱套以及止血纱球直接填充在女性患者宫颈出血部位,从而来实现对宫颈活检后女性患者宫颈部位的止血,由于在该种止血方式下无需通过逐步观察每个纱布块填充后的出血情况来控制纱布块的填充数量,从而有效减少了止血过程中女性患者宫颈处的出血量,另一方面在止血后可以通过拉动拉绳一以及拉绳二来实
现止血纱套整体由患者宫颈处的便捷取出,由于在该种取出方式下无需使患者再返回医院进行取出,从而大大提升了女性患者在宫颈活检后的护理效果。

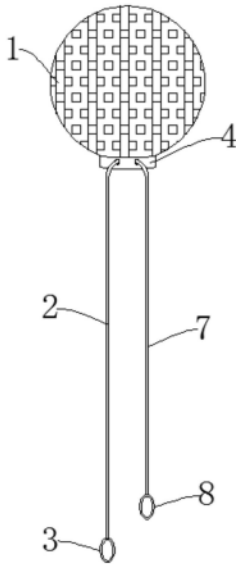

1. 一种妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球,其特征在于:包括止血纱套(1),所述止血纱套(1)底端开口处安装有束紧环边(4),所述束紧环边(4)内开设有过孔(6),所述过孔(6)两端均贯穿所述束紧环边(4),所述过孔(6)内一侧安装有拉绳一(2),所述拉绳一(2)远离所述束紧环边(4)一端连接有拉环一(3),所述过孔(6)内另一侧安装有拉绳二(7),所述拉绳二(7)远离所述束紧环边(4)一端连接有拉环二(8),所述止血纱套(1)内填充有止血纱球(5)。

2. 根据权利要求1所述的一种妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球,其特征在于:所述束紧环边(4)成型于所述止血纱套(1)上,所述过孔(6)成型于所述束紧环边(4)上。

3. 根据权利要求1所述的一种妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球,其特征在于:所述拉绳一(2)与所述拉绳二(7)在所述过孔(6)内通过捆绑的方式相连。

4. 根据权利要求1所述的一种妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球,其特征在于:所述拉环一(3)与所述拉绳一(2)缝制连接,所述拉环二(8)与所述拉绳二(7)缝制连接。

5. 根据权利要求1所述的一种妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球,其特征在于:所述止血纱球(5)不少于5个,所述止血纱球(5)采用纱布块制成。

一种妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球

技术领域

[0001] 本实用新型涉及宫颈活检止血技术领域,具体涉及一种妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球。

背景技术

[0002] 宫颈活检就是子宫颈的活体组织检查,亦即从宫颈上取一小块或几块组织作病理检查,以确定诊断。多用于宫颈可疑癌变或是宫颈刮片有可疑的细胞等。宫颈活检可以明确诊断,确定治疗方法。宫颈活检是确诊宫颈癌最可靠的依据。无论是早期或晚期宫颈癌,都必须通过本项检查以确定癌肿的病理类型和细胞分化程度。活检后为了避免女性患者宫颈处的过多出血,需要在活检后对女性患者宫颈处进行止血操作。

[0003] 目前在宫颈活检后主要是通过女性在患者宫颈处填充适量的纱布块,从而来达到对活检后女性患者宫颈处进行止血的目的,但是采用填充纱布块的方式来对活检后女性患者的宫颈处止血,一方面需要通过观察填充后纱布块的止血效果来判定纱布块的填充数量,导致止血过程中女性患者出血较多,另一方面在该种止血方式下需要使患者在24小时后返回医院在医生帮助下来实现纱布块的取出,由于该种止血方式下,纱布块的取出较为不便,从而大大降低了女性患者在宫颈活检后的护理效果。

实用新型内容

[0004] (一)要解决的技术问题

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的现状,提供一种能够通过一次填充来有效减少女性患者在宫颈活检后的出血量,同时能够在宫颈活检后实现止血用具自行取出,提升女性患者在宫颈活检后的护理效果的妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球。

[0006] (二)技术方案

[0007] 本实用新型通过如下技术方案实现:本实用新型提出了一种妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球,包括止血纱套,所述止血纱套底端开口处安装有束紧环边,所述束紧环边内开设有过孔,所述过孔两端均贯穿所述束紧环边,所述过孔内一侧安装有拉绳一,所述拉绳一远离所述束紧环边一端连接有拉环一,所述过孔内另一侧安装有拉绳二,所述拉绳二远离所述束紧环边一端连接有拉环二,所述止血纱套内填充有止血纱球。

[0008] 进一步的,所述束紧环边成型于所述止血纱套上,所述过孔成型于所述束紧环边上。

[0009] 通过采用上述技术方案,所述束紧环边主要用于实现所述止血纱套端口处的封闭。

[0010] 进一步的,所述拉绳一与所述拉绳二在所述过孔内通过捆绑的方式相连。

[0011] 通过采用上述技术方案,这样设计是为了在拉动所述拉绳一以及所述拉绳二时可以实现所述束紧环边的收紧。

[0012] 进一步的,所述拉环一与所述拉绳一缝制连接,所述拉环二与所述拉绳二缝制连

接。

[0013] 通过采用上述技术方案,所述拉环一是为了方便拉动所述拉绳一,所述拉环二是为了方便拉动所述拉绳二。

[0014] 进一步的,所述止血纱球不少于5个,所述止血纱球采用纱布块制成。

[0015] 通过采用上述技术方案,调节所述止血纱球的数量可以改变所述止血纱套的体积,从而方便医生对所述止血纱套的尺寸进行统一调整,满足对不同女性患者宫颈处的止血需求。

[0016] (三)有益效果

[0017] 本实用新型相对于现有技术,具有以下有益效果:

[0018] 为解决目前在宫颈活检后主要是通过通过在女性患者宫颈处填充适量的纱布块,从而达到对活检后女性患者宫颈处进行止血的目的,但是采用填充纱布块的方式来对活检后女性患者的宫颈处止血,一方面需要通过观察填充后纱布块的止血效果来判定纱布块的填充数量,导致止血过程中女性患者出血较多,另一方面在该种止血方式下需要使患者在24小时后返回医院在医生帮助下来实现纱布块的取出,由于该种止血方式下,纱布块的取出较为不便,从而大大降低了女性患者在宫颈活检后的护理效果的问题,本实用新型一方面能够通过将止血纱套以及止血纱球直接填充在女性患者宫颈出血部位,从而来实现对宫颈活检后女性患者宫颈部位的止血,由于在该种止血方式下无需通过逐步观察每个纱布块填充后的出血情况来控制纱布块的填充数量,从而有效减少了止血过程中女性患者宫颈处的出血量,另一方面在止血后可以通过拉动拉绳一以及拉绳二来实现止血纱套整体由患者宫颈处的便捷取出,由于在该种取出方式下无需使患者再返回医院进行取出,从而大大提升了女性患者在宫颈活检后的护理效果。

附图说明

[0019] 图1是本实用新型所述一种妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球的结构示意图;

[0020] 图2是本实用新型所述一种妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球中止血纱套的主剖视图。

[0021] 附图标记说明如下:

[0022] 1、止血纱套;2、拉绳一;3、拉环一;4、束紧环边;5、止血纱球;6、过孔;7、拉绳二;8、拉环二。

具体实施方式

[0023] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0024] 如图1-图2所示,本实施例中的一种妇科阴道镜活检术后带尾止血纱球,包括止血纱套1,止血纱套1底端开口处安装有束紧环边4,束紧环边4内开设有过孔6,过孔6两端均贯穿束紧环边4,过孔6内一侧安装有拉绳一2,拉绳一2远离束紧环边4一端连接有拉环一3,过孔6内另一侧安装有拉绳二7,拉绳二7远离束紧环边4一端连接有拉环二8,拉动拉绳一2以及拉绳二7可以实现止血纱套1由女性患者体内的直接取出,由于在该种取出方式下无需使

患者再返回医院进行取出,从而大大提升了女性患者在宫颈活检后的护理效果,止血纱套1内填充有止血纱球5,调节止血纱球5的数量可以改变止血纱套1的体积,从而方便医生对止血纱套1的尺寸进行统一调整,满足对不同女性患者宫颈处的止血需求。

[0025] 如图1-图2所示,本实施例中,束紧环边4成型于止血纱套1上,过孔6成型于束紧环边4上,束紧环边4主要用于实现止血纱套1端口处的封闭,拉绳一2与拉绳二7在过孔6内通过捆绑的方式相连,这样设计是为了在拉动拉绳一2以及拉绳二7时可以实现束紧环边4的收紧,拉环一3与拉绳一2缝制连接,拉环二8与拉绳二7缝制连接,拉环一3是为了方便拉动拉绳一2,拉环二8是为了方便拉动拉绳二7。

[0026] 本实施例的具体实施过程如下:使用时首先将止血纱球5填充在止血纱套1内,并通过拉动拉绳一2以及拉绳二7来实现束紧环边4的收缩,然后只需将止血纱套1放置在女性患者宫颈出血部位,便可在活检后对女性患者的宫颈出血部位进行止血,当止血24小时后,患者可通过拉动拉绳一2以及拉绳二7来实现止血纱套1由宫颈处的拉出,从而省去了女性患者到医院拿取止血用具的繁琐操作,提升了女性患者在宫颈活检后的护理效果,同时由于在该种止血方式下无需通过逐步观察每个纱布块填充后的出血情况来控制纱布块的填充数量,从而有效减少了止血过程中女性患者宫颈处的出血量。

[0027] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

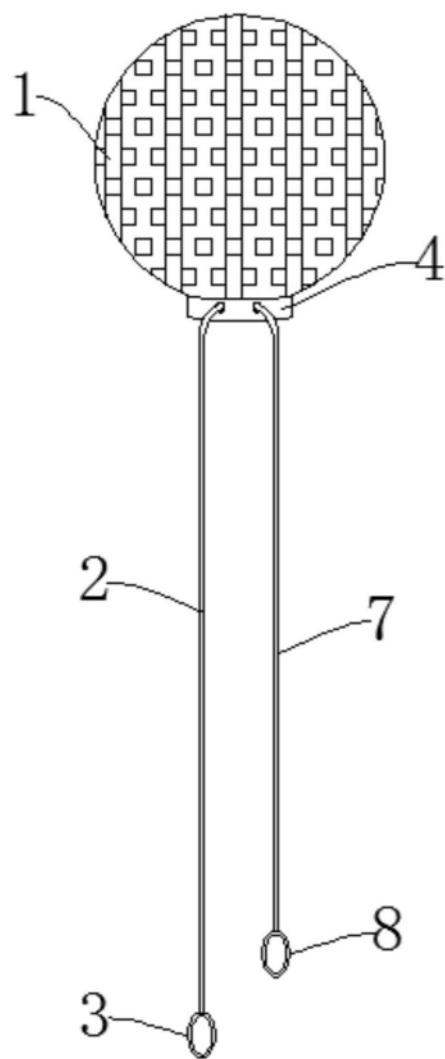


图1

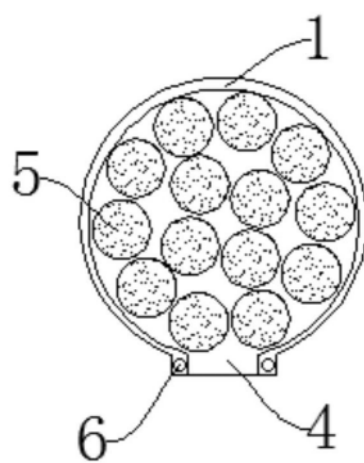


图2