

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202437331 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 19

(21) 申请号 201120560728. 1

(22) 申请日 2011. 12. 29

(73) 专利权人 赵秀华

地址 250031 山东省济南市天桥区无影山中
路 12 号山东省交通医院手术室

(72) 发明人 赵秀华

(51) Int. Cl.

A61B 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种手术室寻针器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种手术室寻针器,包括手柄、固定杆和固定板,其中,固定杆前端通过转轴与固定板上表面中部连接,固定板下表面设有三条平行的磁棒,固定板两侧设有滚轮。使用:需要搜寻缝合针时,护理人员手持手柄,推动固定板前进,当固定板位于缝合针上方时,由于磁性的缘故,缝合针被吸附到磁棒上,如此在手术室内搜寻一遍,即可以保证所有遗落的缝合针被找回。固定板下表面设有三条磁棒,相比一条磁棒而言,避免了因滚轮滚动过快而使缝合针未被及时吸附的现象的发生。本实用新型结构简单,使用方便灵活,可以方便地将遗落的缝合针找回,省时省力,本实用新型具有结构简单、使用效果好等优点。

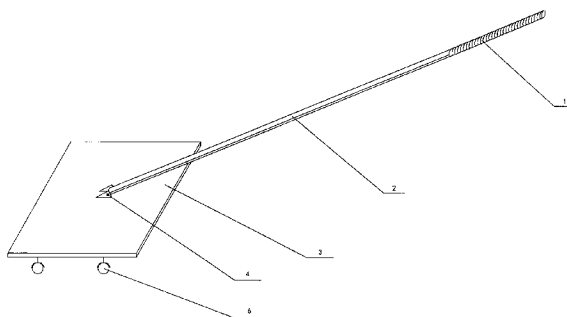

1. 一种手术室寻针器,其特征在于:包括手柄、固定杆和固定板,其中,固定杆前端通过转轴与固定板上表面中部连接,固定板下表面设有三条平行的磁棒,固定板两侧设有滚轮。

一种手术室寻针器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手术室寻针器。

背景技术

[0002] 手术过程中,由于多种原因,易造成缝合针的丢失,为确保缝合针未落入伤口内,护理人员需要用肉眼在手术室内各个角落进行搜寻,这样寻找费时费力,大大增加了护理人员的工作量,且不能保证将全部遗落的缝合针找回,加大了出现医疗纠纷的可能性。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术,本实用新型提供了一种手术室寻针器。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0005] 一种手术室寻针器,包括手柄、固定杆和固定板,其中,固定杆前端通过转轴与固定板上表面中部连接,固定板下表面设有三条平行的磁棒,固定板两侧设有滚轮。

[0006] 使用:需要搜寻缝合针时,护理人员手持手柄,推动固定板前进,当固定板位于缝合针上方时,由于磁性的缘故,缝合针被吸附到磁棒上,如此在手术室内搜寻一遍,即可以保证所有遗落的缝合针被找回。固定板下表面设有三条磁棒,相比一条磁棒而言,避免了因滚轮滚动过快而使缝合针未被及时吸附的现象的发生。

[0007] 本实用新型结构简单,使用方便灵活,可以方便地将遗落的缝合针找回,省时省力,本实用新型具有结构简单、使用效果好等优点。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图2为本实用新型的固定板下表面的结构示意图。

[0010] 其中,1、手柄;2、固定杆;3、固定板;4、转轴;5、磁棒;6、滚轮。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0012] 一种手术室寻针器,包括手柄1、固定杆2和固定板3,如图1所示,其中,固定杆2前端通过转轴4与固定板3上表面中部连接,固定板3下表面设有三条平行的磁棒6,如图2所示,固定板3两侧设有滚轮6。

[0013] 使用:需要搜寻缝合针时,护理人员手持手柄1,推动固定板3前进,当固定板3位于缝合针上方时,由于磁性的缘故,缝合针被吸附到磁棒5上,如此在手术室内搜寻一遍,即可以保证所有遗落的缝合针被找回。固定板下表面设有三条磁棒5,相比一条磁棒而言,避免了因滚轮6滚动过快而使缝合针未被及时吸附的现象的发生。本实用新型具有结构简单、使用效果好等优点。

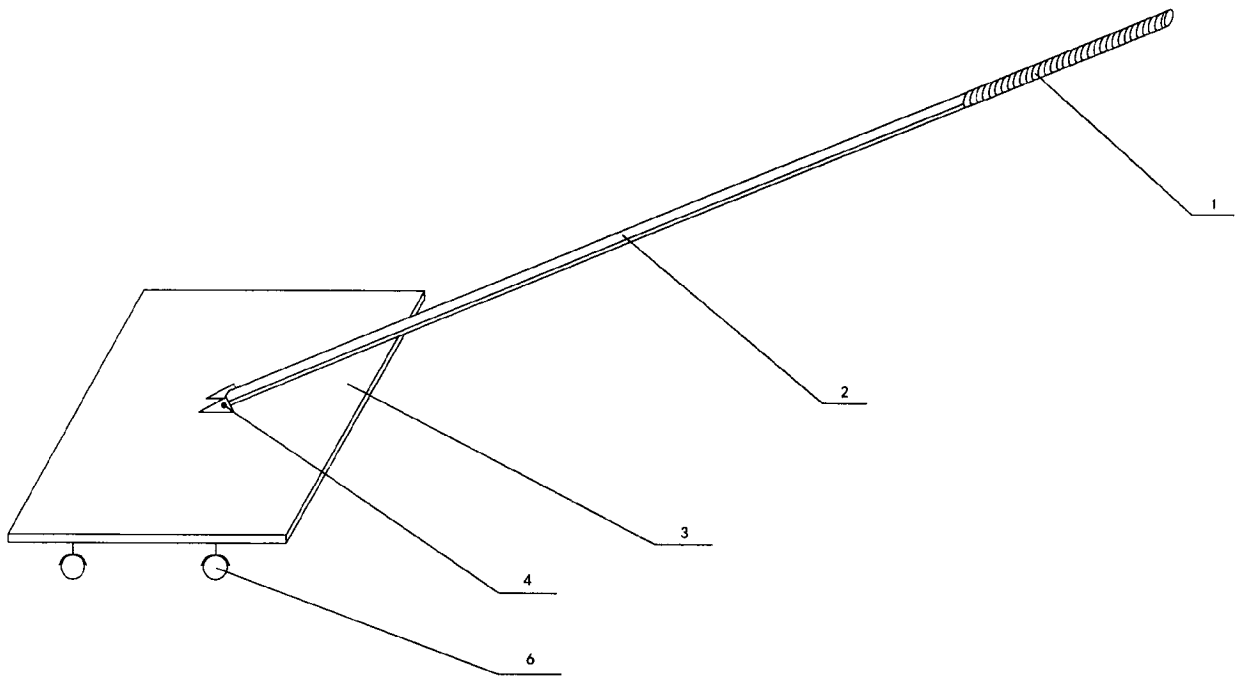


图 1

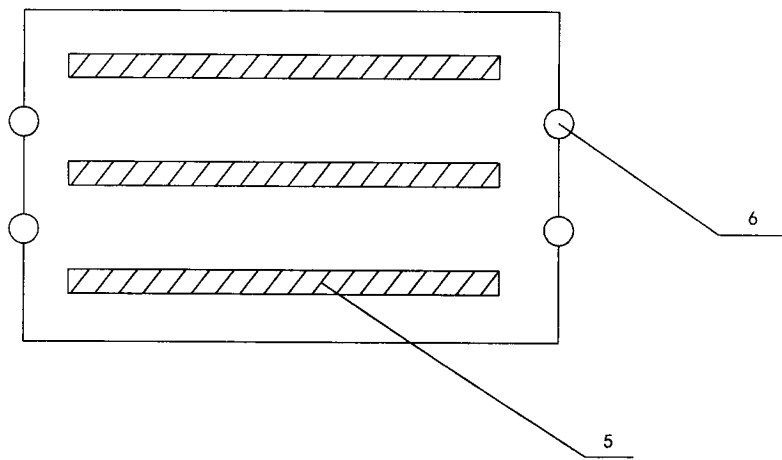


图 2