



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D213742 S

(45)公告日：中華民國 110 (2021) 年 09 月 01 日

(21)申請案號：109307148

(22)申請日：中華民國 109 (2020) 年 12 月 21 日

(51)LOC.(11)Cl.：10-05

(30)優先權：2020/06/24 日本

2020-012684

(71)申請人：日商榮研化學股份有限公司 (日本) EIKEN KAGAKU KABUSHIKI KAISHA (JP)
日本(72)設計人：宇井健人 UI, KENTO (JP)；芥雄二郎 AKUTA, YUJIRO (JP)；福山一輝
FUKUYAMA, KAZUKI (JP)；市川宗貴 ICHIKAWA, MUNETAKA (JP)；小谷一
介 KOTANI, KAZUSUKE (JP)

(74)代理人：陳長文

(56)參考文獻：

TW D198371

CN 302883456

JP D1651936

US D854703

US D869313

審查人員：謝孟峰

圖式數：16 共 18 頁


(54)名稱

糞便潛血檢查用測定機

代表圖：

D213742

TW D213742 S

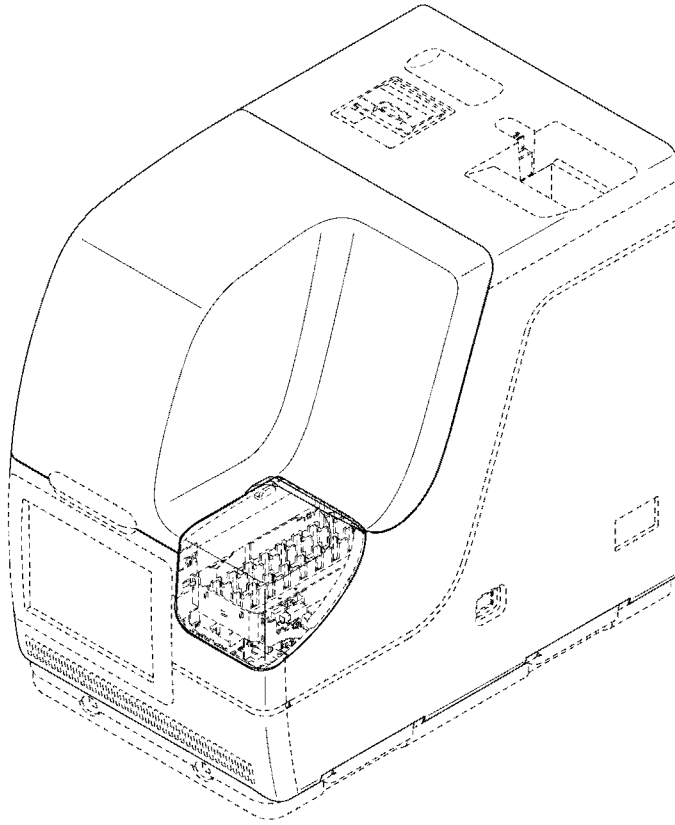

【立體圖1】



D213742

【設計說明書】

【中文設計名稱】

糞便潛血檢查用測定機

【英文設計名稱】

FECAL OCCULT BLOOD ANALYZER

【物品用途】

【0001】 本物品係一種用於大腸直腸癌篩檢之糞便潛血檢查用測定機。

【0002】 如「展示使用狀態之參考圖」中所展示，可沿由箭頭指示之方向打開大蓋及小蓋。即使在使用本物品期間，亦可藉由打開小蓋來將一樣品容器添加至樣品架。顯示器係用於操作之一觸控面板類型。

【設計說明】

【0003】 實線所描繪之部分，為本案主張設計之部分。虛線僅為了繪示性目的，其展示不主張設計之部分。點鏈線指示主張部分與不主張部分之間的邊界且不構成任何設計。各圖中物品之表面上所展示之細線指定三維表面之形狀。在「陰影參考立體圖1」及「陰影參考立體圖2」中，整個表面部分上所展示之陰影用於表示三維表面之形狀。在「展示各部分名稱之參考圖」中，一網格圖案中之部分係透明的，且影線部分係半透明的。在「展示各部分名稱之參考圖」中，深色部分指示尋求設計註冊作為一部分設計之部分，且由一虛線指示之分割線部分係除尋求設計註冊作為一部分設計之部分之外的部分。


【0004】 「不透明地展示小蓋部分之立體圖」與其他視圖不一致，因為未表示可透過透明小蓋看見之內部機構。

【0005】 「陰影參考立體圖1」及「陰影參考立體圖2」與其他視圖不一致。其等被加陰影。


【0006】 「展示各部分名稱之參考圖」及「展示使用狀態之參考圖」包含額外其他元素，諸如各部分名稱及參考線。「展示各部分名稱之參考圖」中使主張部分呈暗色。

【0007】 本設計係關於一種新穎且具創意之設計，其不僅可達成所需功能，且亦可提供先前技術中所未見且使觀察者耳目一新之一獨特外觀。


【設計圖式】
(指定代表圖)

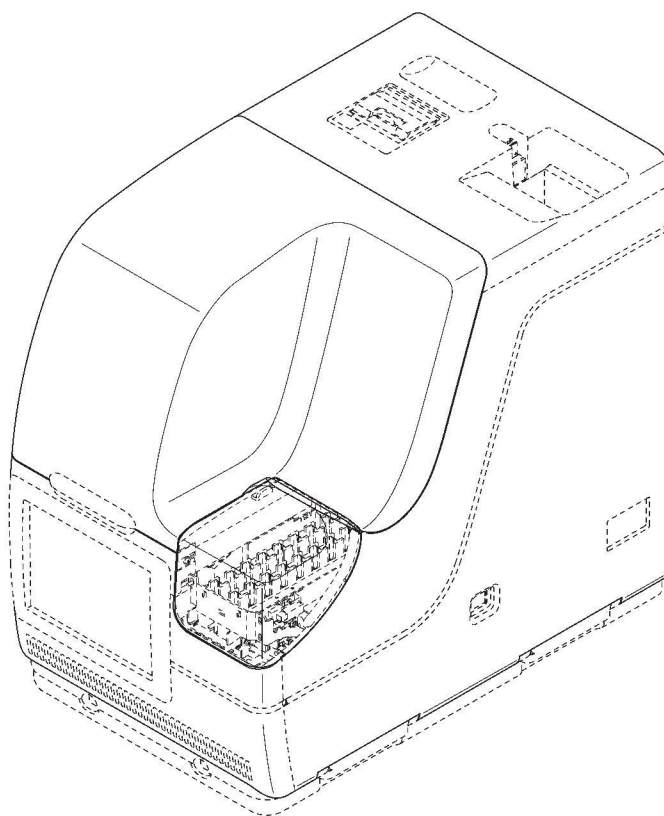


【立體圖1】

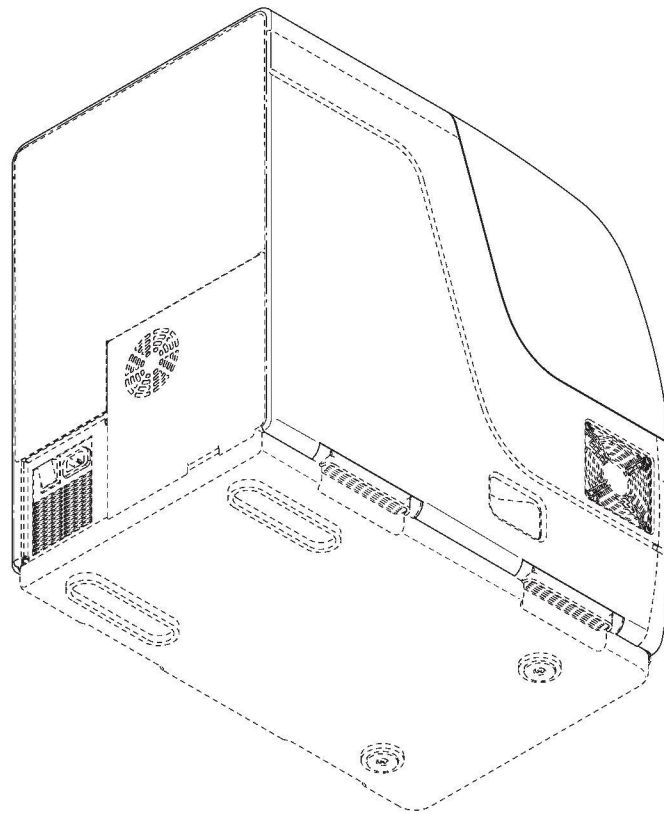


【立體圖2】

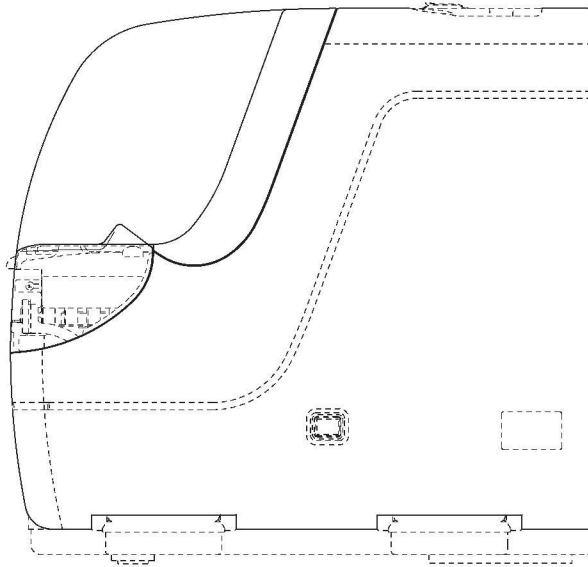


【前視圖】

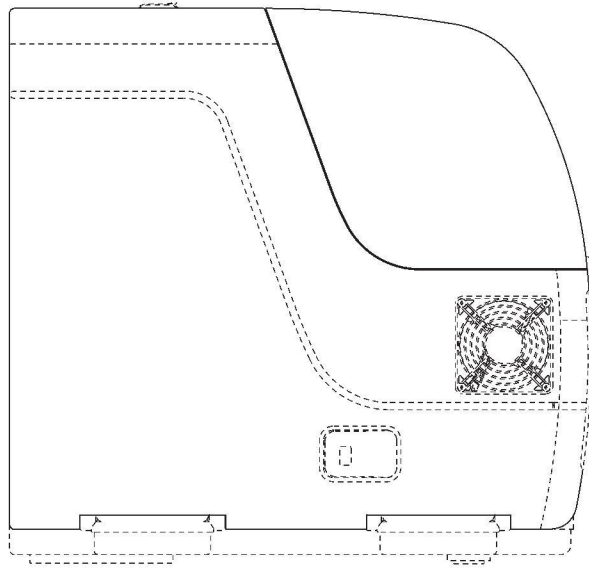


【後視圖】

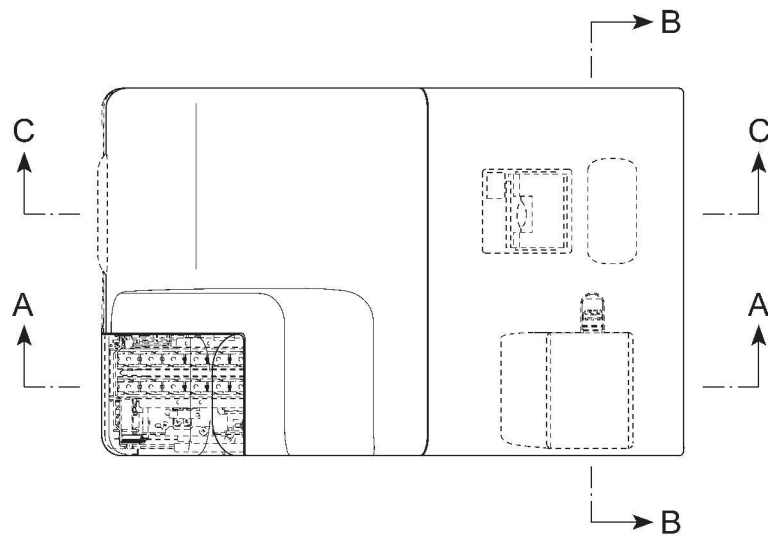


【俯視圖】

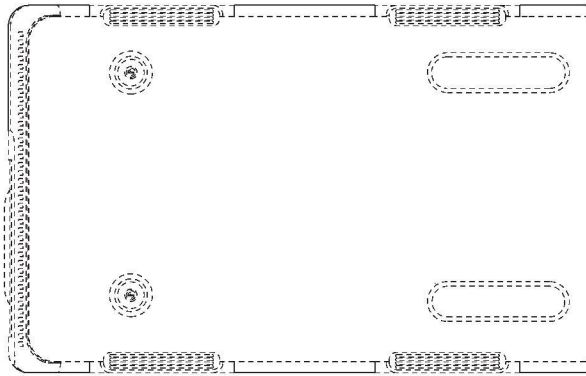


【仰視圖】

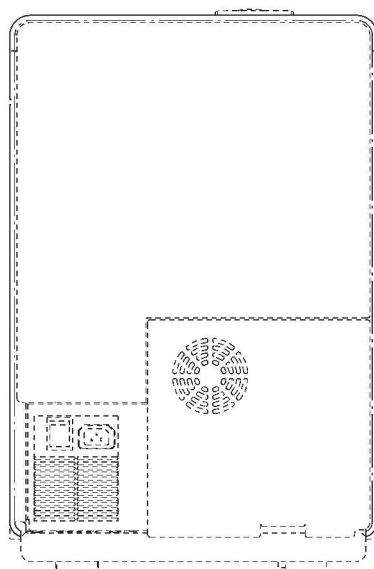


【右側視圖】

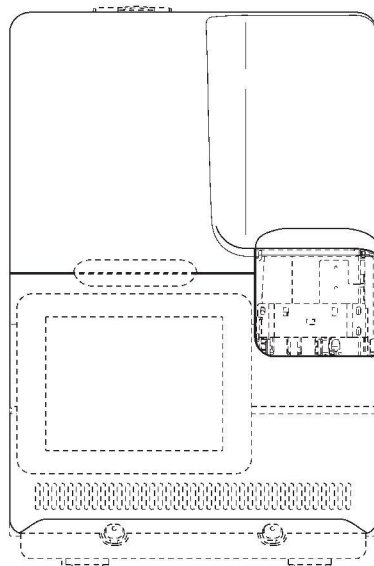


【左側視圖】

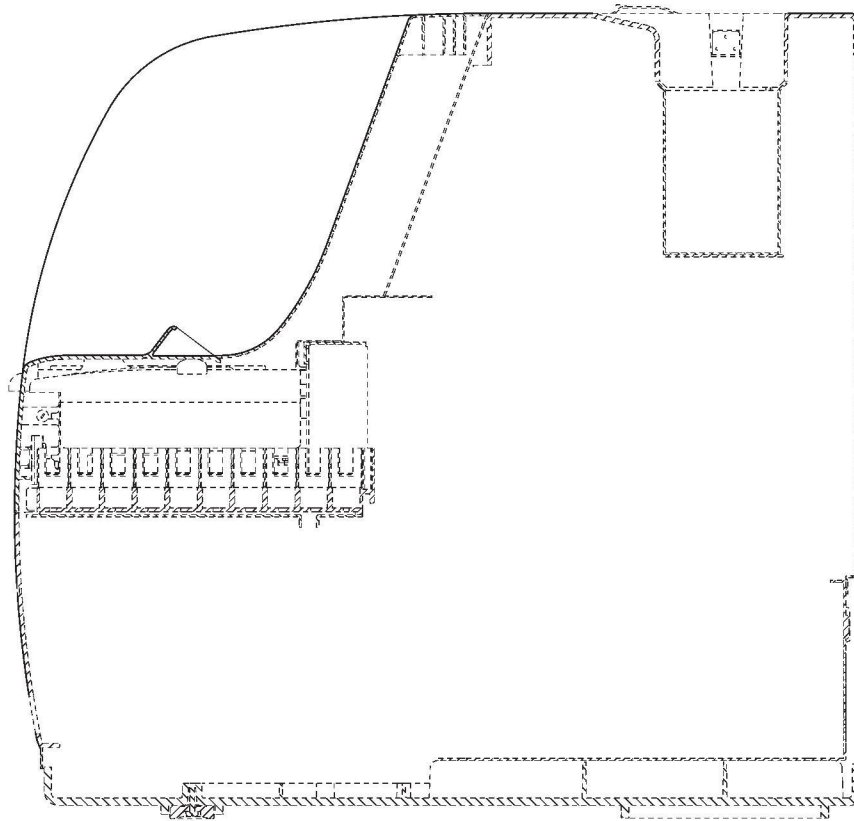


【其中省略內部機構之沿線A-A取得之放大截面圖】

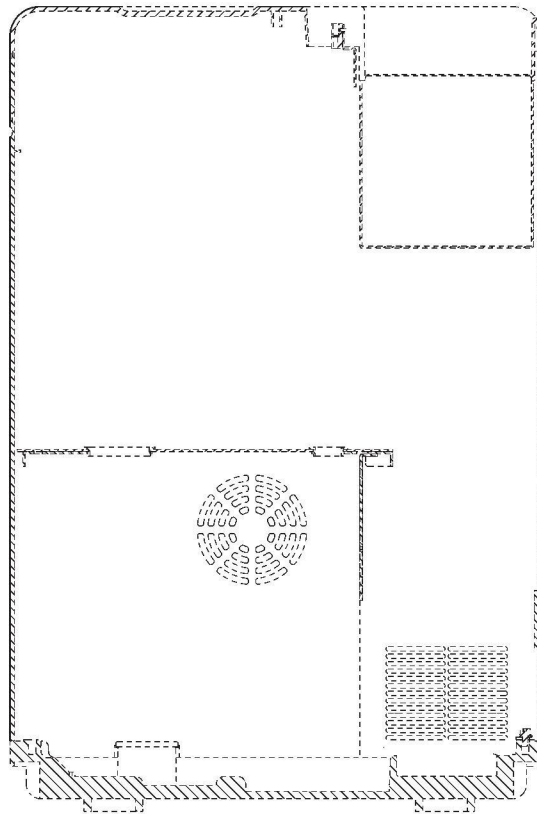


【其中省略內部機構之沿線B-B取得之放大截面圖】

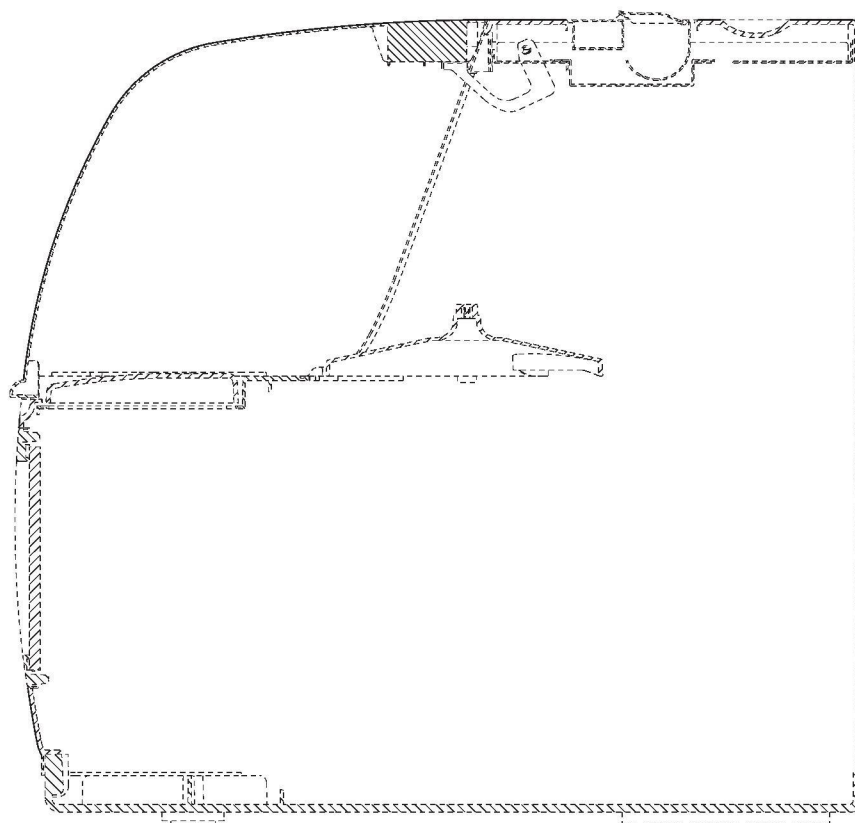


【其中省略內部機構之沿線C-C取得之放大截面圖】

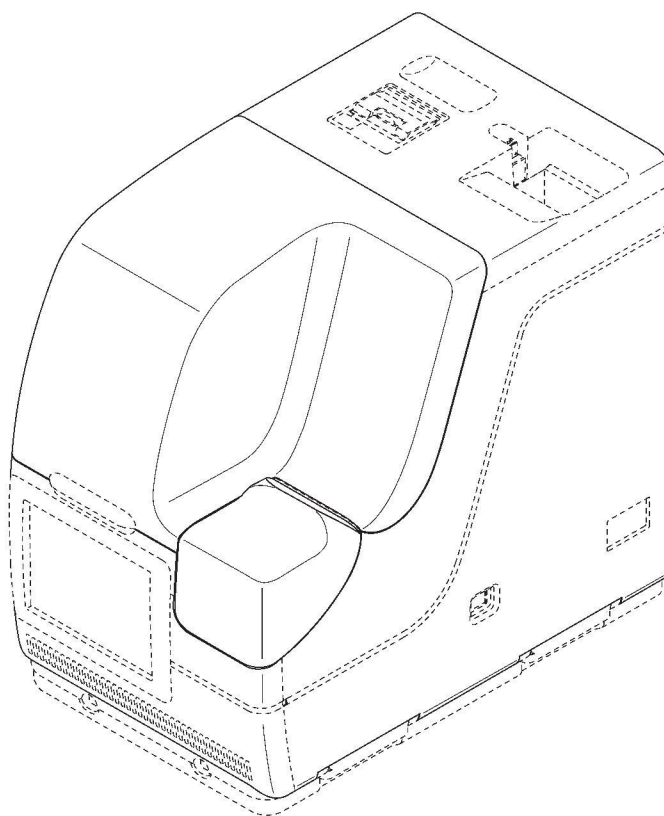


【不透明地展示小蓋部分之立體圖】

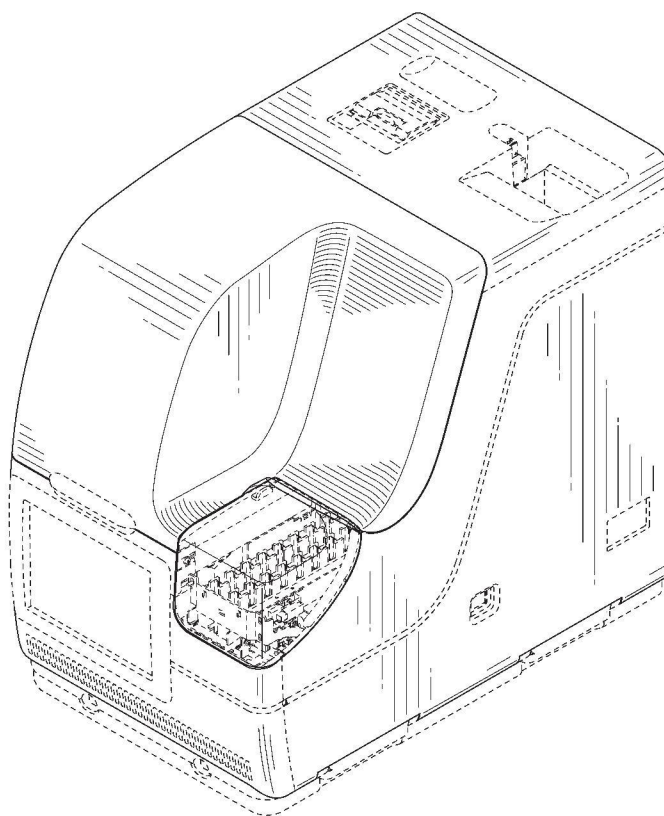


【陰影參考立體圖1】

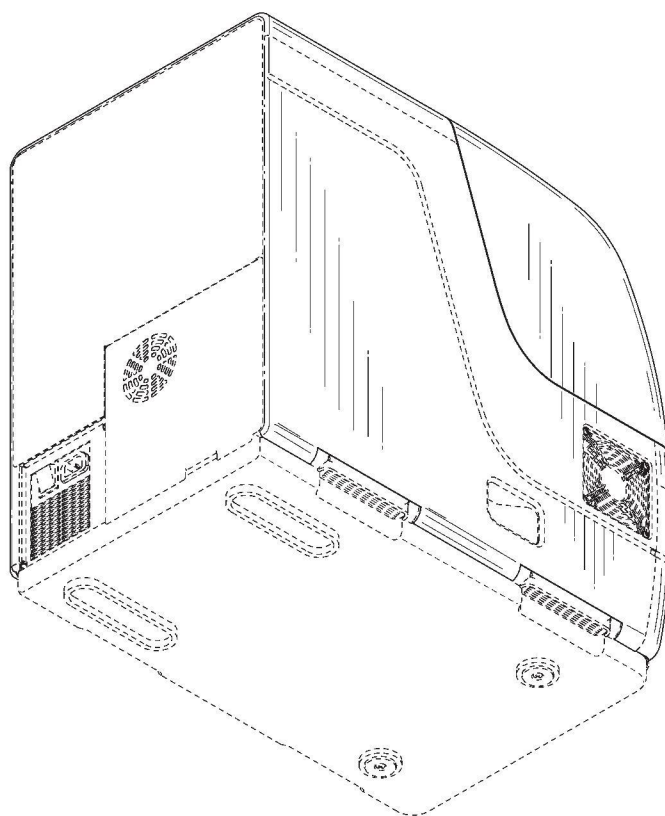

【陰影參考立體圖2】

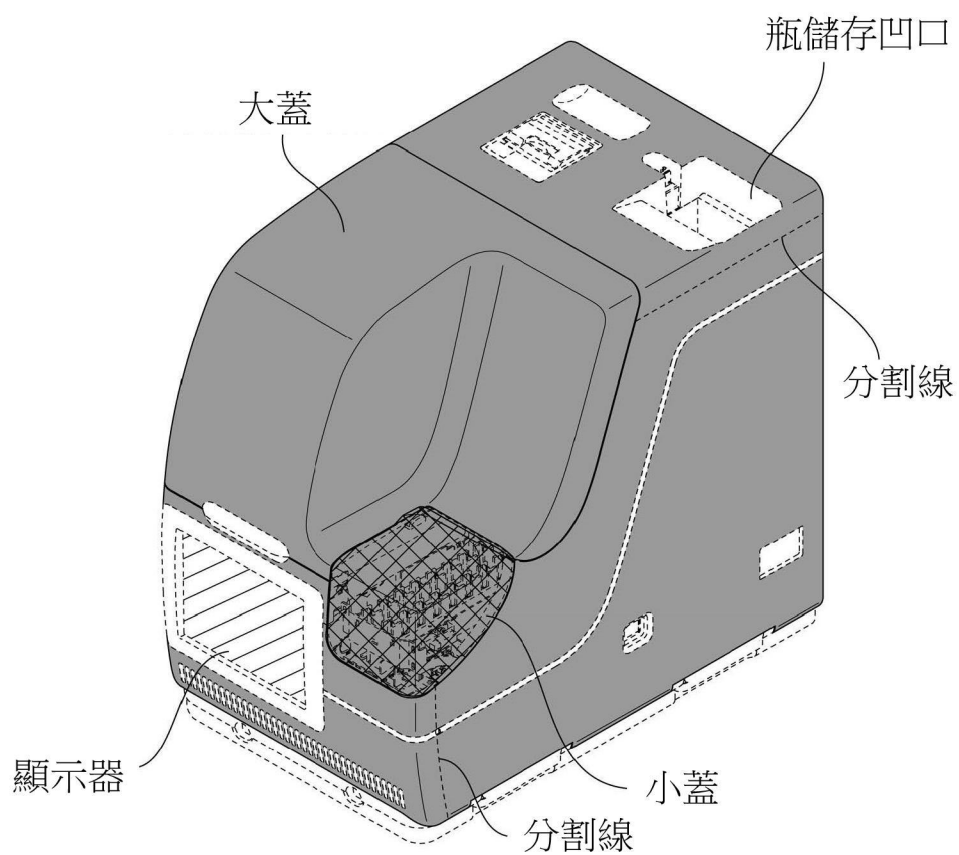

【展示各部分名稱之參考圖】

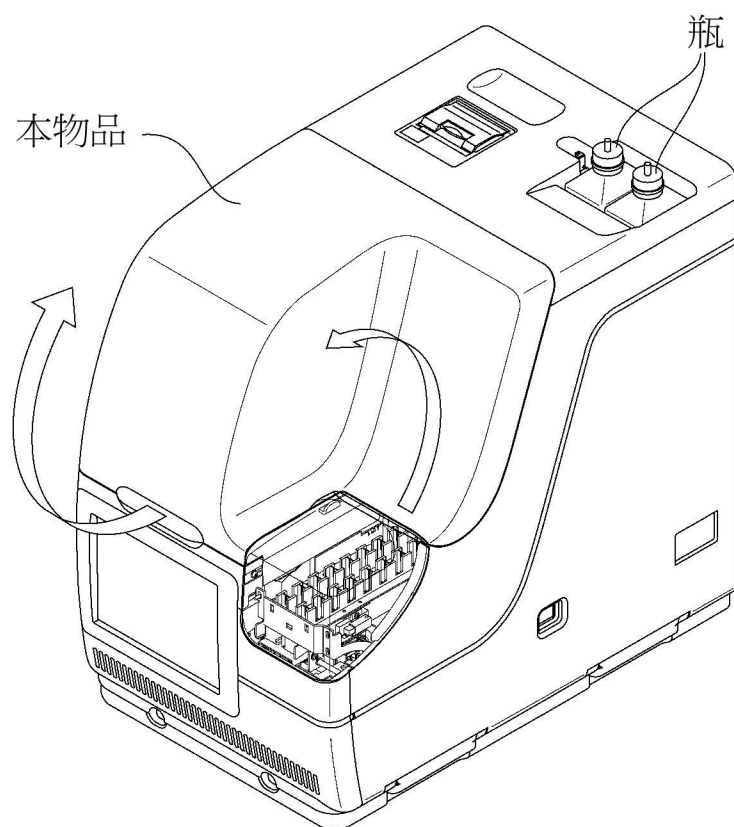

【展示使用狀態之參考圖】