

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第6898285号  
(P6898285)

(45) 発行日 令和3年7月7日(2021.7.7)

(24) 登録日 令和3年6月14日(2021.6.14)

(51) Int. Cl.		F I
<b>A 6 1 B 34/30</b>	<b>(2016.01)</b>	A 6 1 B 34/30
<b>A 6 1 B 34/35</b>	<b>(2016.01)</b>	A 6 1 B 34/35
<b>B 2 5 J 13/04</b>	<b>(2006.01)</b>	B 2 5 J 13/04

請求項の数 12 (全 26 頁)

(21) 出願番号	特願2018-179277 (P2018-179277)	(73) 特許権者	514063179 株式会社メディカロイド 兵庫県神戸市中央区港島南町一丁目6番5号
(22) 出願日	平成30年9月25日(2018.9.25)	(74) 代理人	100104433 弁理士 宮園 博一
(65) 公開番号	特開2020-48708 (P2020-48708A)	(72) 発明者	石原 一樹 兵庫県神戸市中央区港島南町一丁目6番5号 株式会社メディカロイド内
(43) 公開日	令和2年4月2日(2020.4.2)	(72) 発明者	鶴本 顕一郎 京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町4-1番地 ビーロックキタヤマ 株式会社ソフトデバイス内
審査請求日	令和2年2月5日(2020.2.5)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 手術システムおよび表示方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

手術部位の画像を撮像する内視鏡、第1手術器具および第2手術器具を各々支持するための複数のマニピュレータと、

前記内視鏡によって撮像された画像を表示するための表示装置と、前記第1手術器具を操作するための第1操作ハンドルと、前記第2手術器具を操作するための第2操作ハンドルと、複数のフットペダルを有する操作ペダル部と、を含む遠隔操作装置と、

少なくとも前記表示装置を制御するように構成された制御装置と、を備え、

前記操作ペダル部は、それぞれの前記フットペダル上の操作準備位置に操作者の足が配置されたことを検出するための複数のセンサを含み、

複数の前記フットペダルは、前記第1手術器具に関する機能を実行させるための第1フットペダルと、前記第2手術器具に関する機能を実行させるための第2フットペダルと、前記内視鏡に関する機能を実行させるための第3フットペダルと、を有しており、

前記制御装置は、前記第1手術器具に関する情報を示す第1エリアと、前記第2手術器具に関する情報を示す第2エリアと、前記内視鏡に関する情報を示す第3エリアと、を配置したグラフィカルユーザインタフェースを前記内視鏡によって撮像された画像上に重ねて前記表示装置に表示するように構成されており、

前記制御装置は、前記第1フットペダル、前記第2フットペダルおよび前記第3フットペダルのうちの少なくとも1つの前記フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置されたことを、前記複数のセンサのうちの少なくとも1つのセンサにより検出したことに基

づいて、前記第1エリア、前記第2エリアおよび前記第3エリアのうちの対応するエリアの一部の範囲を強調表示するとともに、前記第1エリア、前記第2エリアおよび前記第3エリアとは異なる位置に、操作準備位置に操作者の足が配置された前記フットペダルに関するペダル情報をポップアップ表示し、前記第1フットペダル、前記第2フットペダルまたは前記第3フットペダルが操作された場合に、前記第1エリア、前記第2エリアおよび前記第3エリアのうちの対応するエリアに、前記フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置された場合よりも大きい範囲を強調表示するように構成されている、手術システム。

【請求項2】

前記グラフィカルユーザインタフェースは、前記表示装置の下方の端部近傍領域または上方の端部近傍領域に配置される前記第1エリア、前記第2エリアおよび前記第3エリアを含む、請求項1に記載の手術システム。

10

【請求項3】

エリアの強調表示は、表示色の変更、反転表示、エリアの枠線の表示変更のうち少なくとも1つを含む、請求項1または2に記載の手術システム。

【請求項4】

前記第1エリアには、前記第1手術器具の種類が表示され、

前記第2エリアには、前記第2手術器具の種類が表示され、

前記第3エリアには、前記内視鏡を示す文字又は図柄の情報が表示される、請求項1～3のいずれか1項に記載の手術システム。

20

【請求項5】

前記第1フットペダルは、手術部位を凝固させる操作を行う第1凝固ペダルと、手術部位を切断する操作を行う第1切断ペダルと、を有し、

前記第2フットペダルは、手術部位を凝固させる操作を行う第2凝固ペダルと、手術部位を切断する操作を行う第2切断ペダルと、を有し、

前記第1凝固ペダルおよび前記第2凝固ペダルは、第1の色を有し、

前記第1切断ペダルおよび前記第2切断ペダルは、前記第1の色とは異なる第2の色を有し、

前記制御装置は、前記第1凝固ペダルまたは前記第2凝固ペダルの操作準備位置に操作者の足が配置されたことを、前記複数のセンサのうちの少なくとも1つのセンサにより検出したことに基づいて、前記第1エリアおよび前記第2エリアのうちの対応するエリアの一部の領域を前記第1の色により強調表示し、前記第1切断ペダルまたは前記第2切断ペダルの操作準備位置に操作者の足が配置されたことを、前記複数のセンサのうちの少なくとも1つのセンサにより検出したことに基づいて、前記第1エリアおよび前記第2エリアのうちの対応するエリアの一部の領域を前記第2の色により強調表示するように構成されている、請求項1～4のいずれか1項に記載の手術システム。

30

【請求項6】

前記第1凝固ペダルが操作された場合に、操作準備位置に操作者の足が配置された場合よりも前記第1エリアの大きい範囲が前記第1の色により強調表示され、

前記第1切断ペダルが操作された場合に、操作準備位置に操作者の足が配置された場合よりも前記第1エリアの大きい範囲が前記第2の色により強調表示され、

40

前記第2凝固ペダルが操作された場合に、操作準備位置に操作者の足が配置された場合よりも前記第2エリアの大きい範囲が前記第1の色により強調表示され、

前記第2切断ペダルが操作された場合に、操作準備位置に操作者の足が配置された場合よりも前記第2エリアの大きい範囲が前記第2の色により強調表示される、請求項5に記載の手術システム。

【請求項7】

前記制御装置は、前記第1フットペダル、前記第2フットペダルまたは前記第3フットペダルが操作された場合に、前記第1エリア、前記第2エリアおよび前記第3エリアのうちの対応するエリア全体を強調表示するように構成されている、請求項1～6のいずれか

50

1 項に記載の手術システム。

【請求項 8】

前記複数のマニピュレータのうちの 1 つのマニピュレータは、交換用手術器具を支持しており、

前記操作ペダル部は、前記第 1 操作ハンドルにより操作されている前記第 1 手術器具または前記第 2 操作ハンドルにより操作されている前記第 2 手術器具を前記交換用手術器具に変更するための第 4 フットペダルをさらに含み、

前記グラフィカルユーザインタフェースは、前記第 1 エリアと前記第 2 エリアとの間に配置された前記交換用手術器具に関する情報を示す第 4 エリアを含む、請求項 1 ~ 7 のいずれか 1 項に記載の手術システム。

10

【請求項 9】

前記操作ペダル部は、クラッチ機能を実行させるための第 5 フットペダルをさらに含み、

前記グラフィカルユーザインタフェースは、前記クラッチ機能に関する情報を示す第 5 エリアを含む、請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 項に記載の手術システム。

【請求項 10】

前記制御装置は、前記第 3 フットペダルが操作された場合に、前記内視鏡の水準器を示す表示を含む前記グラフィカルユーザインタフェースを前記画像に重ねて表示するように構成されている、請求項 1 ~ 9 のいずれか 1 項に記載の手術システム。

【請求項 11】

前記グラフィカルユーザインタフェースの各エリアは、各フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置された場合、各エリアの枠線が強調表示されるように構成されている、請求項 1 ~ 10 のいずれか 1 項に記載の手術システム。

20

【請求項 12】

手術システムにおける情報の表示方法であって、

前記手術システムは、内視鏡、第 1 手術器具および第 2 手術器具を各々支持するための複数のマニピュレータと、前記内視鏡によって撮像された画像を表示するための表示装置、前記第 1 手術器具を操作するための第 1 操作ハンドル、前記第 2 手術器具を操作するための第 2 操作ハンドルおよび複数のフットペダルを有する操作ペダル部を含む遠隔操作装置と、少なくとも前記表示装置を制御するように構成された制御装置と、を備え、

30

前記操作ペダル部は、それぞれの前記フットペダル上の操作準備位置に操作者の足が配置されたことを検出するための複数のセンサを含み、

複数の前記フットペダルは、前記第 1 手術器具に関する機能を実行させるための第 1 フットペダルと、前記第 2 手術器具に関する機能を実行させるための第 2 フットペダルと、前記内視鏡に関する機能を実行させるための第 3 フットペダルと、を有しており、

前記第 1 手術器具に関する情報を示す第 1 エリアと、前記第 2 手術器具に関する情報を示す第 2 エリアと、前記内視鏡に関する情報を示す第 3 エリアと、を配置したグラフィカルユーザインタフェースを前記内視鏡によって撮像された画像上に重ねて前記表示装置に表示する工程と、

前記第 1 フットペダル、前記第 2 フットペダルおよび前記第 3 フットペダルのうちの少なくとも 1 つの前記フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置されたことを、前記複数のセンサのうちの少なくとも 1 つのセンサにより検出したことに基づいて、前記第 1 エリア、前記第 2 エリアおよび前記第 3 エリアのうちの対応するエリアの一部の範囲を強調表示するとともに、前記第 1 エリア、前記第 2 エリアおよび前記第 3 エリアとは異なる位置に、操作準備位置に操作者の足が配置された前記フットペダルに関するペダル情報をポップアップ表示する操作準備表示工程と、

40

前記第 1 フットペダル、前記第 2 フットペダルまたは前記第 3 フットペダルが操作された場合に、前記第 1 エリア、前記第 2 エリアおよび前記第 3 エリアのうちの対応するエリアに、前記フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置された場合よりも大きい範囲を強調表示する ペダル操作表示工程と、を備える、表示方法。

50

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

この発明は、手術システムおよび表示方法に関し、特に、手術器具を操作するための遠隔操作装置を備えた手術システムおよび手術システムにおける表示方法に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

従来、手術器具を操作するための遠隔操作装置を備えた手術システムが知られている（たとえば、特許文献1参照）。

## 【0003】

上記特許文献1には、手術部位の画像を撮像する内視鏡および複数の手術器具を各々支持するための複数のマニピュレータと、内視鏡によって撮像された画像を表示するための表示装置と、手術器具を遠隔で操作するための操作ハンドルおよび手術器具に関する機能を実行させるための複数のフットペダルを含む遠隔操作装置と、を備える手術システムが開示されている。この特許文献1の手術システムは、表示装置の右の領域に右手用の操作ハンドルにより操作する手術器具の情報が表示され、表示装置の左の領域に左手用の操作ハンドルにより操作する手術器具の情報が表示され、表示装置の中央に複数のフットペダルの配置が表示されるように構成されている。

## 【先行技術文献】

## 【特許文献】

## 【0004】

【特許文献1】米国特許第8418073号明細書

## 【発明の概要】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0005】

しかしながら、特許文献1の手術システムでは、表示装置のフットペダルの配置の表示により操作者がフットペダルの配置を確認することができるものの、操作者が実際にどのフットペダルに足を位置させているのかを確認することができないという問題点がある。

## 【0006】

この発明は、表示装置から目を離すことなく操作するフットペダルを確認することが可能な手術システムを提供するものである。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0007】

この発明の第1の局面による手術システムは、手術部位の画像を撮像する内視鏡、第1手術器具および第2手術器具を各々支持するための複数のマニピュレータと、内視鏡によって撮像された画像を表示するための表示装置と、第1手術器具を操作するための第1操作ハンドルと、第2手術器具を操作するための第2操作ハンドルと、複数のフットペダルを有する操作ペダル部と、を含む遠隔操作装置と、少なくとも表示装置を制御するように構成された制御装置と、を備え、操作ペダル部は、それぞれのフットペダル上の操作準備位置に操作者の足が配置されたことを検出するための複数のセンサを含み、複数のフットペダルは、第1手術器具に関する機能を実行させるための第1フットペダルと、第2手術器具に関する機能を実行させるための第2フットペダルと、内視鏡に関する機能を実行させるための第3フットペダルと、を有しており、制御装置は、第1手術器具に関する情報を示す第1エリアと、第2手術器具に関する情報を示す第2エリアと、内視鏡に関する情報を示す第3エリアと、を配置したグラフィカルユーザインタフェースを内視鏡によって撮像された画像上に重ねて表示装置に表示するように構成されており、制御装置は、第1フットペダル、第2フットペダルおよび第3フットペダルのうちの少なくとも1つのフットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置されたことを、複数のセンサのうちの少なくとも1つのセンサにより検出したことに基づいて、第1エリア、第2エリアおよび第3エリアのうちの対応するエリアの一部の範囲を強調表示するとともに、第1エリア、第2エ

10

20

30

40

50

リアおよび第3エリアとは異なる位置に、操作準備位置に操作者の足が配置されたフットペダルに関するペダル情報をポップアップ表示し、第1フットペダル、第2フットペダルまたは第3フットペダルが操作された場合に、第1エリア、第2エリアおよび第3エリアのうちの対応するエリアに、フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置された場合よりも大きい範囲を強調表示するように構成されている。

【0008】

この発明の第1の局面による手術システムでは、上記のように構成することによって、フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置された場合に、フットペダルに対応するグラフィカルユーザインタフェースのエリアの表示形態が変更されて表示装置に表示されるので、操作者が実際にどのフットペダルに足を位置させているのかを目視で確認する必要がない。その結果、操作者が表示装置から目を離すことなく操作するフットペダルを確認することができる。

この発明の第2の局面による表示方法は、手術システムにおける情報の表示方法であって、手術システムは、内視鏡、第1手術器具および第2手術器具を各々支持するための複数のマニピュレータと、内視鏡によって撮像された画像を表示するための表示装置、第1手術器具を操作するための第1操作ハンドル、第2手術器具を操作するための第2操作ハンドルおよび複数のフットペダルを有する操作ペダル部を含む遠隔操作装置と、少なくとも表示装置を制御するように構成された制御装置と、を備え、操作ペダル部は、それぞれのフットペダル上の操作準備位置に操作者の足が配置されたことを検出するための複数のセンサを含み、複数のフットペダルは、第1手術器具に関する機能を実行させるための第1フットペダルと、第2手術器具に関する機能を実行させるための第2フットペダルと、内視鏡に関する機能を実行させるための第3フットペダルと、を有しており、第1手術器具に関する情報を示す第1エリアと、第2手術器具に関する情報を示す第2エリアと、内視鏡に関する情報を示す第3エリアと、を配置したグラフィカルユーザインタフェースを内視鏡によって撮像された画像上に重ねて表示装置に表示する工程と、第1フットペダル、第2フットペダルおよび第3フットペダルのうちの少なくとも1つのフットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置されたことを、複数のセンサのうちの少なくとも1つのセンサにより検出したことに基づいて、第1エリア、第2エリアおよび第3エリアのうちの対応するエリアの一部の範囲を強調表示するとともに、第1エリア、第2エリアおよび第3エリアとは異なる位置に、操作準備位置に操作者の足が配置されたフットペダルに関するペダル情報をポップアップ表示する操作準備表示工程と、第1フットペダル、第2フットペダルまたは第3フットペダルが操作された場合に、第1エリア、第2エリアおよび第3エリアのうちの対応するエリアに、フットペダルの操作準備位置に操作者の足が配置された場合よりも大きい範囲を強調表示するペダル操作表示工程と、を備える。

【発明の効果】

【0009】

本発明によれば、表示装置から目を離すことなく操作するフットペダルを確認することが可能な手術システムを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0010】

【図1】一実施形態による手術システムの概略を示した図である。

【図2】一実施形態による手術システムの制御的な構成を示したブロック図である。

【図3】一実施形態による遠隔操作装置の操作ペダル部を示した斜視図である。

【図4】一実施形態による遠隔操作装置の操作ペダル部を示した平面図である。

【図5】一実施形態による遠隔操作装置の操作ペダル部を示した正面図である。

【図6】一実施形態による遠隔操作装置の操作ペダル部の割り当ての例を説明するための図である。

【図7】一実施形態による表示装置に表示された通常画面の例を示した図である。

【図8】一実施形態による切替ペダルが操作された場合の表示装置の画面の例を示した図である。

10

20

30

40

50

【図 9】一実施形態によるクラッチペダルの操作準備位置に足がある場合の表示装置の画面の例を示した図である。

【図 10】一実施形態によるクラッチペダルが操作された場合の表示装置の画面の例を示した図である。

【図 11】一実施形態によるクラッチスイッチ（右）が操作された場合の表示装置の画面の例を示した図である。

【図 12】一実施形態によるクラッチスイッチ（左）が操作された場合の表示装置の画面の例を示した図である。

【図 13】一実施形態によるカメラペダルの操作準備位置に足がある場合の表示装置の画面の例を示した図である。

【図 14】一実施形態によるカメラペダルが操作された場合の表示装置の画面の例を示した図である。

【図 15】一実施形態による切断ペダル（右）の操作準備位置に足がある場合の表示装置の画面の例を示した図である。

【図 16】一実施形態による切断ペダル（右）が操作された場合の表示装置の画面の例を示した図である。

【図 17】一実施形態による凝固ペダル（右）の操作準備位置に足がある場合の表示装置の画面の例を示した図である。

【図 18】一実施形態による凝固ペダル（右）が操作された場合の表示装置の画面の例を示した図である。

【図 19】一実施形態による切断ペダル（左）およびクラッチペダルの操作準備位置に足がある場合の表示装置の画面の例を示した図である。

【図 20】一実施形態による機能制限通知が表示された表示装置の画面の例を示した図である。

【図 21】一実施形態によるエラー通知が表示された表示装置の画面の例を示した図である。

【発明を実施するための形態】

【0011】

以下、実施形態を図面に基づいて説明する。

【0012】

（手術システムの構成）

図 1 ~ 図 21 を参照して、一実施形態による手術システム 400 の構成について説明する。

【0013】

図 1 に示すように、手術システム 400 は、遠隔操作装置 100 と、患者側装置 200 とを備えている。遠隔操作装置 100 は、患者側装置 200 に設けられた医療器具 (medical equipment) を遠隔操作するために設けられている。患者側装置 200 によって実行されるべき動作態様指令が術者 (surgeon) である操作者 O により遠隔操作装置 100 に入力されると、遠隔操作装置 100 は、動作態様指令をコントローラ 206 を介して患者側装置 200 に送信する。そして、患者側装置 200 は、遠隔操作装置 100 から送信された動作態様指令に応答して、マニピュレータ 201 に取り付けられた手術器具 (surgical instrument) 201a ~ 201c、内視鏡 201d 等の医療器具を操作する。これにより、低侵襲手術が行われる。

【0014】

患者側装置 200 は、患者 P に対して手術を行うインターフェースを構成する。患者側装置 200 は、患者 P が横たわる手術台 300 の傍らに配置される。患者側装置 200 は、複数のマニピュレータ 201 を有し、このうち 1 つのマニピュレータ 201 が内視鏡 201d を支持し、その他のマニピュレータ 201 が手術器具 201a ~ 201c を把持する。各マニピュレータ 201 は、プラットフォーム 203 に共通に支持されている。複数のマニピュレータ 201 は複数の関節を有し、それぞれの関節には、サーボモータを含む駆

10

20

30

40

50

動部と、エンコーダ等の位置検出器とが設けられている。マニピュレータ201は、コントローラ206を介して与えられた駆動信号によりマニピュレータ201に取り付けられた医療器具が所望の動作を行うように制御されるように構成されている。

【0015】

プラットフォーム203は、手術室の床の上に載置されたポジショナ202に支持されている。ポジショナ202は、鉛直方向に調整可能な昇降軸を有する柱部204が、車輪を備え床面を移動可能なベース205に連結されている。

【0016】

4つのマニピュレータ201のうち3つのマニピュレータ201の各々には、先端部に医療器具としての手術器具201a~201cが着脱可能に取り付けられる。手術器具201a~201cは、それぞれ、マニピュレータ201に取り付けられるハウジングと、細長形状のシャフトと、シャフトの先端部に設けられたエンドエフェクタとを備えている。エンドエフェクタとして、例えば、把持鉗子、シザーズ、フック、高周波ナイフ、スネアワイヤ、クランプ、ステイプラーが挙げられるがこれに限られるものではなく、各種の処置具を適用することができる。患者側装置200を用いた手術において、マニピュレータ201は、患者Pの体表に留置したカニューラ（トロカー）を介して患者Pの体内に手術器具201a~201cを導入する。そして、手術器具201a~201cのエンドエフェクタが手術部位の近傍に配置される。なお、手術器具201a、手術器具201bおよび手術器具201cは、それぞれ、特許請求の範囲の「第1手術器具」、「第2手術器具」および「交換用手術器具」の一例である。

10

20

【0017】

4つのマニピュレータ201のうち1つのマニピュレータ201には、先端部に医療器具としての内視鏡201dが着脱可能に取り付けられる。内視鏡201dは、患者Pの体腔内を撮影するものであり、撮影した画像は、遠隔操作装置100に対して出力される。内視鏡201dとして、3次元画像を撮影することができる3D内視鏡若しくは2D内視鏡が用いられる。患者側装置200を用いた手術において、マニピュレータ201は、患者Pに体表に留置したトロカーを介して患者Pの体内に内視鏡201dを導入する。そして、内視鏡201dが手術部位の近傍に配置される。

【0018】

遠隔操作装置100は、操作者Oとのインターフェースを構成する。遠隔操作装置100は、マニピュレータ201が把持する医療器具を操作者Oが操作するための装置である。すなわち、遠隔操作装置100は、操作者Oによって入力された手術器具201a~201cおよび内視鏡201dによって実行されるべき動作態様指令をコントローラ206を介して患者側装置200へ送信可能に構成されている。遠隔操作装置100は、たとえば、マスタの操作をしながらも患者Pの様子がよく見えるように手術台300の傍らに設置される。なお、遠隔操作装置100は、例えば動作態様指令を無線で送信するようにし、手術台300が設置された手術室とは別室に設置することも可能である。

30

【0019】

手術器具201a~201cによって実行されるべき動作態様とは、手術器具201a~201cの動作（一連の位置および姿勢）および手術器具201a~201c個別の機能によって実現される動作の態様である。たとえば、手術器具201a~201cが把持鉗子である場合には、手術器具201a~201cによって実行されるべき動作態様とは、エンドエフェクタの手首のロール回転位置及びピッチ回転位置と、ジョーの開閉を行う動作である。また、手術器具201a~201cが高周波ナイフである場合には、手術器具201a~201cによって実行されるべき動作態様とは、高周波ナイフの振動動作、具体的には高周波ナイフに対する電流の供給であり得る。また、手術器具201a~201cがスネアワイヤである場合には、手術器具201a~201cによって実行されるべき動作態様とは、束縛動作および束縛状態の解放動作であり得る。また、バイポーラやモノポーラに電流を供給することによって手術対象部位を焼き切る動作であり得る。

40

【0020】

50

内視鏡 201d によって実行されるべき動作態様とは、たとえば、内視鏡 201d 先端の位置および姿勢の設定、ズーム倍率の設定である。

【0021】

遠隔操作装置 100 は、図 1 および図 2 に示すように、操作ハンドル 1 と、操作ペダル部 2 と、表示装置 3 と、表示装置 3 を支持する表示部支持アーム 4 と、操作者 O の腕を支えるアームレスト 5 と、制御装置 6 と、を備えている。

【0022】

操作ハンドル 1 は、マニピュレータ 201 が把持する医療器具を遠隔で操作するために設けられている。具体的には、操作ハンドル 1 は、医療器具（手術器具 201a ~ 201c、内視鏡 201d）を操作するための操作者 O による操作を受け付ける。操作ハンドル 1 は、X 方向に沿って一対設けられている。操作ハンドル 1 は、右側（X2 方向側）に配置され、操作者 O の右手により操作される操作ハンドル 1a と、左側（X1 方向側）に配置され、操作者 O の左手により操作される操作ハンドル 1b と、を含んでいる。なお、操作ハンドル 1a および操作ハンドル 1b は、それぞれ、特許請求の範囲の「第 1 操作ハンドル」および「第 2 操作ハンドル」の一例である。

10

【0023】

また、操作ハンドル 1 は、遠隔操作装置 100 の後方（Y2 方向）側から、前方（Y1 方向）側に向かって伸びるように配置されている。操作ハンドル 1 は、所定の 3 次元の操作領域内で動かすことができるように構成されている。すなわち、操作ハンドル 1 は、上下方向（Z 方向）、左右方向（X 方向）、および前後方向（Y 方向）に動かすことができるように構成されている。

20

【0024】

右手用の操作ハンドル 1a は、対応付られた手術器具 201a を遠隔で操作するために設けられている。左手用の操作ハンドル 1b は、対応付られた手術器具 201b を遠隔で操作するために設けられている。操作ハンドル 1a および 1b には、図 2 に示すように、それぞれ、クラッチスイッチ 11 が設けられている。クラッチスイッチ 11 は、マニピュレータ 201 と、操作ハンドル 1a および 1b との操作接続を一時切断する場合に操作される。操作ハンドル 1a のクラッチスイッチ 11 が操作されると、操作ハンドル 1a と、手術器具 201a が設けられたマニピュレータ 201 との操作接続が一時切断される。また、操作ハンドル 1b のクラッチスイッチ 11 が操作されると、操作ハンドル 1b と、手術器具 201b が設けられたマニピュレータ 201 との操作接続が一時切断される。

30

【0025】

遠隔操作装置 100 と患者側装置 200 とは、複数のマニピュレータ 201 の動作の制御においては、マスタスレーブ型のシステムを構成する。すなわち、操作ハンドル 1 は、マスタスレーブ型のシステムにおけるマスタ側の操作部を構成し、医療器具を支持するマニピュレータ 201 はスレーブ側の動作部を構成する。そして、操作ハンドル 1 を操作者 O が操作すると、操作ハンドル 1 の動きをマニピュレータ 201 の先端部（手術器具 201a ~ 201c のエンドエフェクタまたは内視鏡 201d）がトレースして移動するようにマニピュレータ 201 の動作が制御される。

【0026】

40

また、患者側装置 200 は、設定された動作倍率に応じてマニピュレータ 201 の動作を制御するよう構成されている。たとえば、動作倍率が 1/2 倍に設定されている場合、手術器具 201a ~ 201c のエンドエフェクタは、操作ハンドル 1 の移動距離の 1/2 の移動距離を移動するよう制御される。これによって、精細な手術を精確に行うことができる。

【0027】

操作ペダル部 2 は、図 3 ~ 図 5 に示すように、医療器具に関する機能を実行するための複数のフットペダル 20 を含んでいる。また、複数のフットペダル 20 は、基台部 2a に配置されている。フットペダル 20 は、凝固ペダル 21 と、切断ペダル 22 と、クラッチペダル 23 と、カメラペダル 24 と、を含んでいる。また、操作ペダル部 2 には、切替ペ

50

ダル 25 が設けられている。凝固ペダル 21 と、切断ペダル 22 と、クラッチペダル 23 と、カメラペダル 24 とは、下方向に押すことにより操作される。切替ペダル 25 は、水平方向に押すことにより操作される。フットペダル 20 は、操作者 O の足により操作される。

【0028】

また、操作ペダル部 2 は、フットペダル 20 を操作する足の存在を検知するための複数のセンサ 26 を含んでいる。センサ 26 は、センサ 26 a、26 b、26 c、26 d、26 e、26 f、26 g を含んでいる。また、複数のセンサ 26 の各々は、発光部 261 と、受光部 262 とを備えている。センサ 26 は、発光部 261 からの光が足により遮断されて、受光部 262 による受光が中断することにより、足の存在を検知する。つまり、センサ 26 は、遮断型のセンサである。センサ 26 は、フットペダル 20 上に操作者 O の足が配置されたことを検出するために設けられている。つまり、センサ 26 は、フットペダル 20 の操作準備位置に操作者 O の足が配置されたことを検出する。

10

【0029】

センサ 26 によって検知された検知情報は、制御部 61 に送信され、当該検知情報を受領した制御部 61 は、対応するフットペダル 20 を操作する足の存在の有無を判定する。

【0030】

凝固ペダル 21 は、手術器具を用いて手術部位を凝固させる操作を行うことができる。具体的には、凝固ペダル 21 は、操作されることにより、対応する手術器具 201 a、201 b または 201 c に凝固用の電圧が印加されて、手術部位の凝固が行われる。凝固ペダル 21 は、凝固ペダル 21 a と凝固ペダル 21 b とを含んでいる。凝固ペダル 21 a は、凝固ペダル 21 b よりも左側 (X1 方向側) に配置されている。凝固ペダル 21 a は、左手用の操作ハンドル 1 b により操作される手術器具 201 b に関連付けて用いられる。また、凝固ペダル 21 b は、右手用の操作ハンドル 1 a により操作される手術器具 201 a に関連付けて用いられる。凝固ペダル 21 a および 21 b は、第 1 の色を有している。たとえば、凝固ペダル 21 a および 21 b は、第 1 の色として青色を有している。

20

【0031】

切断ペダル 22 は、手術器具を用いて手術部位を切断させる操作を行うことができる。具体的には、切断ペダル 22 は、操作されることにより、対応する手術器具 201 a、201 b または 201 c に切断用の電圧が印加されて、手術部位の切断が行われる。切断ペダル 22 は、切断ペダル 22 a と切断ペダル 22 b とを含んでいる。切断ペダル 22 a は、切断ペダル 22 b よりも左側 (X1 方向側) に配置されている。切断ペダル 22 a は、左手用の操作ハンドル 1 b により操作される手術器具 201 b に関連付けて用いられる。また、切断ペダル 22 b は、右手用の操作ハンドル 1 a により操作される手術器具 201 a に関連付けて用いられる。切断ペダル 22 a および 22 b は、第 1 の色とは異なる第 2 の色を有している。たとえば、切断ペダル 22 a および 22 b は、第 2 の色として黄色を有している。

30

【0032】

つまり、右側用フットペダル (凝固ペダル 21 b および切断ペダル 22 b) は、右手用の操作ハンドル 1 a により操作される手術器具 201 a に関する機能を実行させる。左側用フットペダル (凝固ペダル 21 a および切断ペダル 22 a) は、左手用の操作ハンドル 1 b により操作される手術器具 201 b に関する機能を実行させる。なお、凝固ペダル 21 b は、特許請求の範囲の「第 1 フットペダル」および「第 1 凝固ペダル」の一例であり、切断ペダル 22 b は、特許請求の範囲の「第 1 フットペダル」および「第 1 切断ペダル」の一例である。また、凝固ペダル 21 a は、特許請求の範囲の「第 2 フットペダル」および「第 2 凝固ペダル」の一例であり、切断ペダル 22 a は、特許請求の範囲の「第 2 フットペダル」および「第 2 切断ペダル」の一例である。

40

【0033】

クラッチペダル 23 は、クラッチ機能を実行させるために操作される。具体的には、クラッチペダル 23 は、マニピュレータ 201 と、操作ハンドル 1 a および 1 b との操作接

50

続を一時切断して手術器具の動作を停止させる場合に用いられる。クラッチペダル 2 3 が操作されている間は、操作ハンドル 1 a および 1 b を操作しても、患者側装置 2 0 0 のマニピュレータ 2 0 1 が動作しない。たとえば、操作により操作ハンドル 1 が移動可能な範囲の端部近傍に来た場合に、クラッチペダル 2 3 が操作されることにより、操作接続を一時切断して、操作ハンドル 1 を中央位置付近に戻すことができる。そして、クラッチペダル 2 3 の操作を中止するとマニピュレータ 2 0 1 と操作ハンドル 1 とが再び接続され、中央付近で操作ハンドル 1 の操作を再開することができる。ここで、クラッチペダル 2 3 は、両方の操作ハンドル 1 a および 1 b とマニピュレータ 2 0 1 との操作接続を一括して一時切断するために操作される。一方、操作ハンドル 1 a および 1 b に設けられたクラッチスイッチ 1 1 は、各操作ハンドル 1 a または 1 b と対応するマニピュレータ 2 0 1 との操作接続を個別に一時切断するために操作される。なお、クラッチペダル 2 3 は、特許請求の範囲の「第 5 フットペダル」の一例である。

10

#### 【 0 0 3 4 】

カメラペダル 2 4 は、体腔内を撮像する内視鏡 2 0 1 d の位置および姿勢を操作するために用いられる。つまり、カメラペダル 2 4 は、内視鏡 2 0 1 d に関する機能を実行させる。具体的には、カメラペダル 2 4 は、内視鏡 2 0 1 d の操作ハンドル 1 による操作を有効にする。つまり、カメラペダル 2 4 が押されている間は、操作ハンドル 1 により内視鏡 2 0 1 d の位置および姿勢を操作することが可能である。たとえば、内視鏡 2 0 1 d は、左右の操作ハンドル 1 の両方を用いることにより操作される。具体的には、左右の操作ハンドル 1 の中間点を中心に左右の操作ハンドル 1 を回動させることにより、内視鏡 2 0 1 d が回動される。また、左右の操作ハンドル 1 を共に押し込むことにより、内視鏡 2 0 1 d が奥に進む。また、左右の操作ハンドル 1 を共に引っ張ることにより、内視鏡 2 0 1 d が手前に戻る。また、左右の操作ハンドル 1 を共に上下左右に移動させることにより、内視鏡 2 0 1 d が上下左右に移動する。なお、カメラペダル 2 4 は、特許請求の範囲の「第 3 フットペダル」の一例である。

20

#### 【 0 0 3 5 】

切替ペダル 2 5 は、操作ハンドル 1 により操作されるマニピュレータ 2 0 1 を切り替えるために用いられる。たとえば、マニピュレータ 2 0 1 は、4 つ設けられており、手術器具 2 0 1 a ~ 2 0 1 c を保持する 3 つのマニピュレータ 2 0 1 を、切替ペダル 2 5 の操作により、左右の操作ハンドル 1 により操作されるマニピュレータ 2 0 1 が切り替えられる。つまり、切替ペダル 2 5 は、右手用の操作ハンドル 1 a により操作されている手術器具 2 0 1 a または左手用の操作ハンドル 1 b により操作されている手術器具 2 0 1 b を交換用の手術器具 2 0 1 c に変更するために操作される。切替ペダル 2 5 は、左方向 ( X 1 方向 ) に押されることにより操作される。たとえば、切替ペダル 2 5 を操作することにより、右手用の操作ハンドル 1 a により操作されるマニピュレータ 2 0 1 が切り替えられる。この場合、左手用の操作ハンドル 1 b により操作されるマニピュレータ 2 0 1 は変更せず、右手用の操作ハンドル 1 a により操作されるマニピュレータ 2 0 1 が切り替えられる。また、たとえば、切替ペダル 2 5 を操作することにより、左手用の操作ハンドル 1 b により操作されるマニピュレータ 2 0 1 が切り替えられる。この場合、右手用の操作ハンドル 1 a により操作されるマニピュレータ 2 0 1 は変更せず、左手用の操作ハンドル 1 b により操作されるマニピュレータ 2 0 1 が切り替えられる。なお、切替ペダル 2 5 は、特許請求の範囲の「第 4 フットペダル」の一例である。

30

40

#### 【 0 0 3 6 】

図 3 ~ 図 5 に示すように、フットペダル 2 0 は、左側 ( X 1 側 ) から右側 ( X 2 側 ) に向かって、切替ペダル 2 5、クラッチペダル 2 3、カメラペダル 2 4、切断ペダル 2 2 a、凝固ペダル 2 1 a、切断ペダル 2 2 b、凝固ペダル 2 1 a の順に配置されている。

#### 【 0 0 3 7 】

図 3 ~ 図 5 に示したフットペダル 2 0 の配置は、左右の操作ハンドル 1 それぞれに割り当てられた凝固ペダル 2 1 と切断ペダル 2 2 の組を右足だけで操作するのに適しているが、凝固ペダル 2 1 a と切断ペダル 2 2 a の組はクラッチペダル 2 3 およびカメラペダル 2

50

4 よりも左側 ( X 1 側 ) に配置し、クラッチペダル 2 3 およびカメラペダル 2 4 を中央 ( 凝固ペダル 2 1 a と切断ペダル 2 2 a の組および凝固ペダル 2 1 b と切断ペダル 2 2 b の組との間 ) に配置するようにすれば、左手用の操作ハンドル 1 b に割り当てられた凝固ペダル 2 1 a と切断ペダル 2 2 a は左足で操作し、右手用の操作ハンドル 1 a に割り当てられた凝固ペダル 2 1 b と切断ペダル 2 2 b は右足で操作するのに適した配置となる。

【 0 0 3 8 】

複数のフットペダル 2 0 が配置された基台部 2 a は、水平方向に移動可能である。具体的には、基台部 2 a は幅方向 ( X 方向 ) の両側でスライド軸受により遠隔操作装置 1 0 0 の基台に連結されており、操作ペダル部 2 が奥行方向 ( 前後方向、 Y 方向 ) にスライドして移動可能である。そして、操作ペダル部 2 の奥行方向の移動は、遠隔操作装置 1 0 0 の基台内に設けられたモーター等の駆動装置により電動で行うことができる。これにより、操作者 O の操作姿勢、体格、または好みに合わせてフットペダル 2 0 の位置を調整することができる。

10

【 0 0 3 9 】

足の存在を検知するセンサ 2 6 の数は、下方操作されるフットペダル 2 0 の数よりも多い。具体的には、センサ 2 6 は、7 つ設けられている。また、下方向に押すことにより操作されるフットペダル 2 0 ( 凝固ペダル 2 1 a、2 1 b、切断ペダル 2 2 a、2 2 b、クラッチペダル 2 3 およびカメラペダル 2 4 ) は、6 つ設けられている。

【 0 0 4 0 】

複数のフットペダル 2 0 のうちのある 1 つのフットペダル 2 0 の近傍に、操作する足を検知するために用いるセンサ 2 6 が複数設けられ、これらの複数のセンサ 2 6 を用いて当該ある 1 つのフットペダル 2 0 を操作している又はしようとする足が存在するか否かを判定する。具体的には、制御部 6 1 は、複数のフットペダル 2 0 のうちある 1 つのフットペダル 2 0 の近傍に配置された複数のセンサ 2 6 より検知情報を受領した場合に、ある 1 つのフットペダル 2 0 の操作準備位置に操作者 O の足が配置されたと判定する。

20

【 0 0 4 1 】

なお、説明を簡潔にするために、本明細書においては、あるフットペダル 2 0 の先端側 ( Y 1 側 ) 中央部とこれに隣接するフットペダル 2 0 の先端側 ( Y 1 側 ) 中央部との間にセンサ 2 6 ( 発光 - 受光型センサの場合は発光部から照射される直線光 ) が配置されるという構成を、単に「あるペダルとこれに隣接するペダルの間にセンサが配置される」と表現する。そして、本明細書において、あるフットペダル 2 0 の先端側 ( Y 1 側 ) 中央部に配置されるセンサ 2 6 ( 発光 - 受光型センサの場合は発光部から照射される直線光が当該中央部を通るセンサ )、および、あるペダルとこれに隣接するペダルとの間に存在するセンサを「あるペダルの近傍に配置されるセンサ」と定義する。

30

【 0 0 4 2 】

センサ 2 6 a および 2 6 b により、凝固ペダル 2 1 b に近づく足の存在を検知する。つまり、センサ 2 6 a および 2 6 b の両方により足を検知した場合、制御部 6 1 により、操作対象のフットペダル 2 0 は凝固ペダル 2 1 b であると判定される。また、センサ 2 6 b および 2 6 c により、切断ペダル 2 2 b に近づく足の存在を検知する。つまり、センサ 2 6 b および 2 6 c の両方により足を検知した場合、制御部 6 1 により、操作対象のフットペダル 2 0 は切断ペダル 2 2 b であると判定される。

40

【 0 0 4 3 】

また、センサ 2 6 c および 2 6 d により、凝固ペダル 2 1 a に近づく足の存在を検知する。つまり、センサ 2 6 c および 2 6 d の両方により足を検知した場合、制御部 6 1 により、操作対象のフットペダル 2 0 は凝固ペダル 2 1 a であると判定される。また、センサ 2 6 c および 2 6 d により、切断ペダル 2 2 a に近づく足の存在を検知する。つまり、センサ 2 6 c および 2 6 d の両方により足を検知した場合、制御部 6 1 により、操作対象のフットペダル 2 0 は切断ペダル 2 2 a であると判定される。

【 0 0 4 4 】

また、センサ 2 6 f により、カメラペダル 2 4 に近づく足の存在を検知する。つまり、

50

センサ 26 f により足を検知した場合、制御部 61 により、操作対象のフットペダル 20 はカメラペダル 24 であると判定される。また、センサ 26 g により、クラッチペダル 23 に近づく足の存在を検知する。つまり、センサ 26 g により足を検知した場合、制御部 61 により、操作対象のフットペダル 20 はクラッチペダル 23 であると判定される。

#### 【0045】

発光部 261 は、LED などの発光素子を含んでいる。発光部 261 は、可視光または赤外線などの非可視光を照射するように構成されている。受光部 262 は、受光素子を含んでいる。対応する発光部 261 と受光部 262 とは、平面視において、Y 方向に沿って配置されている。つまり、図 3 ~ 図 5 の破線で示すように、発光部 261 からの光は、平面視において、主に Y 方向に沿って照射される。また、対応する発光部 261 および受光部 262 の配列方向は、平面視において、各々平行になるように配置されている。また、発光部 261 は、斜め下方向に向けて光を照射するように構成されている。

#### 【0046】

図 6 を用いて、操作ペダル部 2 の凝固ペダル 21 (21 a および 21 b) と、切断ペダル 22 (22 a および 22 b) との割り当ての例について説明する。凝固ペダル 21 a と切断ペダル 22 a とは、1 組で用いられ、凝固ペダル 21 b と切断ペダル 22 b とは、1 組で用いられる。ここで、1 つの鉗子 (たとえば、グラスパ) により、手術部位を切断することも凝固させることも可能である。1 つの鉗子で切断及び凝固を行う場合、切断には高い電圧が印加され、凝固には切断の場合よりも低い電圧がかけられる。つまり、凝固ペダル 21 a (21 b) と切断ペダル 22 a (22 b) とを選択して使用することにより、手術部位の凝固および切断を行うことができる。また、グラスパなどで切断・凝固を行うことができるとしても、凝固用のシーリングデバイスを専用または併用で使用することができる。シーリングデバイスでは凝固が完了すると自動で電力提供が終了するなどの追加機能を有していることが多いためである。

#### 【0047】

図 6 に示す例では、4 つのマニピュレータ 201 に対して、医療器具として、バイポーラの鉗子 F1 と、モノポーラの鉗子 F2 と、シーリングデバイス F3 と、内視鏡 201 d が取付けられる。4 つのマニピュレータ 201 の位置関係は、各マニピュレータに設けられた位置検出器により認識される。各マニピュレータの左右の位置関係は、プラットホーム 203 から見た位置で認識する。図 6 (A) では、内視鏡 201 d が取り付けられたマニピュレータ 201 から見て、左側にモノポーラの鉗子 F2、内視鏡 201 d が取り付けられたマニピュレータ 201 から見て、左側から右側に向けて順に、バイポーラの鉗子 F1、シーリングデバイス F3 が配置されている。凝固ペダル 21 (21 a および 21 b) と、切断ペダル 22 (22 a および 22 b) との割り当てとして、まず、手術器具 201 b が取り付けられているマニピュレータ 201 が左側用フットペダル (凝固ペダル 21 a および切断ペダル 22 a) に割り当てられ、ひとつ右にある手術器具 201 a が取り付けられているマニピュレータ 201 が右側用フットペダル (凝固ペダル 21 b および切断ペダル 22 b) に割り当てられる。つまり、図 6 (A) では、左側用フットペダル (凝固ペダル 21 a および切断ペダル 22 a) に、モノポーラの鉗子 F2 が割り当てられる。また、右側用フットペダル (凝固ペダル 21 b および切断ペダル 22 b) に、バイポーラの鉗子 F1 が割り当てられる。なお、手術器具が 2 つだけ取り付けられている場合は、内視鏡 201 d が取り付けられたマニピュレータ 201 から見て、一番左側のマニピュレータ 201 から順に、それぞれ、左側用フットペダルおよび右側用フットペダルに割り当てられる。手術器具が 1 つだけ取り付けられている場合は、左側用フットペダルに割り当てられる。

#### 【0048】

図 6 (B) では、助手 (たとえば、看護師) により、バイポーラの鉗子 F1 と、モノポーラの鉗子 F2 とが入れ替えられる。この場合、手術器具 201 a および 201 b のマニピュレータ 201 への取り付けにより手術器具 201 a および 201 b の種類が特定される。たとえば、インターフェースの IC に器具の型番などの情報が記憶されていてもよい

10

20

30

40

50

。そして、左側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 a および切断ペダル 2 2 a ）に、パイポラの鉗子 F 1 が割り当てられる。また、右側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 b および切断ペダル 2 2 b ）に、モノポラの鉗子 F 2 が割り当てられる。

【 0 0 4 9 】

図 6（C）では、助手（たとえば、看護師）により、モノポラの鉗子 F 2 と、シーリングデバイス F 3 とが入れ替えられる。手術器具 2 0 1 a および 2 0 1 b のマニピュレータ 2 0 1 への取り付けにより手術器具 2 0 1 a および 2 0 1 b の種類が特定される。そして、左側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 a および切断ペダル 2 2 a ）に、引き続き、パイポラの鉗子 F 1 が割り当てられる。また、右側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 b および切断ペダル 2 2 b ）に、シーリングデバイス F 3 が割り当てられる。

10

【 0 0 5 0 】

図 6（D）では、切替ペダル 2 5 により、右側にある 2 本のマニピュレータ 2 0 1 のうちアクティベートするマニピュレータ 2 0 1 が切り替えられる。つまり、操作ハンドル 1 により操作されるマニピュレータ 2 0 1 が切り替えられる。これにより、左手用の操作ハンドル 1 b により、パイポラの鉗子 F 1 が取り付けられたマニピュレータ 2 0 1 が操作され、右手用の操作ハンドル 1 a により、モノポラの鉗子 F 2 が取り付けられたマニピュレータ 2 0 1 が操作される。左側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 a および切断ペダル 2 2 a ）に、引き続き、パイポラの鉗子 F 1 が割り当てられる。また、右側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 b および切断ペダル 2 2 b ）に、モノポラの鉗子 F 2 が割り当てられる。

20

【 0 0 5 1 】

図 6（E）では、切替ペダル 2 5 により、右側にある 2 本のマニピュレータ 2 0 1 のうちアクティベートするマニピュレータ 2 0 1 が切り替えられる。つまり、操作ハンドル 1 により操作されるマニピュレータ 2 0 1 が切り替えられる。これにより、左手用の操作ハンドル 1 b により、パイポラの鉗子 F 1 が取り付けられたマニピュレータ 2 0 1 が操作され、右手用の操作ハンドル 1 a により、シーリングデバイス F 3 が取り付けられたマニピュレータ 2 0 1 が操作される。左側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 a および切断ペダル 2 2 a ）に、引き続き、パイポラの鉗子 F 1 が割り当てられる。また、右側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 b および切断ペダル 2 2 b ）に、シーリングデバイス F 3 が割り当てられる。

30

【 0 0 5 2 】

なお、主に強い把持力が必要なときに使用される、電気をかけない単純なグラスパを使用することもあるが、電気がかけられない手術器具に対しては、凝固ペダル 2 1（2 1 a および 2 1 b）と、切断ペダル 2 2（2 2 a および 2 2 b）とによる操作は行われないので、凝固ペダル 2 1 および切断ペダル 2 2 は割り当てられない。すなわち、凝固ペダル 2 1（2 1 a および 2 1 b）と、切断ペダル 2 2（2 2 a および 2 2 b）の割当ての際には、電気がかけられない手術器具を把持するマニピュレータ 2 0 1 は除外するように設定しておけばよい。

【 0 0 5 3 】

また、左側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 a および切断ペダル 2 2 a ）と、右側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 b および切断ペダル 2 2 b ）とは、他の方法（ルール）により割り当ててもよい。たとえば、内視鏡 2 0 1 d が取り付けられたマニピュレータ 2 0 1 の左右のマニピュレータ 2 0 1 それぞれに必ずフットペダルが割り当てられるようにしてもよい。たとえば、内視鏡 2 0 1 d が取り付けられたマニピュレータ 2 0 1 より左側にある 1 つのマニピュレータ 2 0 1 を左側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 a および切断ペダル 2 2 a ）に割り当て、内視鏡 2 0 1 d が取り付けられたマニピュレータ 2 0 1 より右側にある 2 つのマニピュレータ 2 0 1 のうち左側にあるマニピュレータ 2 0 1 を右側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 b および切断ペダル 2 2 b ）に割り当てられるようにしてもよい。

40

【 0 0 5 4 】

図 1 に示すように、表示装置 3 は、内視鏡 2 0 1 d によって撮像された画像を表示する

50

ことができるものである。表示装置 3 は、スコープ型表示装置または非スコープ型表示装置からなる。図 1 に示す例では、表示装置 3 は、スコープ型表示装置である。スコープ型表示装置とは、たとえば、覗き込むタイプの表示部である。また、非スコープ型表示装置とは、通常のパーソナルコンピュータのディスプレイのような覗き込むタイプではない平坦な画面を有する開放型の表示部を含む概念である。

【 0 0 5 5 】

図 2 に示すように、制御装置 6 は、例えば、CPU 等の演算器を有する制御部 6 1 と、ROM および RAM 等のメモリを有する記憶部 6 2 と、画像制御部 6 3 とを含んでいる。制御装置 6 は、少なくとも マニピュレータ 2 0 1 および表示装置 3 を制御するように構成されている。制御装置 6 は、集中制御する単独の制御装置により構成されていてもよく、互いに協働して分散制御する複数の制御装置により構成されてもよい。制御部 6 1 は、操作ハンドル 1 により入力された動作態様指令を、操作ペダル部 2 の切替状態に応じて、手術器具 2 0 1 a ~ 2 0 1 c によって実行されるべき動作態様指令であるか、または、内視鏡 2 0 1 d によって実行されるべき動作態様指令であるかを判定する。制御部 6 1 は、判定結果と操作ハンドル 1 による操作とに基づいて、対応するマニピュレータ 2 0 1 を動作させる信号を送信する。

10

【 0 0 5 6 】

また、制御部 6 1 は、センサ 2 6 より操作者 O の足の存在の検知情報を受領して操作者 O の足の存在の有無を判定する。また、制御部 6 1 は、操作者 O の足が存在すると判定した場合に、対応する表示を表示装置 3 に表示させるように制御する。

20

【 0 0 5 7 】

記憶部 6 2 には例えば手術器具 2 0 1 a ~ 2 0 1 c の種類に応じた制御プログラムが記憶されていて、取り付けられた手術器具 2 0 1 a ~ 2 0 1 c の種類に応じて制御部 6 1 がこれらの制御プログラムを読み出すことにより、遠隔操作装置 1 0 0 の操作ハンドル 1 及び / 又は操作ペダル部 2 の動作指令が個別の手術器具 2 0 1 a ~ 2 0 1 c に適合した動作をさせることができる。

【 0 0 5 8 】

画像制御部 6 3 は、内視鏡 2 0 1 d が取得した画像を表示装置 3 に伝送する。画像制御部 6 3 は、必要に応じて画像の加工修正処理を行う。

【 0 0 5 9 】

30

図 7 に示すように、制御装置 6 は、右手用の操作ハンドル 1 a によって操作される手術器具 2 0 1 a に関する情報を示す第 1 エリア 3 2 1 と、左手用の操作ハンドル 1 b によって操作される手術器具 2 0 1 b に関する情報を示す第 2 エリア 3 2 2 と、内視鏡 2 0 1 d に関する情報を示す第 3 エリア 3 2 3 と、を右から左に順に並べて配置したグラフィカルユーザインタフェース 3 2 を内視鏡 2 0 1 d によって撮像された画像 3 1 上に重ねて表示装置 3 に表示するように構成されている。

【 0 0 6 0 】

また、制御装置 6 は、右手用の操作ハンドル 1 a によって操作される手術器具 2 0 1 a に関する情報を示す第 1 エリア 3 2 1 と、左手用の操作ハンドル 1 b によって操作される手術器具 2 0 1 b に関する情報を示す第 2 エリア 3 2 2 と、内視鏡 2 0 1 d に関する情報を示す第 3 エリア 3 2 3 とを、操作ペダル部 2 の右側用フットペダル (凝固ペダル 2 1 b および切断ペダル 2 2 b )、左側用フットペダル (凝固ペダル 2 1 a および切断ペダル 2 2 a ) およびカメラペダル 2 4 の並び順と同じ順に並べて配置したグラフィカルユーザインタフェース 3 2 を内視鏡 2 0 1 d によって撮像された画像 3 1 上に重ねて表示装置 3 に表示するように構成されている。

40

【 0 0 6 1 】

表示装置 3 に表示されるグラフィカルユーザインタフェース 3 2 は、図 7 に示すように、第 1 エリア 3 2 1 と、第 2 エリア 3 2 2 と、第 3 エリア 3 2 3 と、第 4 エリア 3 2 4 と、第 5 エリア 3 2 5 とを含む。また、グラフィカルユーザインタフェース 3 2 は、ステータスエリア 3 2 6 を含む。また、グラフィカルユーザインタフェース 3 2 は、ポップアッ

50

プエリア327a(図9参照)と、ポップアップエリア327b(図13参照)と、ポップアップエリア327c(図15参照)と、ポップアップエリア327d(図17参照)とを含む。また、グラフィカルユーザインタフェース32は、内視鏡201dの水準器328(図14参照)が表示されるセンターエリアを含む。また、グラフィカルユーザインタフェース32は、エラー通知エリア329a(図20参照)と、エラー通知エリア329b(図21参照)とを含む。

【0062】

グラフィカルユーザインタフェース32の第1エリア321と、第2エリア322と、第3エリア323と、第4エリア324と、第5エリア325とは、表示装置3の下方の端部近傍領域に並んで配置される。なお、第1エリア321と、第2エリア322と、第3エリア323と、第4エリア324と、第5エリア325とが、表示装置3の上方の端部近傍領域に並んで配置されていてもよい。これにより、表示装置3の上方または下方に、手術器具201a、手術器具201bおよび内視鏡201dに関する情報が表示されるので、表示装置3の中央に表示する場合と異なり、第1エリア321、第2エリア322、第3エリア323、第4エリア324および第5エリア325によって、内視鏡201dにより撮像した画像31が見えにくくなるのを抑制することができる。

10

【0063】

グラフィカルユーザインタフェース32のポップアップエリア327aおよび327bは、表示装置3の左右方向における左側で、上下方向における中央付近に配置される。グラフィカルユーザインタフェース32のポップアップエリア327cおよび327dは、表示装置3の左右方向における右側で、上下方向における中央付近に配置される。グラフィカルユーザインタフェース32のステータスエリア326と、エラー通知エリア329aは、表示装置3の上方の端部近傍領域に配置される。エラー通知エリア329bは、グラフィカルユーザインタフェース32の第2エリア322の上方に配置される。

20

【0064】

第1エリア321には、右手用の操作ハンドル1aにより操作されている手術器具201aの種類が表示される。第2エリア322には、左手用の操作ハンドル1bにより操作されている手術器具201bの種類が表示される。第3エリア323には、内視鏡201dを示す情報が表示される。これにより、操作ハンドル1aにより操作されている手術器具201a、および、操作ハンドル1bにより操作されている手術器具201bの種類を操作者Oが容易に把握することができる。また、内視鏡201dを示す情報に基づいて内視鏡201dの状態を操作者Oが容易に把握することができる。

30

【0065】

第4エリア324は、第1エリア321と第2エリア322との間に配置されている。第4エリア324には、交換用の手術器具201cに関する情報が表示される。具体的には、第4エリア324には、交換用の手術器具201cの種類が表示される。これにより、手術器具201aまたは手術器具201bと交換された操作ハンドル1aまたは操作ハンドル1bにより操作される交換用の手術器具201cの情報を表示装置3の画面上で操作者Oが容易に把握することができる。また、第4エリア324は、第1エリア321および第2エリア322よりも薄目の色合いで情報が表示される。つまり、第4エリア324の情報は、第1エリア321および第2エリア322の情報よりも目立たないように表示される。

40

【0066】

第5エリア325は、第2エリア322よりも左側に配置されている。第5エリア325には、クラッチ機能に関する情報が表示される。具体的には、第5エリア325には、クラッチペダル23の操作状態が表示される。これにより、マニピュレータ201と、操作ハンドル1との操作接続を一時切断して手術器具201aおよび201bの動作を停止させる場合に用いられるクラッチペダル23のクラッチ機能の状態を表示装置3の画面上で操作者Oが容易に把握することができる。

【0067】

50

ステータスエリア 3 2 6 には、手術システム 4 0 0 のステータスが表示される。たとえば、ステータスエリア 3 2 6 には、手術時間が表示される。また、ステータスエリア 3 2 6 には、表示装置 3 の輝度調整情報やコントラスト調整情報が表示される。

【 0 0 6 8 】

ポップアップエリア 3 2 7 a ~ 3 2 7 d は、第 1 エリア 3 2 1、第 2 エリア 3 2 2 および第 3 エリア 3 2 3 とは異なる位置に配置される。また、ポップアップエリア 3 2 7 a ~ 3 2 7 d には、対応するフットペダル 2 0 の操作準備位置に操作者 O の足が配置されたことを、複数のセンサ 2 6 のうちの少なくとも 1 つのセンサ 2 6 により検出したことに基づいて、情報が表示される。これにより、操作者 O がフットペダル 2 0 の操作準備位置に足を配置した段階で、対応するエリアに加えて、別の位置にもフットペダル 2 0 に関する情報が表示されるので、操作するフットペダル 2 0 が操作準備位置に配置されていることを操作者 O が容易に認識することができる。

10

【 0 0 6 9 】

図 9 に示すように、ポップアップエリア 3 2 7 a には、クラッチペダル 2 3 の操作準備位置に操作者 O の足が配置された場合に、クラッチペダル 2 3 に関する情報が表示される。ポップアップエリア 3 2 7 a には、所定の時間（たとえば、3 秒間）情報が表示される。つまり、ポップアップエリア 3 2 7 a の情報の表示は、クラッチペダル 2 3 の操作準備位置から操作者 O の足が移動するか、クラッチペダル 2 3 が操作されるか、または、所定の時間が経過すると消える。

【 0 0 7 0 】

20

図 1 3 に示すように、ポップアップエリア 3 2 7 b には、カメラペダル 2 4 の操作準備位置に操作者 O の足が配置された場合に、カメラペダル 2 4 に関する情報が表示される。ポップアップエリア 3 2 7 b には、所定の時間（たとえば、3 秒間）情報が表示される。つまり、ポップアップエリア 3 2 7 b の情報の表示は、カメラペダル 2 4 の操作準備位置から操作者 O の足が移動するか、カメラペダル 2 4 が操作されるか、または、所定の時間が経過すると消える。

【 0 0 7 1 】

図 1 5 に示すように、ポップアップエリア 3 2 7 c には、切断ペダル 2 2 a または 2 2 b の操作準備位置に操作者 O の足が配置された場合に、切断ペダル 2 2 に関する情報が表示される。ポップアップエリア 3 2 7 c には、所定の時間（たとえば、3 秒間）情報が表示される。つまり、ポップアップエリア 3 2 7 c の情報の表示は、切断ペダル 2 2 a または 2 2 b の操作準備位置から操作者 O の足が移動するか、切断ペダル 2 2 a または 2 2 b が操作されるか、または、所定の時間が経過すると消える。

30

【 0 0 7 2 】

図 1 7 に示すように、ポップアップエリア 3 2 7 d には、凝固ペダル 2 1 a または 2 1 b の操作準備位置に操作者 O の足が配置された場合に、凝固ペダル 2 1 に関する情報が表示される。ポップアップエリア 3 2 7 d には、所定の時間（たとえば、3 秒間）情報が表示される。つまり、ポップアップエリア 3 2 7 d の情報の表示は、凝固ペダル 2 1 a または 2 1 b の操作準備位置から操作者 O の足が移動するか、凝固ペダル 2 1 a または 2 1 b が操作されるか、または、所定の時間が経過すると消える。

40

【 0 0 7 3 】

図 1 4 に示すように、内視鏡 2 0 1 d の水準器 3 2 8 は、カメラペダル 2 4 が操作された場合に、表示装置 3 に表示される。これにより、表示された水準器 3 2 8 を見ながら操作することにより操作者 O は内視鏡 2 0 1 d の姿勢を容易に変更させることができる。

【 0 0 7 4 】

ここで、本実施形態では、制御装置 6 は、右側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 b および切断ペダル 2 2 b）、左側用フットペダル（凝固ペダル 2 1 a および切断ペダル 2 2 a）およびカメラペダル 2 4 のうちの少なくとも 1 つのフットペダル 2 0 の操作準備位置に操作者 O の足が配置されたことを、複数のセンサ 2 6 のうちの少なくとも 1 つのセンサ 2 6 により検出したことに基づいて、第 1 エリア 3 2 1、第 2 エリア 3 2 2 および第 3 エリ

50

ア 3 2 3 のうちの対応するエリアの表示形態を変更するように構成されている。これにより、フットペダル 2 0 の操作準備位置に操作者 O の足が配置された場合に、フットペダル 2 0 に対応するグラフィカルユーザインタフェース 3 2 のエリアの表示形態が変更されて表示装置 3 に表示されるので、操作者 O が実際にどのフットペダル 2 0 に足を位置させているのかを目視で確認する必要がない。その結果、操作者 O が表示装置 3 から目を離すことなく操作するフットペダル 2 0 を確認することができる。

【 0 0 7 5 】

エリアの表示形態の変更は、表示色の変更、反転表示、エリアの枠線の表示変更、表示エリアの拡大 / 縮小のうち少なくとも 1 つを含む。これにより、操作者 O がフットペダル 2 0 の操作準備位置に足を配置した場合に、対応するエリアにおいて、表示色の変更、反転表示、または、エリアの枠線の表示変更が行われるので、操作者 O が表示形態の変更を容易に認識して、操作するフットペダル 2 0 を容易に確認することができる。

10

【 0 0 7 6 】

また、制御装置 6 は、凝固ペダル 2 1 a または 2 1 b の操作準備位置に操作者 O の足が配置されたことを、複数のセンサ 2 6 のうちの少なくとも 1 つのセンサ 2 6 により検出したことに基づいて、第 1 エリア 3 2 1 および第 2 エリア 3 2 2 のうちの対応するエリアに第 1 の色により情報を表示するように構成されている。また、制御装置 6 は、切断ペダル 2 2 a または 2 2 b の操作準備位置に操作者 O の足が配置されたことを、複数のセンサ 2 6 のうちの少なくとも 1 つのセンサ 2 6 により検出したことに基づいて、第 1 エリア 3 2 1 および第 2 エリア 3 2 2 のうちの対応するエリアに第 2 の色により情報を表示するよう

20

【 0 0 7 7 】

制御装置 6 は、フットペダル 2 0 が操作された場合に、対応するエリアに、フットペダル 2 0 の操作準備位置に操作者 O の足が配置された表示態様と異なる表示態様により情報を表示するように構成されている。これにより、フットペダル 2 0 の操作準備位置に操作者 O の足が配置された場合と、フットペダル 2 0 が操作された場合とで、互いに異なる表示がされるので、フットペダル 2 0 が操作準備状態であるかまたは操作状態であるかを操作者 O が容易に把握することができる。

30

【 0 0 7 8 】

グラフィカルユーザインタフェース 3 2 の各エリアには、各フットペダル 2 0 の操作の状況が表示されるように構成されている。これにより、各フットペダル 2 0 の操作状況を操作者 O が容易に把握することができる。

【 0 0 7 9 】

具体的には、第 1 エリア 3 2 1 には、手術器具 2 0 1 a に関する情報に加えて右側用フットペダル (凝固ペダル 2 1 b および切断ペダル 2 2 b) に関する情報が表示される。たとえば、凝固ペダル 2 1 b または切断ペダル 2 2 b の操作準備位置に操作者 O の足が配置された場合に、対応するフットペダル 2 0 (凝固ペダル 2 1 b または切断ペダル 2 2 b) の色を用いて、第 1 エリア 3 2 1 の枠線を表示する。これにより、第 1 エリア 3 2 1 の表示により右側用フットペダル (凝固ペダル 2 1 b および切断ペダル 2 2 b) の操作による手術器具 2 0 1 a の機能の実行状態を操作者 O が容易に把握することができる。また、凝固ペダル 2 1 b または切断ペダル 2 2 b が操作された場合に、第 1 エリア 3 2 1 に凝固ペダル 2 1 b または切断ペダル 2 2 b に関する情報が操作準備位置に操作者 O の足が配置された場合と区別して表示される。たとえば、凝固ペダル 2 1 b または切断ペダル 2 2 b が操作された場合に、対応するフットペダル 2 0 (凝固ペダル 2 1 b または切断ペダル 2 2 b) の色を、第 1 エリア 3 2 1 の全体に表示する。これにより、第 1 エリア 3 2 1 の表示により凝固ペダル 2 1 b または切断ペダル 2 2 b の操作状態を操作者 O が容易に把握する

40

50

ことができる。

【0080】

つまり、凝固ペダル21bが操作された場合に、第1エリア321に凝固ペダル21bに関する情報が表示される。また、切断ペダル22bが操作された場合に、第1エリア321に切断ペダル22bに関する情報が表示される。これにより、第1エリア321の表示により右手用の操作ハンドル1aにより操作される手術器具201aによる凝固機能および切断機能の実行状態を操作者Oが容易に把握することができる。

【0081】

また、第2エリア322には、手術器具201bに関する情報に加えて左側用フットペダル（凝固ペダル21aおよび切断ペダル22a）に関する情報が表示される。たとえば、凝固ペダル21aまたは切断ペダル22aの操作準備位置に操作者Oの足が配置された場合に、対応するフットペダル20（凝固ペダル21aまたは切断ペダル22a）の色を用いて、第2エリア322の枠線を表示する。これにより、第2エリア322の表示により左側用フットペダル（凝固ペダル21aおよび切断ペダル22a）の操作による手術器具201bの機能の実行状態を操作者Oが容易に把握することができる。また、凝固ペダル21aまたは切断ペダル22aが操作された場合に、第2エリア322に凝固ペダル21aまたは切断ペダル22aに関する情報が操作準備位置に操作者Oの足が配置された場合と区別して表示される。たとえば、凝固ペダル21aまたは切断ペダル22aが操作された場合に、対応するフットペダル20（凝固ペダル21aまたは切断ペダル22a）の色を、第2エリア322の全体に表示する。これにより、第2エリア322の表示により凝固ペダル21aまたは切断ペダル22aの操作状態を操作者Oが容易に把握することができる。

【0082】

つまり、凝固ペダル21aが操作された場合に、第2エリア322に凝固ペダル21aに関する情報が表示される。また、切断ペダル22aが操作された場合に、第2エリア322に切断ペダル22aに関する情報が表示される。これにより、第2エリア322の表示により左手用の操作ハンドル1bにより操作される手術器具201bによる凝固機能および切断機能の実行状態を操作者Oが容易に把握することができる。

【0083】

また、第3エリア323には、内視鏡201dに関する情報に加えてカメラペダル24に関する情報が表示される。たとえば、カメラペダル24の操作準備位置に操作者Oの足が配置された場合に、第3エリア323の枠線を強調表示する。これにより、第3エリア323の表示によりカメラペダル24の操作による内視鏡201dの機能の実行状態を操作者Oが容易に把握することができる。また、カメラペダル24が操作された場合に、第3エリア323にカメラペダル24に関する情報が操作準備位置に操作者Oの足が配置された場合と区別して表示される。たとえば、カメラペダル24が操作された場合に、第3エリア323の背景色と文字色とを反転表示させる。これにより、第3エリア323の表示によりカメラペダル24の操作状態を操作者Oが容易に把握することができる。

【0084】

次に、図8～図21を参照して、フットペダル20に対する操作者Oの操作に基づいて表示されるグラフィカルユーザインタフェース32の例について説明する。

【0085】

図8に示すように、切替ペダル25が操作されると、左手用の操作ハンドル1bにより操作される手術器具が手術器具201bから手術器具201cに切り替えられる。この場合、第2エリア322および第4エリア324の背景色と文字色とが反転表示される。これにより、操作者Oは、手術器具が切り替えられたことを容易に認識することが可能である。

【0086】

図9に示すように、クラッチペダル23の操作準備位置に操作者Oの足が配置された場合に、第5エリア325の枠線が強調して表示される。また、ポップアップエリア327

10

20

30

40

50

aにクラッチペダル23に関する情報がポップアップ表示される。なお、クラッチペダル23の操作準備位置に操作者Oの足が配置されていることが継続している場合でも、ポップアップエリア327aの表示は、所定時間経過後、消える。その場合、第5エリア325の枠線の強調表示は、継続される。

【0087】

図10に示すように、クラッチペダル23が操作されると、操作ハンドル1と、マニピュレータ201との操作接続が一時切断される。この場合、クラッチペダル23の情報を表示する第5エリア325の背景色と文字色とが反転表示される。また、操作接続が一時切断された手術器具201aの情報を表示する第1エリア321の背景色と文字色とが反転表示される。また、操作接続が一時切断された手術器具201bの情報を表示する第2

10

【0088】

図11に示すように、右手用の操作ハンドル1aのクラッチスイッチ11が操作されると、操作ハンドル1aと、手術器具201aが設けられたマニピュレータ201との操作接続が一時切断される。この場合、操作接続が一時切断された手術器具201aの情報を表示する第1エリア321の背景色と文字色とが反転表示される。

【0089】

図12に示すように、左手用の操作ハンドル1bのクラッチスイッチ11が操作されると、操作ハンドル1bと、手術器具201bが設けられたマニピュレータ201との操作

20

【0090】

図13に示すように、カメラペダル24の操作準備位置に操作者Oの足が配置された場合に、第3エリア323の枠線が強調して表示される。また、ポップアップエリア327bにカメラペダル24に関する情報がポップアップ表示される。なお、カメラペダル24の操作準備位置に操作者Oの足が配置されていることが継続している場合でも、ポップアップエリア327bの表示は、所定時間経過後、消える。その場合、第3エリア323の枠線の強調表示は、継続される。

【0091】

図14に示すように、カメラペダル24が操作されると、操作ハンドル1aおよび1bにより、内視鏡201dの位置および姿勢を操作することが可能になる。この場合、カメラペダル24の情報を表示する第3エリア323の背景色と文字色とが反転表示される。また、センターエリアに内視鏡201dの水準器328が表示される。

30

【0092】

図15に示すように、右手により操作されている手術器具201aに対応する切断ペダル22bの操作準備位置に操作者Oの足が配置された場合に、第1エリア321の枠線が強調して表示される。具体的には、切断ペダル22bが有する第2の色により、枠線の左から半分以上が強調して表示される。残りの枠線は、凝固ペダル21bが有する第1の色により強調表示される。これにより、枠線を第2の色のみで強調して表示する場合と比べて、操作者Oが切断ペダル22bと凝固ペダル21bとのうち、切断ペダル22bの操作準備位置に足を配置していることを効果的に認識させることができる。また、ポップアップエリア327cに切断ペダル22bに関する情報がポップアップ表示される。なお、切断ペダル22bの操作準備位置に操作者Oの足が配置されていることが継続している場合でも、ポップアップエリア327cの表示は、所定時間経過後、消える。その場合、第1

40

【0093】

なお、左手により操作されている手術器具201bに対応する切断ペダル22aの操作準備位置に操作者Oの足が配置された場合も、同様にして、第2エリア322の枠線が強調して表示される。

50

## 【0094】

図16に示すように、切断ペダル22bが操作されると、手術器具201aに所定の電圧が印加されて、手術部位を切断することが可能になる。この場合、切断ペダル22bの情報を表示する第1エリア321の背景が、切断ペダル22bが有する第2の色で表示される。

## 【0095】

なお、切断ペダル22aが操作された場合も、同様にして、切断ペダル22aの情報を表示する第2エリア322の背景が、切断ペダル22aが有する第2の色で表示される。

## 【0096】

図17に示すように、右手により操作されている手術器具201aに対応する凝固ペダル21bの操作準備位置に操作者Oの足が配置された場合に、第1エリア321の枠線が強調して表示される。具体的には、凝固ペダル21bが有する第1の色により、枠線の右から半分以上が強調して表示される。残りの枠線は、切断ペダル22bが有する第2の色により強調表示される。これにより、枠線を第1の色のみで強調して表示する場合と比べて、操作者Oが切断ペダル22bと凝固ペダル21bとのうち、凝固ペダル21bの操作準備位置に足を配置していることを効果的に認識させることができる。また、ポップアップエリア327dに凝固ペダル21bに関する情報がポップアップ表示される。なお、凝固ペダル21bの操作準備位置に操作者Oの足が配置されていることが継続している場合でも、ポップアップエリア327dの表示は、所定時間経過後、消える。その場合、第1エリア321の枠線の強調表示は、継続される。

10

20

## 【0097】

なお、左手により操作されている手術器具201bに対応する凝固ペダル21aの操作準備位置に操作者Oの足が配置された場合も、同様にして、第2エリア322の枠線が強調して表示される。

## 【0098】

図18に示すように、凝固ペダル21bが操作されると、手術器具201aに所定の電圧が印加されて、手術部位を凝固することが可能になる。この場合、凝固ペダル21bの情報を表示する第1エリア321の背景が、凝固ペダル21bが有する第1の色で表示される。

## 【0099】

なお、凝固ペダル21aが操作された場合も、同様にして、凝固ペダル21aの情報を表示する第2エリア322の背景が、凝固ペダル21aが有する第1の色で表示される。

30

## 【0100】

図19に示すように、左手により操作されている手術器具201bに対応する切断ペダル22aの操作準備位置に操作者Oの足が配置され、かつ、クラッチペダル23の操作準備位置に操作者Oの足が配置された場合に、第2エリア322の枠線が強調して表示される。具体的には、切断ペダル22aが有する第2の色により、枠線の左から半分以上が強調して表示される。残りの枠線は、凝固ペダル21aが有する第1の色により強調表示される。また、ポップアップエリア327cに切断ペダル22aに関する情報がポップアップ表示される。また、第5エリア325の枠線が強調して表示される。また、ポップアップエリア327aにクラッチペダル23に関する情報がポップアップ表示される。

40

## 【0101】

図20に示すように、機能が制限される場合、エラー通知エリア329aに機能が制限される通知が表示される。また、切断や凝固の機能が設定されていない手術器具を用いている場合に、切断ペダル22や凝固ペダル21が操作された場合に、手術器具に対応するエリアの上側に機能しない操作が行われたことがポップアップ表示される。この場合、切断ペダル22や凝固ペダル21を操作したとしても、手術器具に電圧は印加されない。

## 【0102】

図21に示すように、エラーが通知される場合、エラー通知エリア329bにエラーが通知される。

50

## 【0103】

(変形例)

なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更(変形例)が含まれる。

## 【0104】

たとえば、上記実施形態では、操作ペダル部のフットペダルが、凝固ペダルと、切断ペダルとを含む構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、操作ペダル部のフットペダルが、凝固ペダルおよび切断ペダル以外の医療器具に関する機能を実行するためのフットペダルを含んでいてもよい。

10

## 【0105】

また、上記実施形態では、センサが遮断型のセンサの例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、センサは、透過型であってもよいし、反射型であってもよい。また、光を用いずに、足の存在を検知してもよい。たとえば、音波を用いて検知してもよいし、コイルを用いて検知してもよい。また、センサは、非接触式に限らず、接触により足の存在を検知してもよい。たとえば、センサは、機械式のスイッチでもよい。

## 【符号の説明】


## 【0106】

1 a : 操作ハンドル(第1操作ハンドル)、1 b : 操作ハンドル(第2操作ハンドル)、2 : 操作ペダル部、3 : 表示装置、6 : 制御装置、20 : フットペダル、21 a : 凝固ペダル(第2フットペダル、第2凝固ペダル)、21 b : 凝固ペダル(第1フットペダル、第1凝固ペダル)、22 a : 切断ペダル(第2フットペダル、第2切断ペダル)、22 b : 切断ペダル(第1フットペダル、第1切断ペダル)、23 : クラッチペダル(第5フットペダル)、24 : カメラペダル(第3フットペダル)、25 : 切替ペダル(第4フットペダル)、26 : センサ、32 : グラフィカルユーザインタフェース、100 : 遠隔操作装置、201 : マニピュレータ、201 a : 手術器具(第1手術器具)、201 b : 手術器具(第2手術器具)、201 c : 手術器具(交換用手術器具)、201 d : 内視鏡、321 : 第1エリア、322 : 第2エリア、323 : 第3エリア、324 : 第4エリア、325 : 第5エリア、328 : 水準器、400 : 手術システム


20

30


【図1】

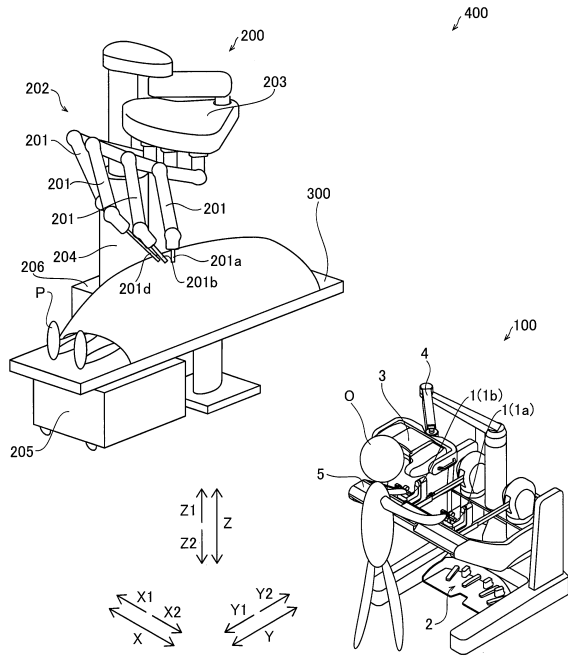


【図2】

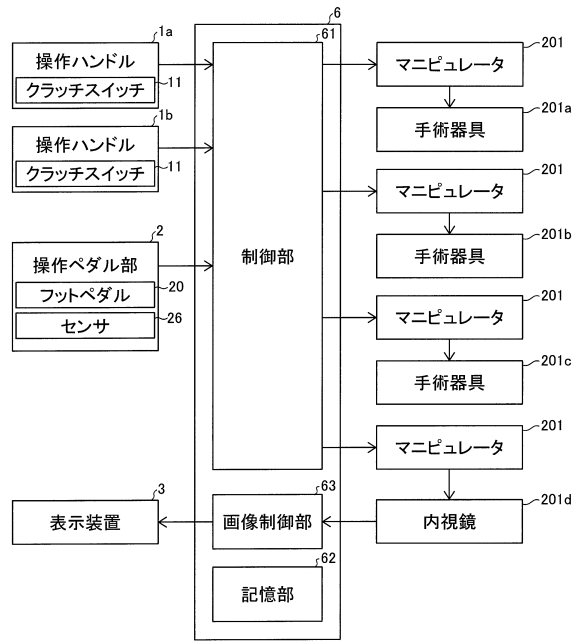


【図3】

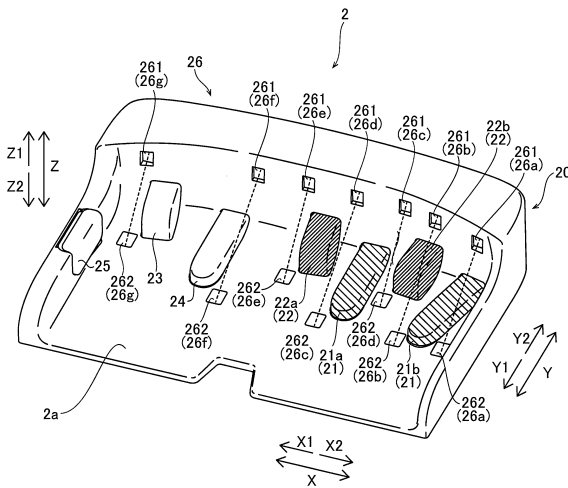


【図4】

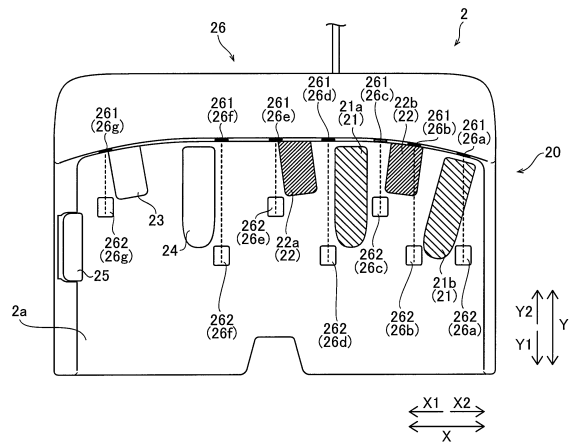


【図5】

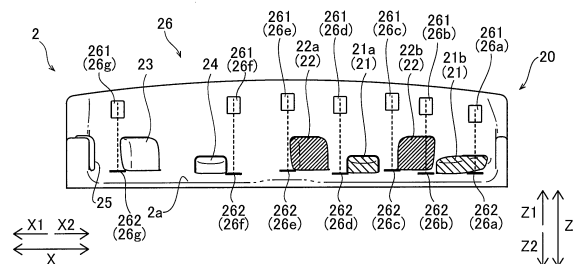


【図6】

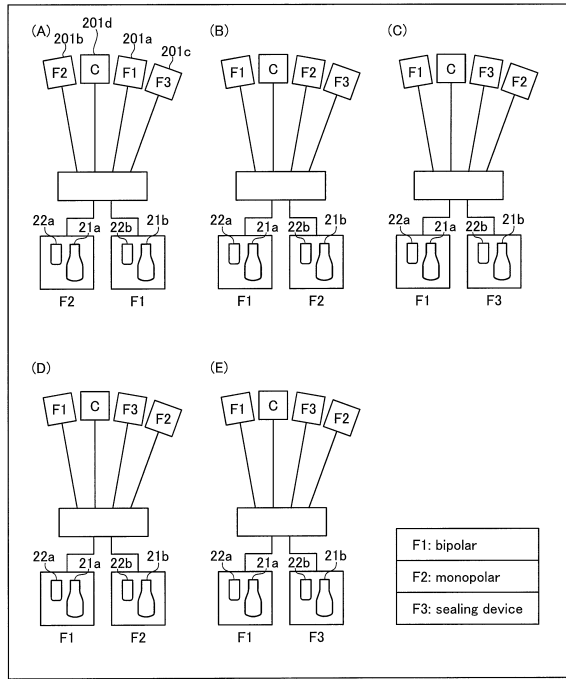


【図7】

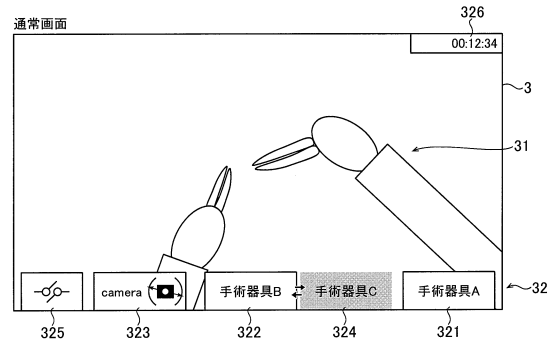


【図8】

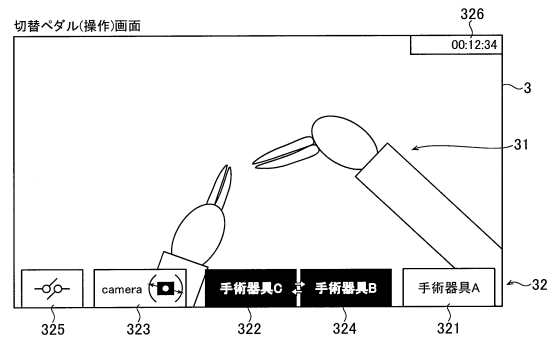


【図9】

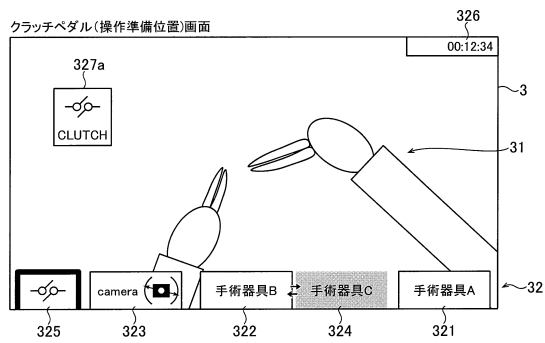


【図11】

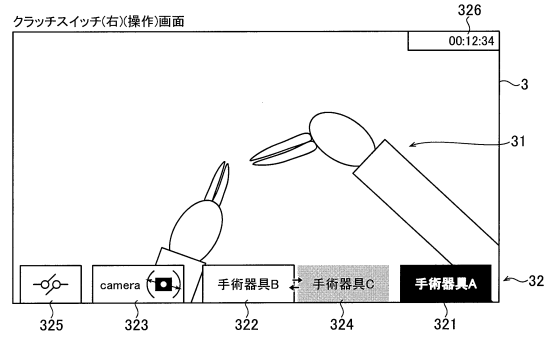


【図10】

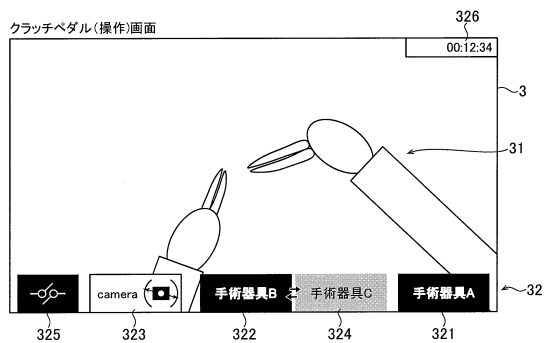


【図12】

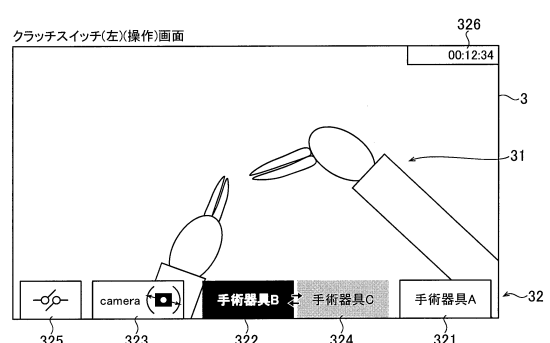


【図13】

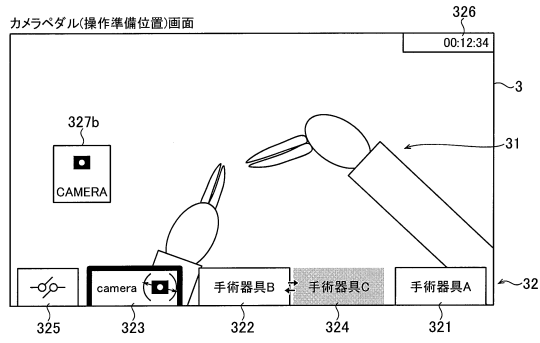


【図15】

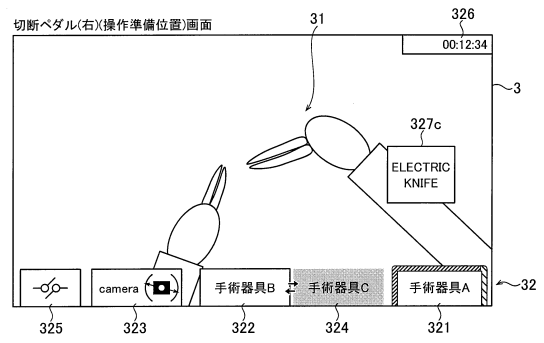


【図14】

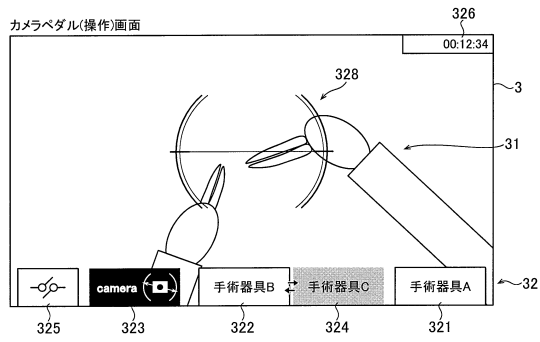


【図16】

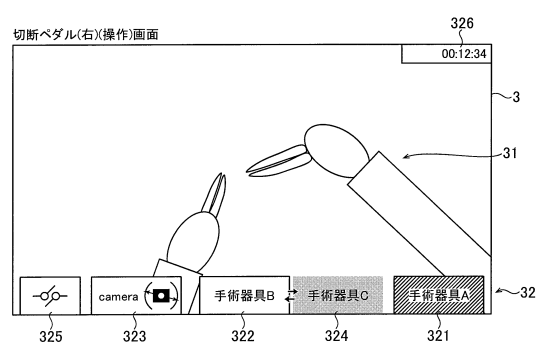


【図17】

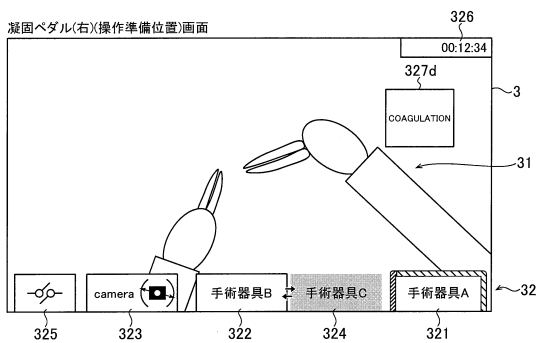


【図19】

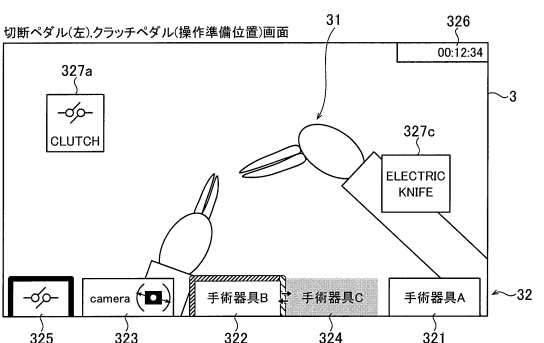


【図18】

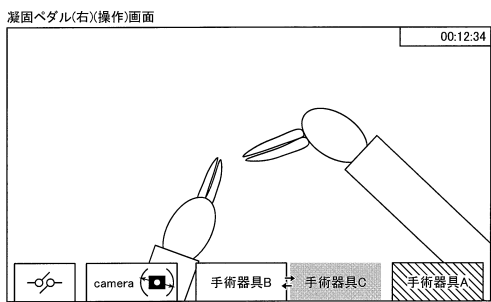

【図20】

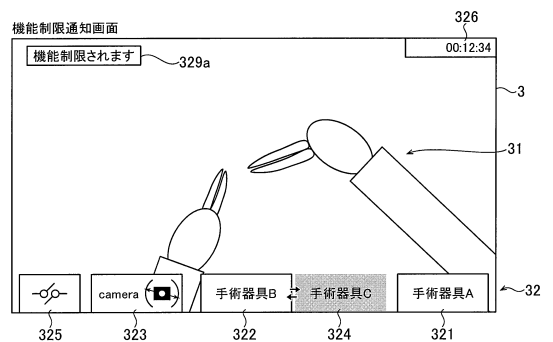

【図 21】

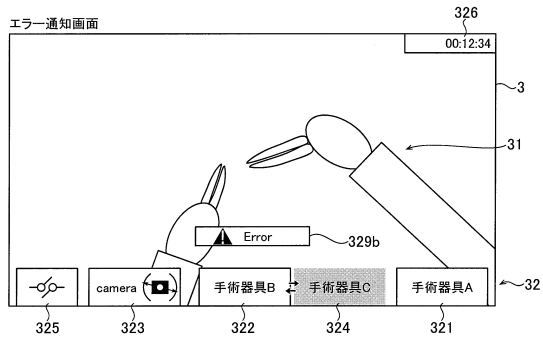

## フロントページの続き

- (72)発明者 鈴木 雄貴  
京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町4 1 番地ビーロックキタヤマ 株式会社ソフトデバイス内
- (72)発明者 國本 将哉  
京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町4 1 番地ビーロックキタヤマ 株式会社ソフトデバイス内
- (72)発明者 金原 佑樹  
京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町4 1 番地ビーロックキタヤマ 株式会社ソフトデバイス内
- (72)発明者 影山 勇一  
京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町4 1 番地ビーロックキタヤマ 株式会社ソフトデバイス内

審査官 小金井 匠

- (56)参考文献 特表2015-534476(JP,A)  
米国特許出願公開第2012/0221147(US,A1)  
特開2008-090640(JP,A)  
特開平05-077679(JP,A)  
特開2013-034836(JP,A)  
特開2008-228967(JP,A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)  
A61B 34/00-34/37